

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 1/23

09:11:03

Olhos abertos

09:11:04

Olhos abertos

09:11:05

Olhos abertos

09:11:06

Olhos abertos

09:11:07

Olhos abertos

09:11:08

Olhos abertos


09:11:09

Olhos abertos

09:11:10

Olhos abertos

Época: 1 - Horário: 09:11:04 - Estágio: 0 (8 seg.)

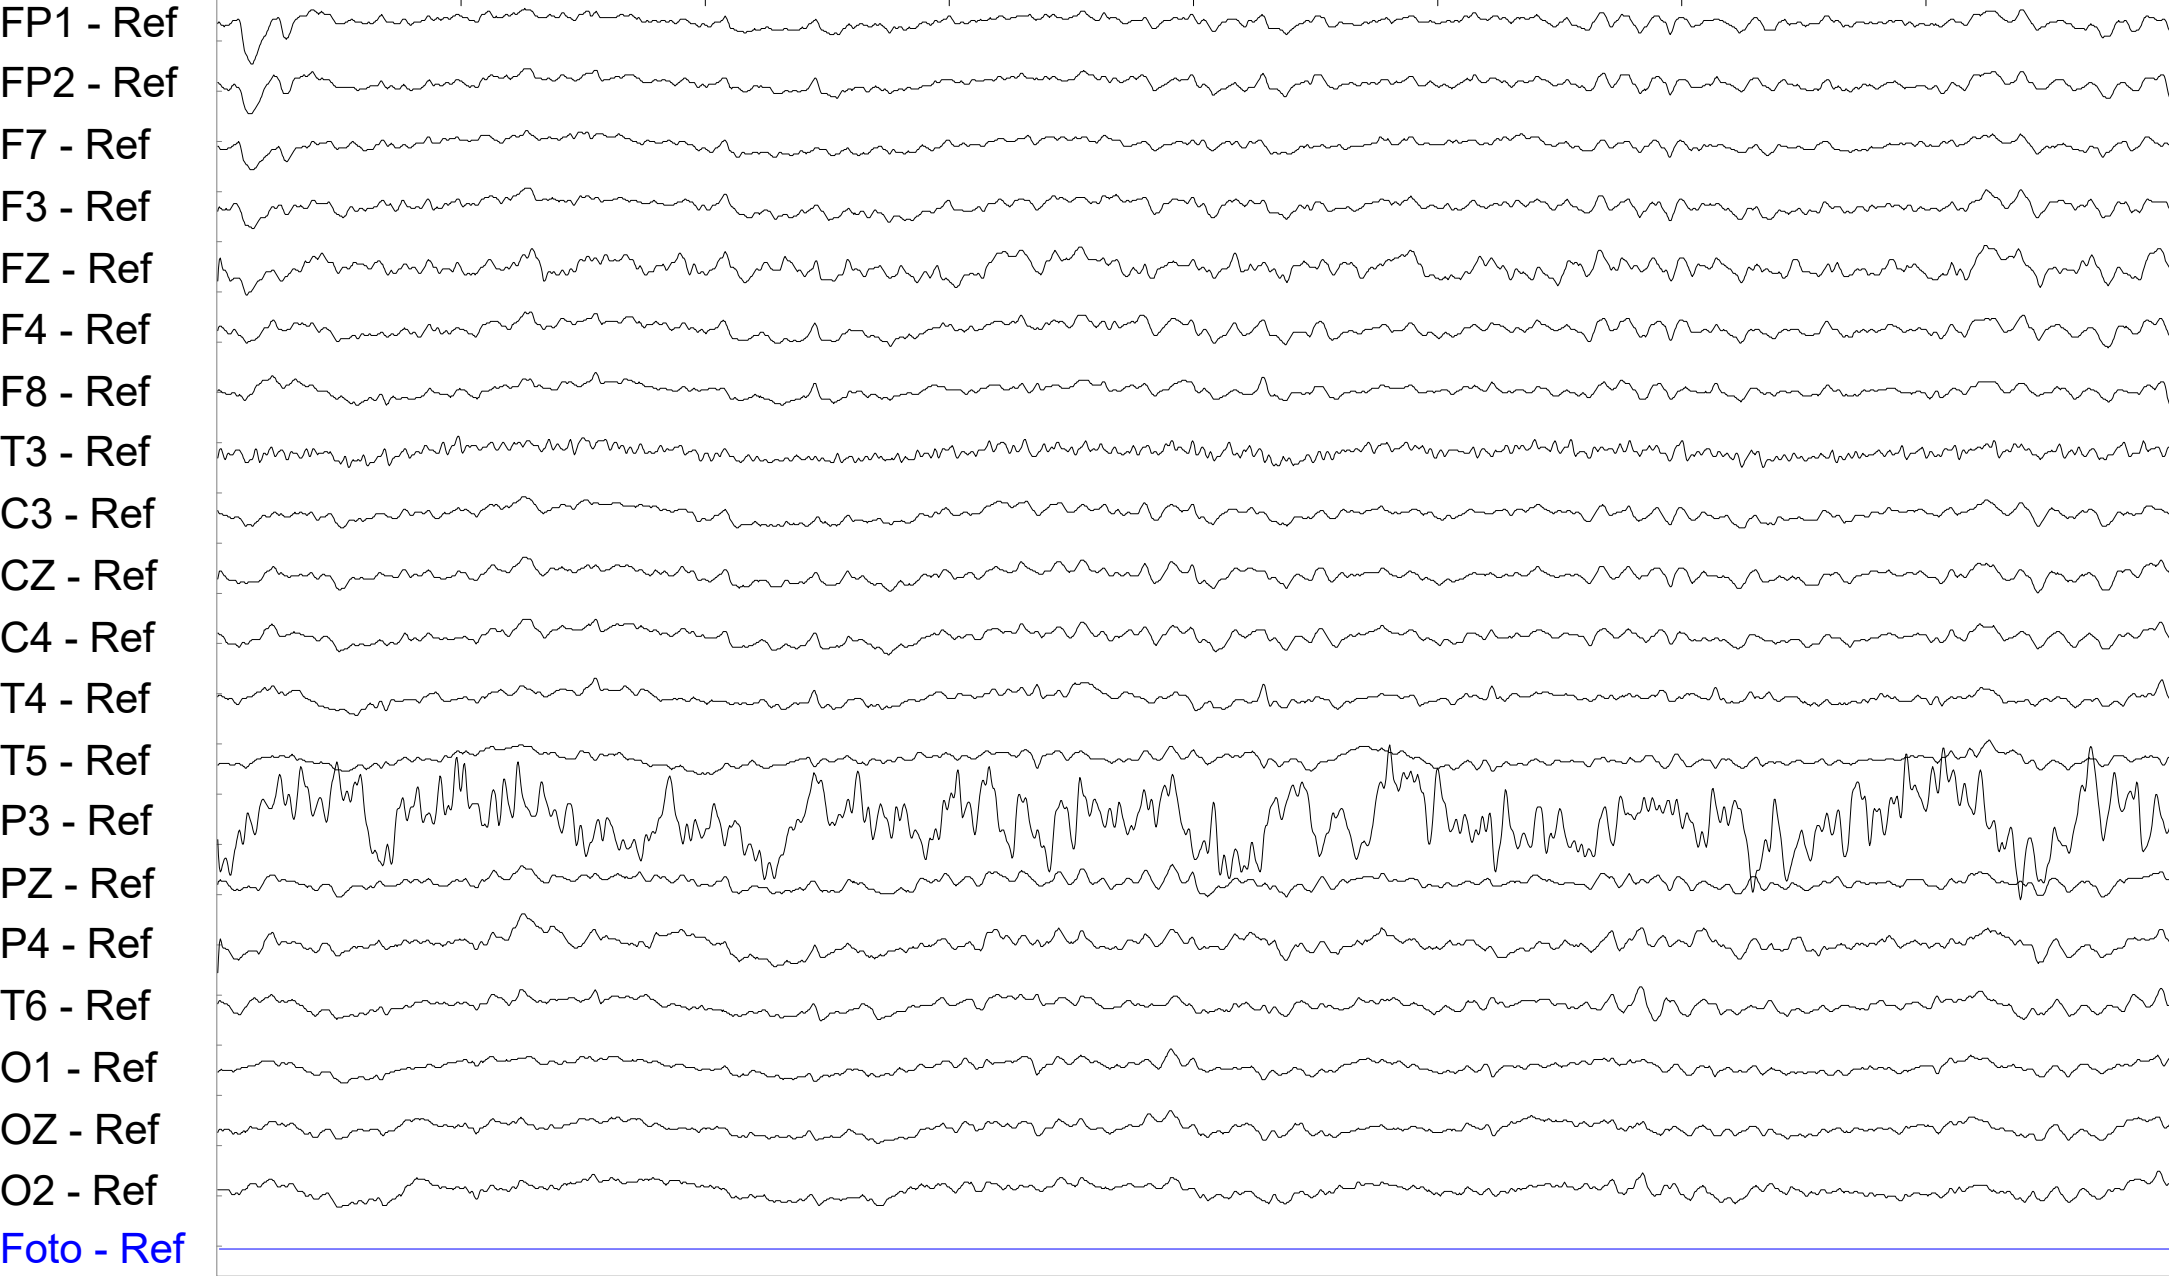


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 7/23

09:14:03	09:14:04	09:14:05	09:14:06	09:14:07	09:14:08	09:14:09	09:14:10
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados
Época: 7 - Horário: 09:14:04 - Estágio: 0 (8 seg.)							

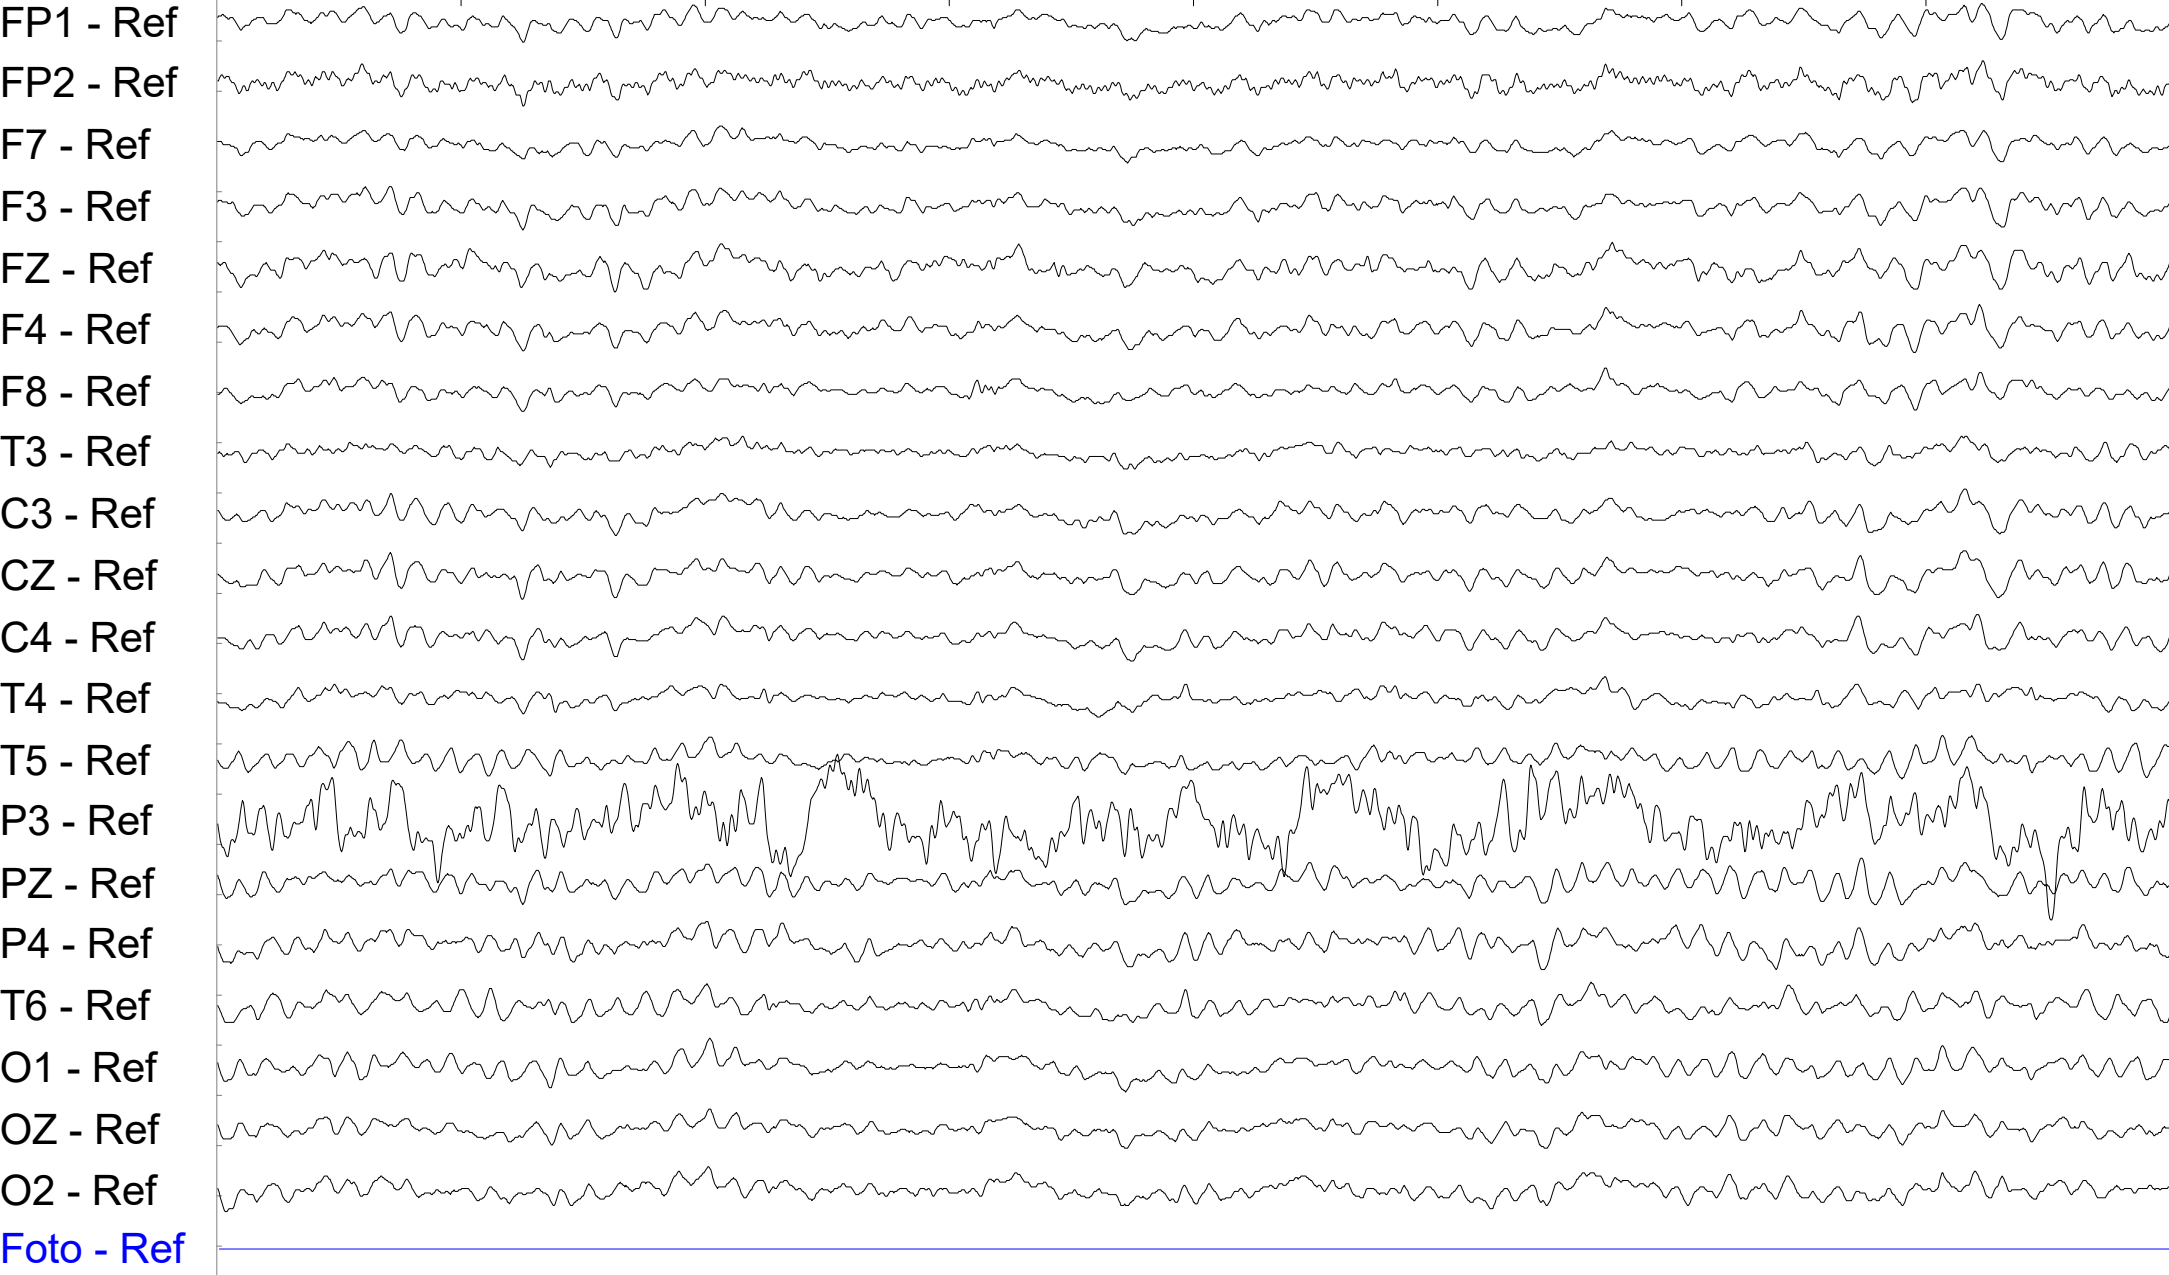

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 12/23

09:16:33

Vigília

09:16:34

Vigília

09:16:35

Vigília

09:16:36

Vigília

09:16:37

Vigília

09:16:38

Vigília


09:16:39

Vigília

09:16:40

Vigília

Época: 12 - Horário: 09:16:34 - Estágio: 0 (8 seg.)

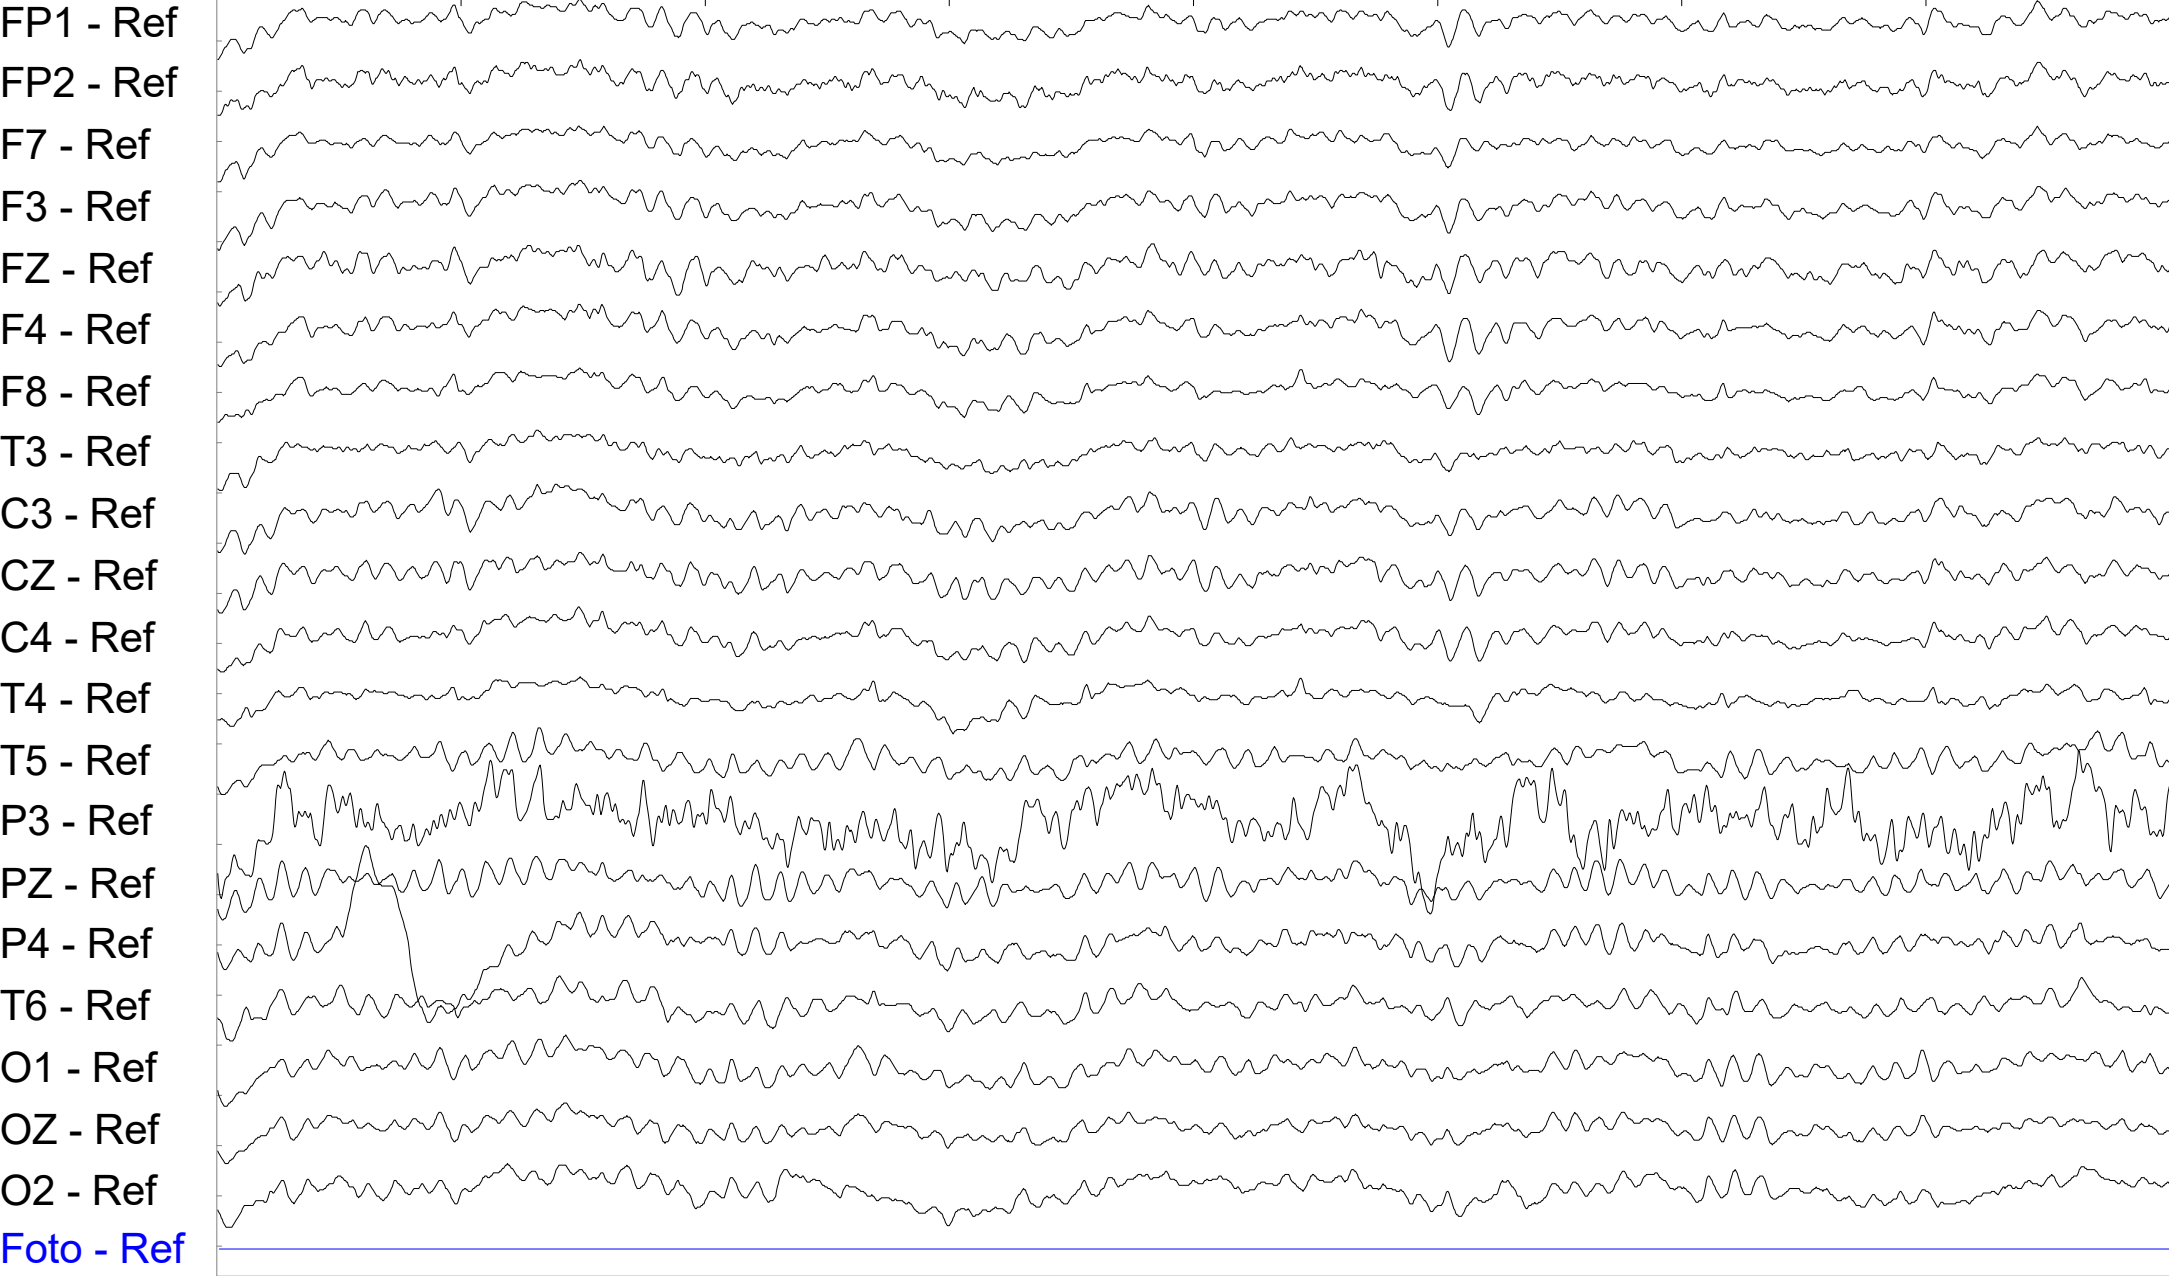


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 16/23

09:18:32 Olhos fechados 09:18:33 Olhos fechados 09:18:34 Olhos fechados 09:18:35 Olhos fechados 09:18:36 Olhos fechados 09:18:37 Olhos fechados 09:18:38 Olhos fechados 09:18:39 Olhos fechados

Época: 16 - Horário: 09:18:33 - Estágio: 0 (8 seg.)

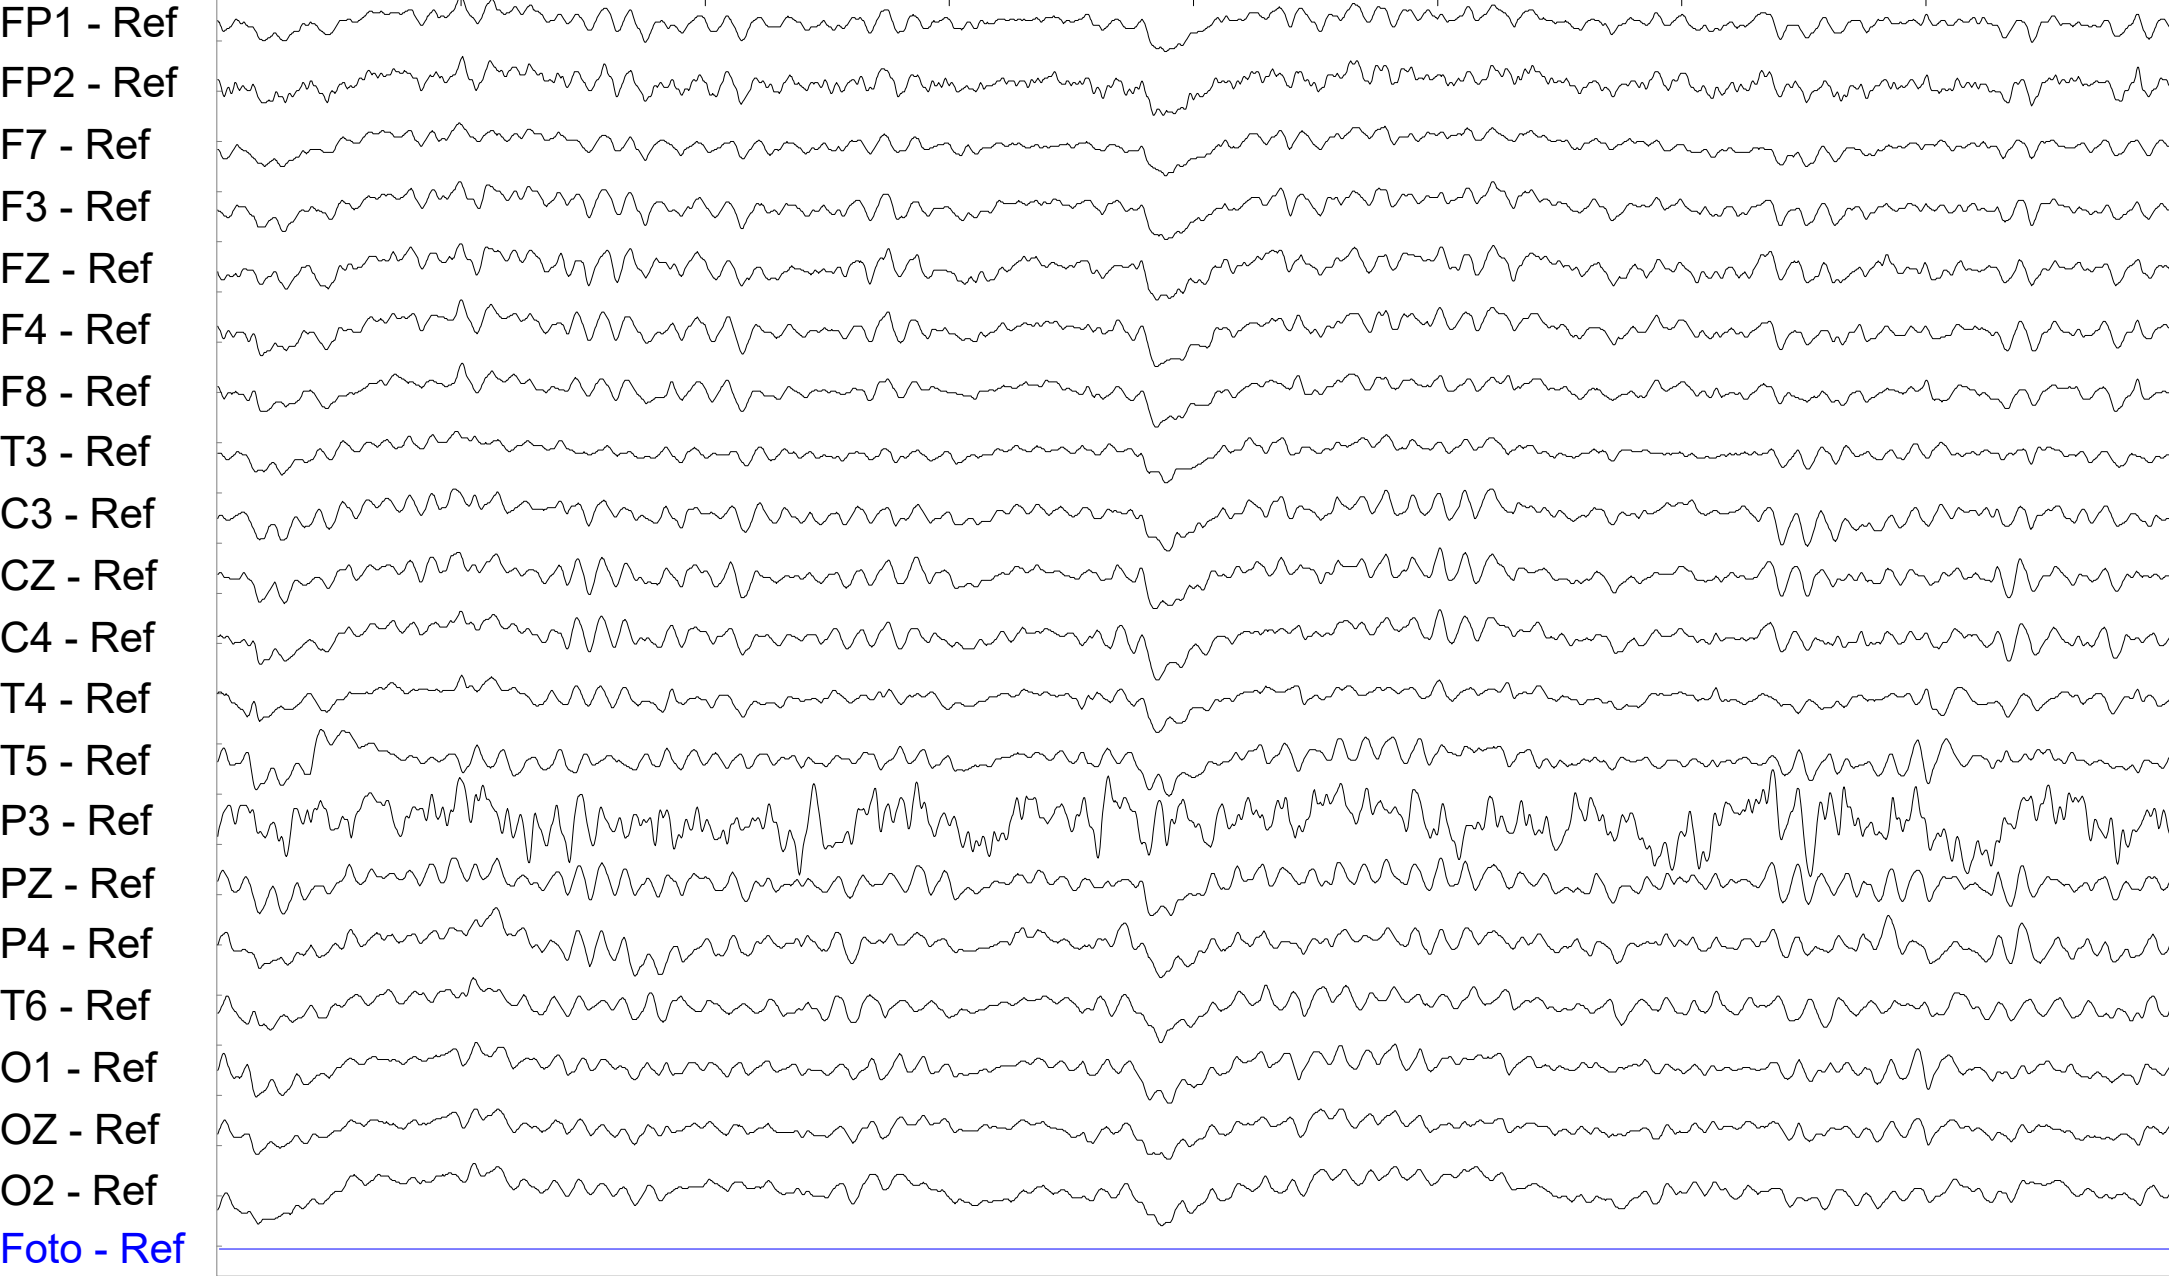


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 19/23 09:20:02 09:20:03 09:20:04 09:20:05 09:20:06 09:20:07 09:20:08 09:20:09
Hiperpneia Hiperpneia Hiperpneia Hiperpneia Hiperpneia Hiperpneia Hiperpneia Hiperpneia

Época: 19 - Horário: 09:20:03 - Estágio: 0 (8 seg.)

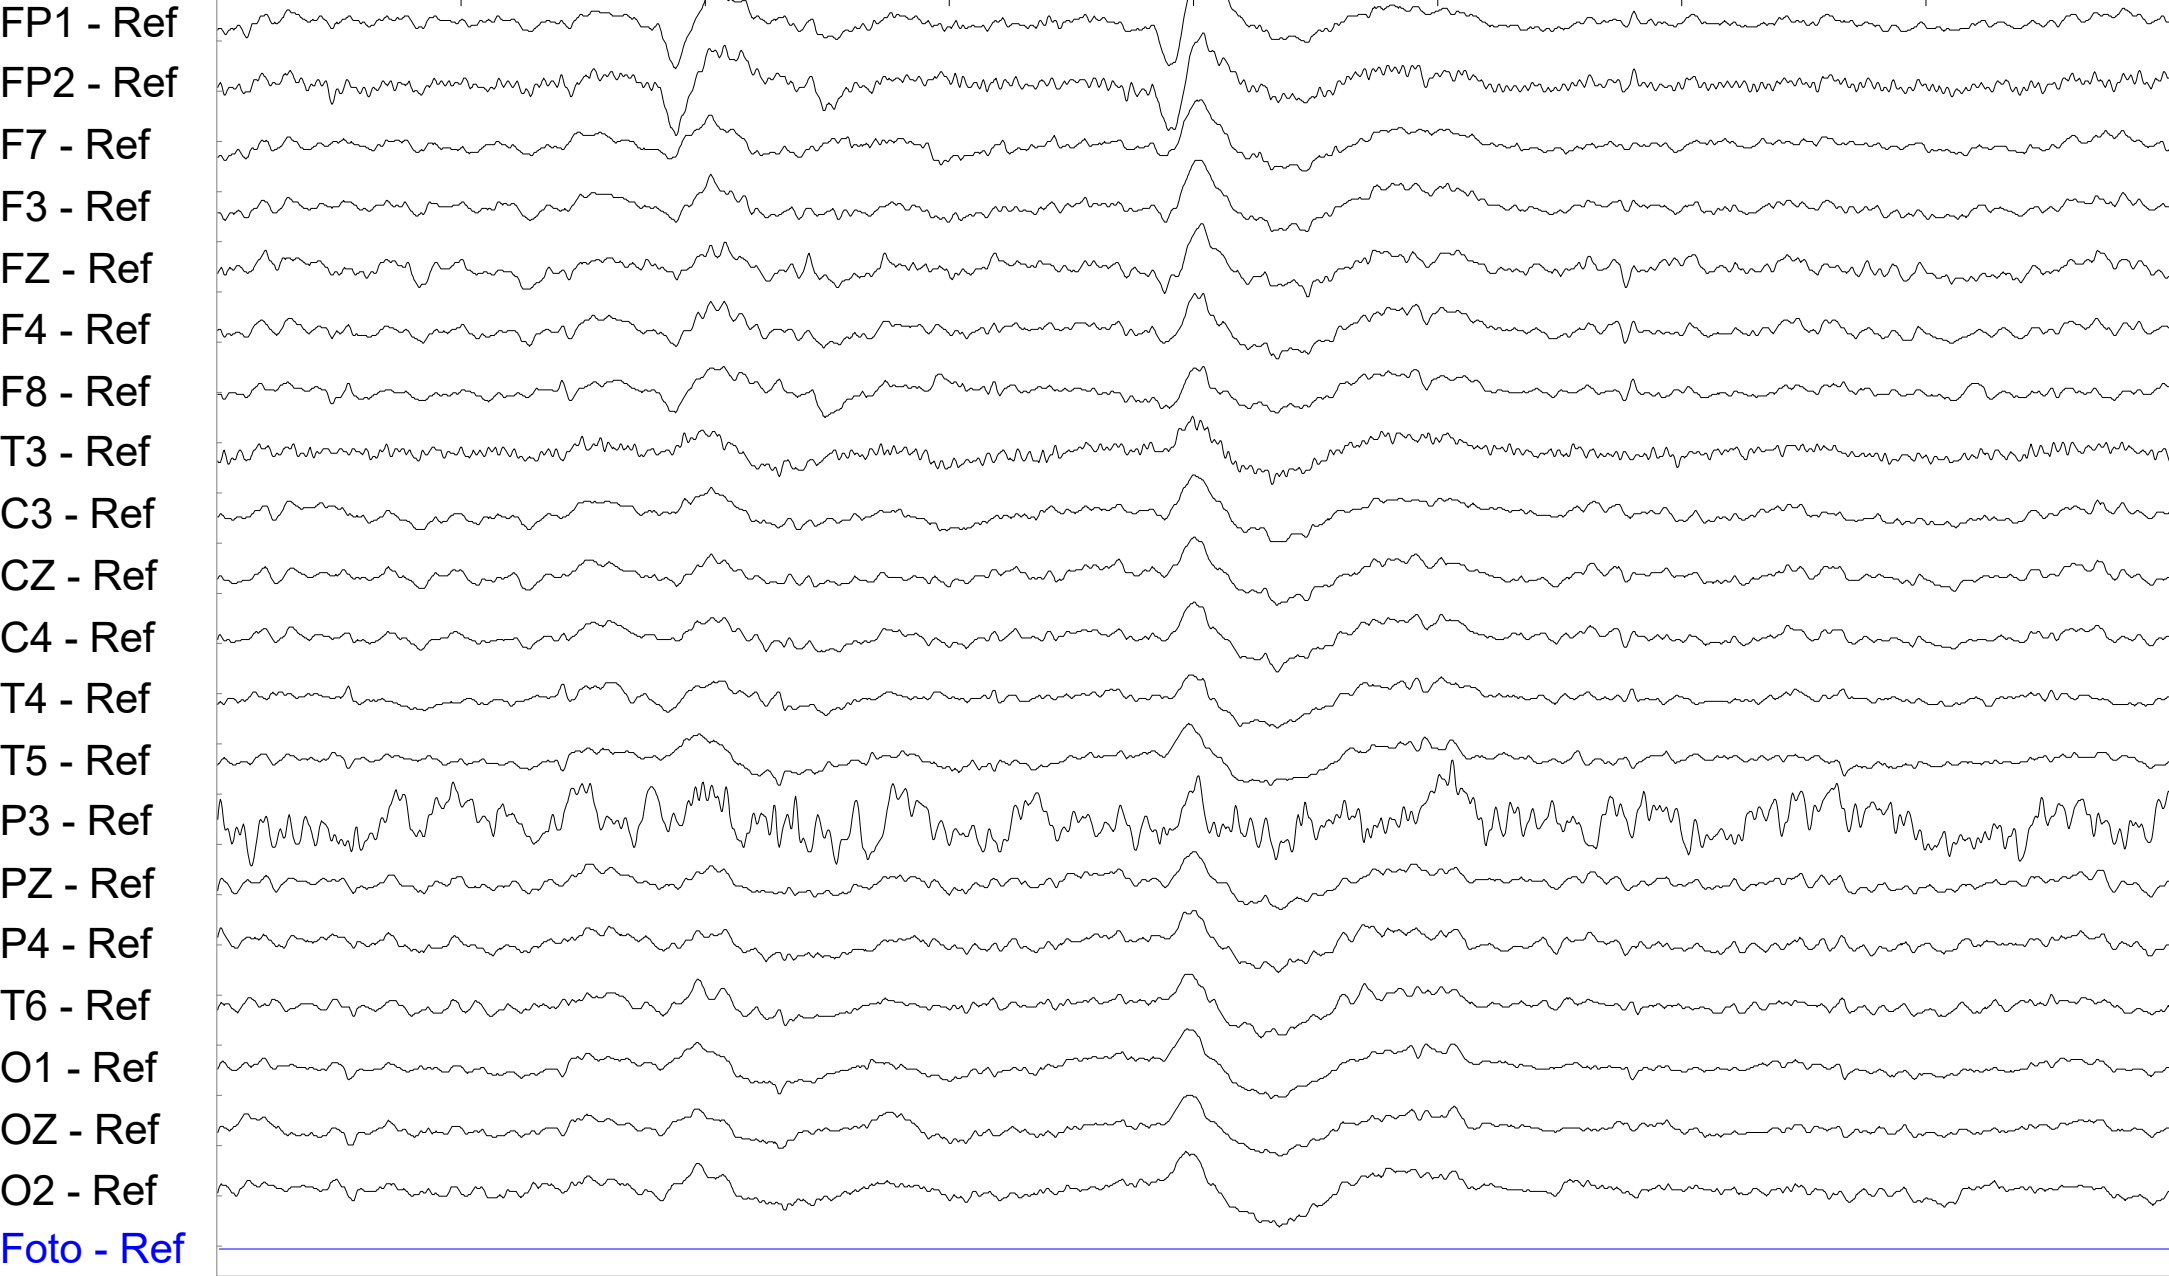



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 22/23

09:21:34 Pós hiperpneia 09:21:35 Pós hiperpneia 09:21:36 Pós hiperpneia 09:21:37 Pós hiperpneia 09:21:38 Pós hiperpneia 09:21:39 Pós hiperpneia 09:21:40 Pós hiperpneia 09:21:41 Pós hiperpneia
Época: 22 - Horário: 09:21:35 - Estágio: 0 (8 seg.)

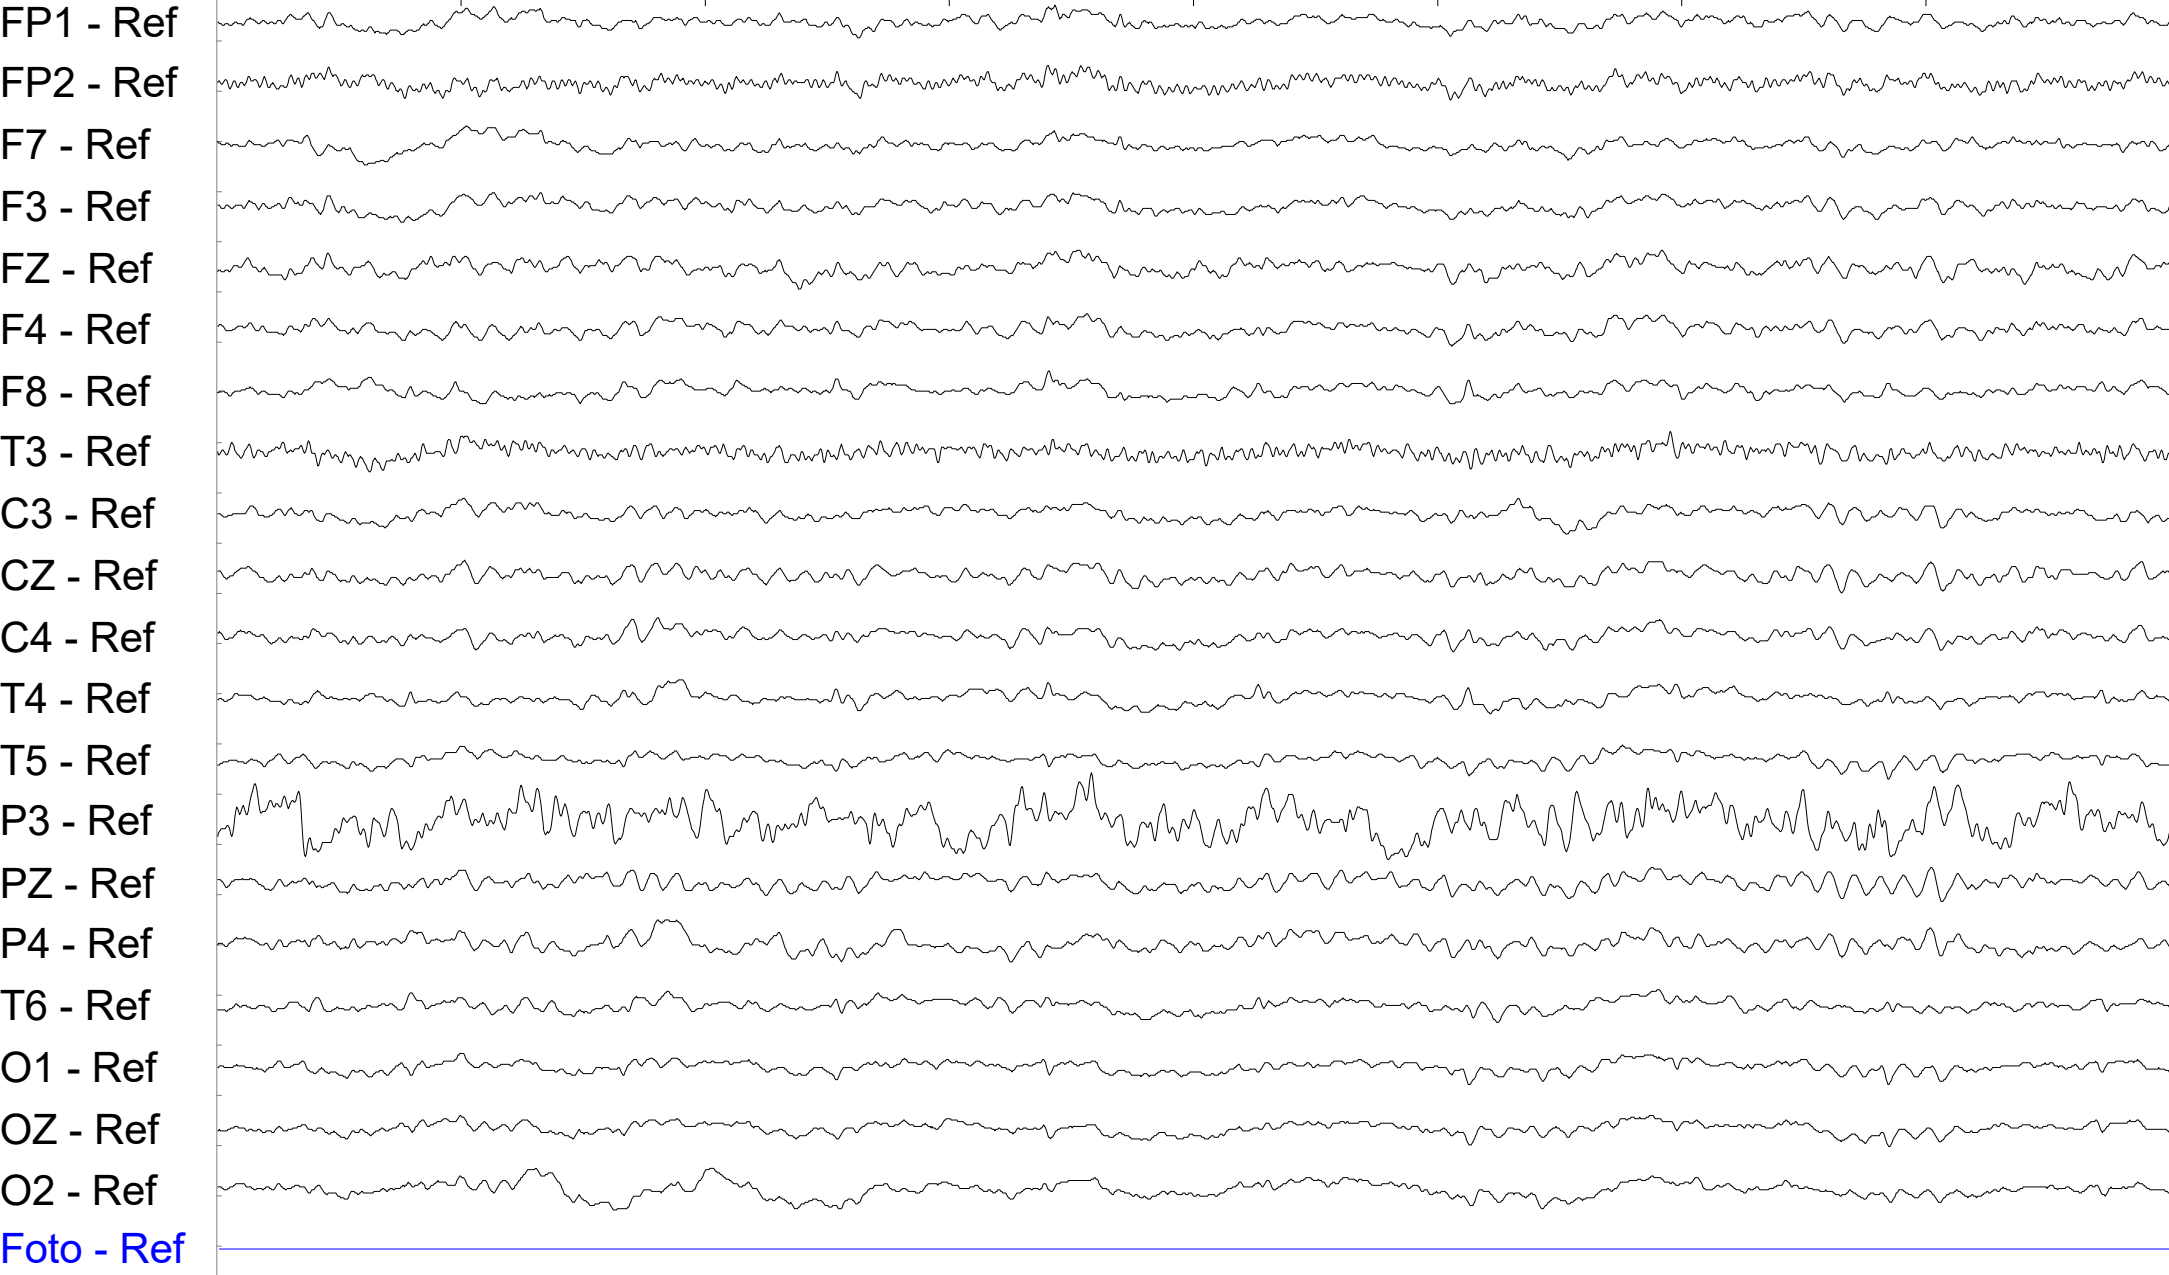



09:22:04
Vigília

09:22:05
Vigília

09:22:06
Vigília

09:22:07
Vigília


09:22:08
Vigília

09:22:09
Vigília

09:22:10
Vigília

09:22:11
Vigília

Época: 23 - Horário: 09:22:05 - Estágio: 0 (8 seg.)

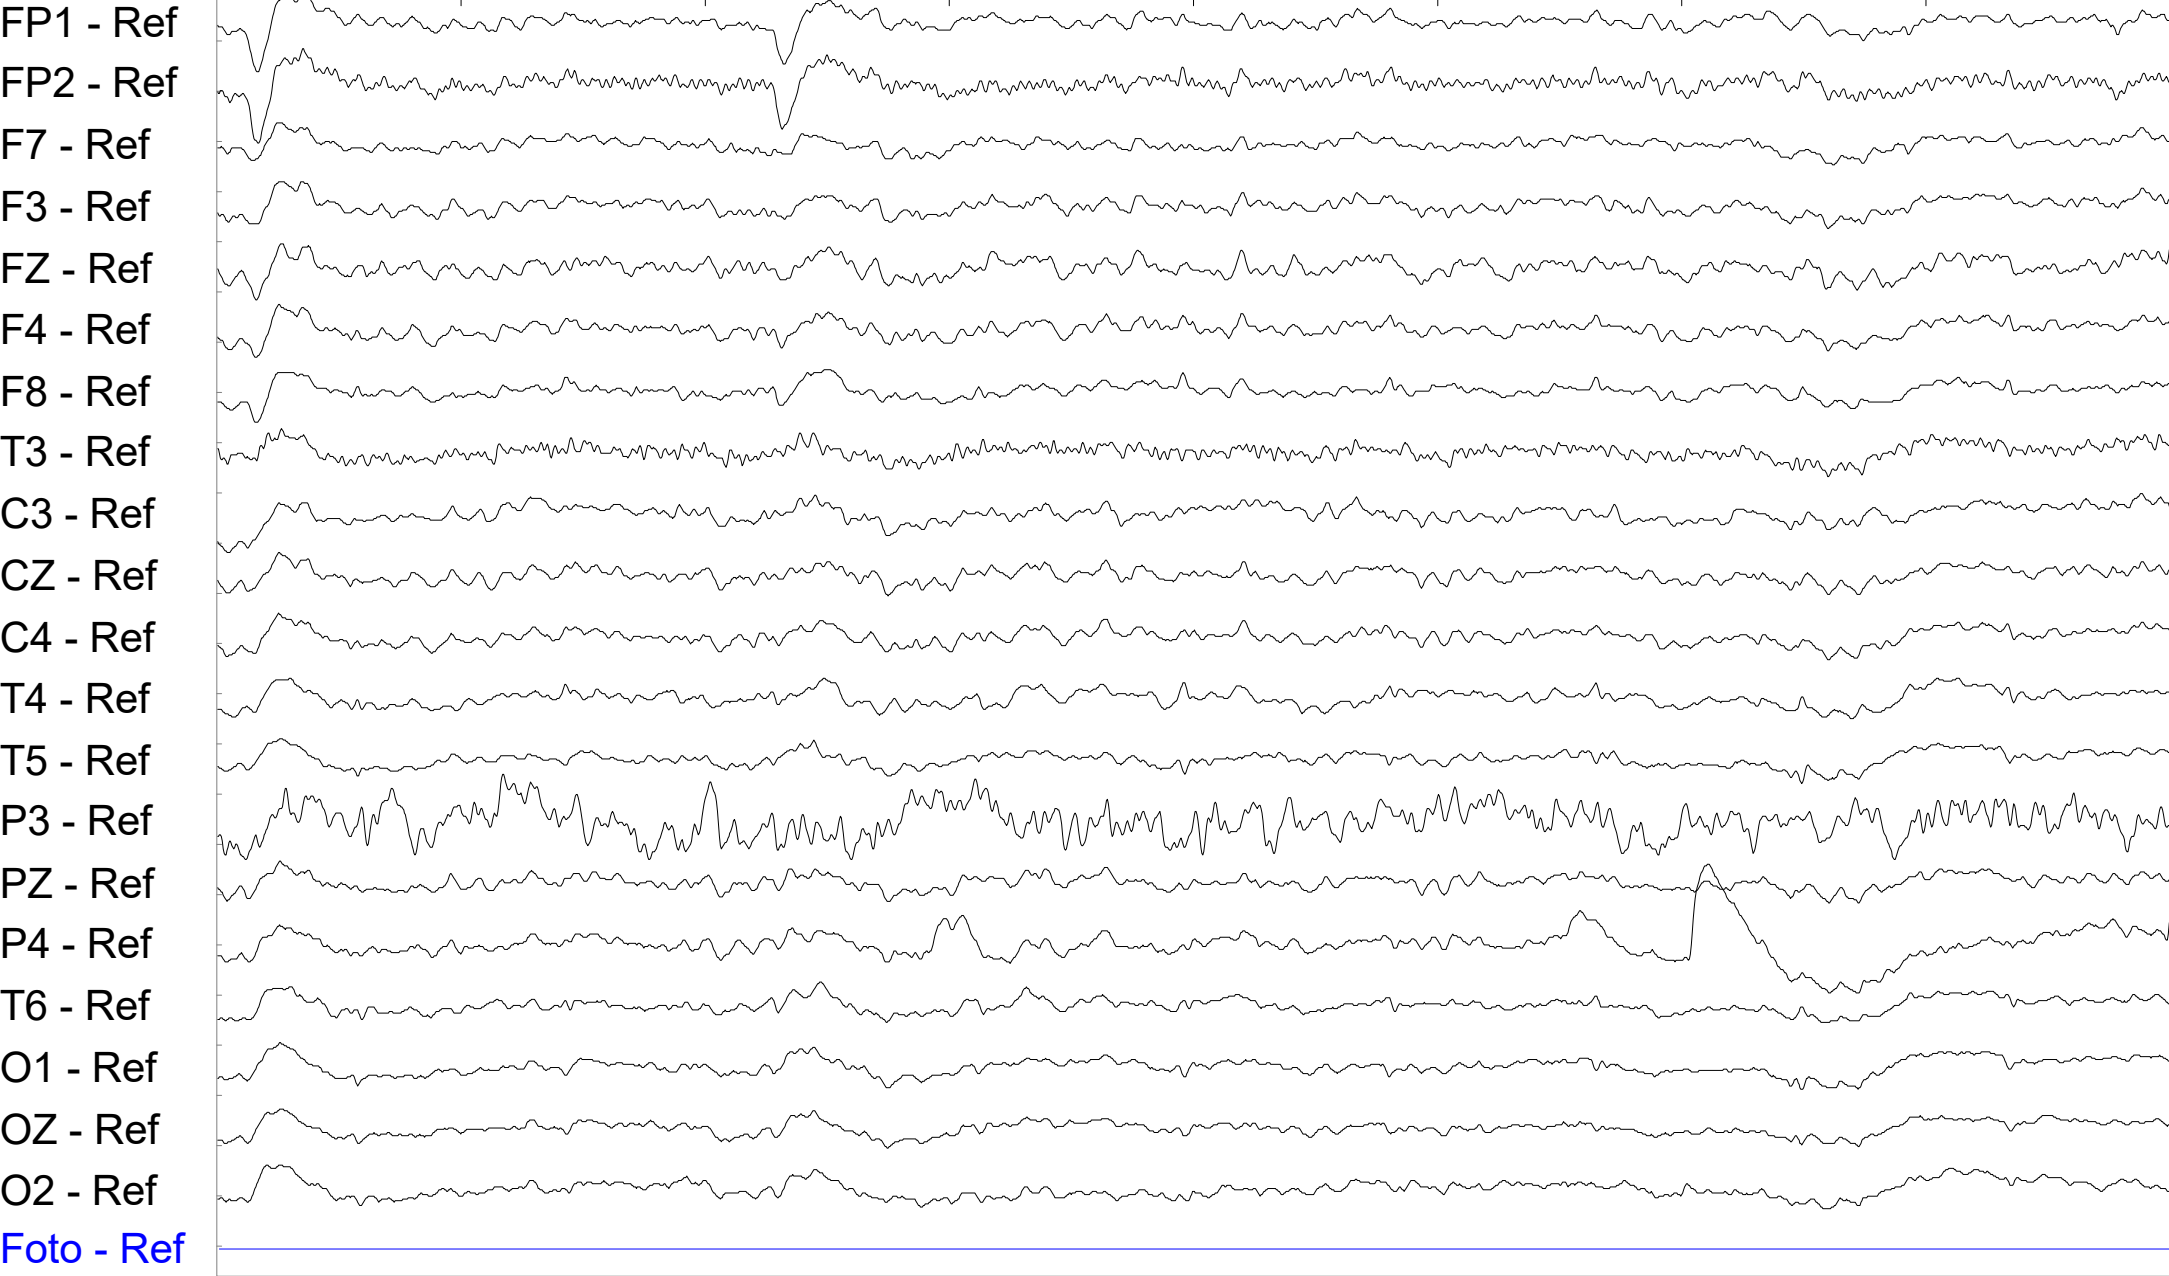



NEUROCLINIC


Informe o nome do médico

Pág. 14/23

09:17:35 Foto Estimulação 09:17:36 Foto Estimulação 09:17:37 Foto Estimulação 09:17:38 Foto Estimulação 09:17:39 Foto Estimulação 09:17:40 Foto Estimulação 09:17:41 Foto Estimulação 09:17:42 Foto Estimulação
Época: 14 - Horário: 09:17:36 - Estágio: 0 (8 seg.)

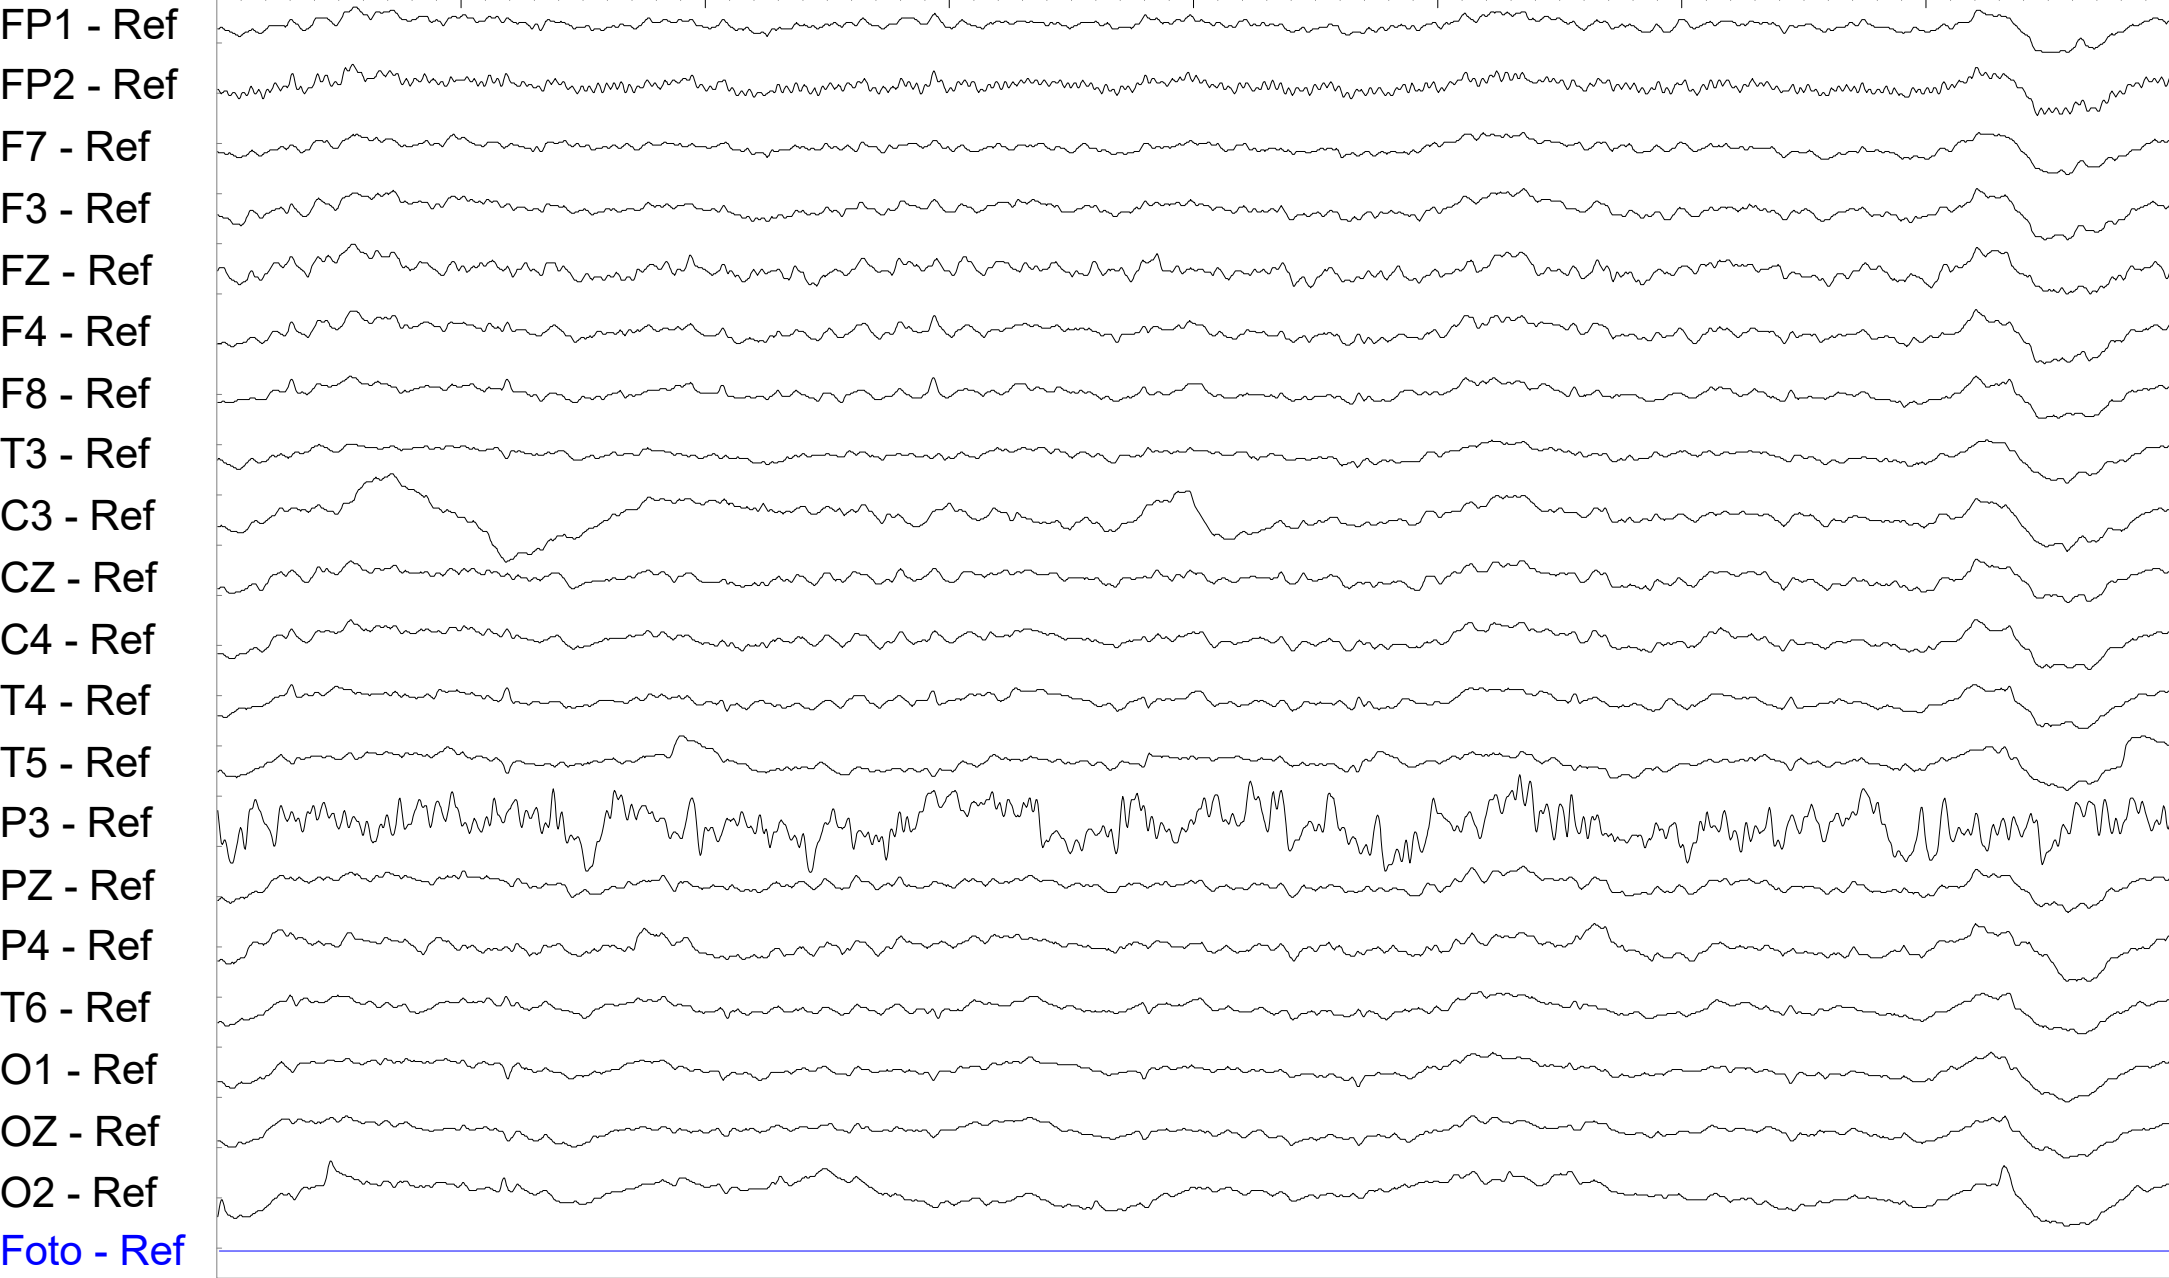

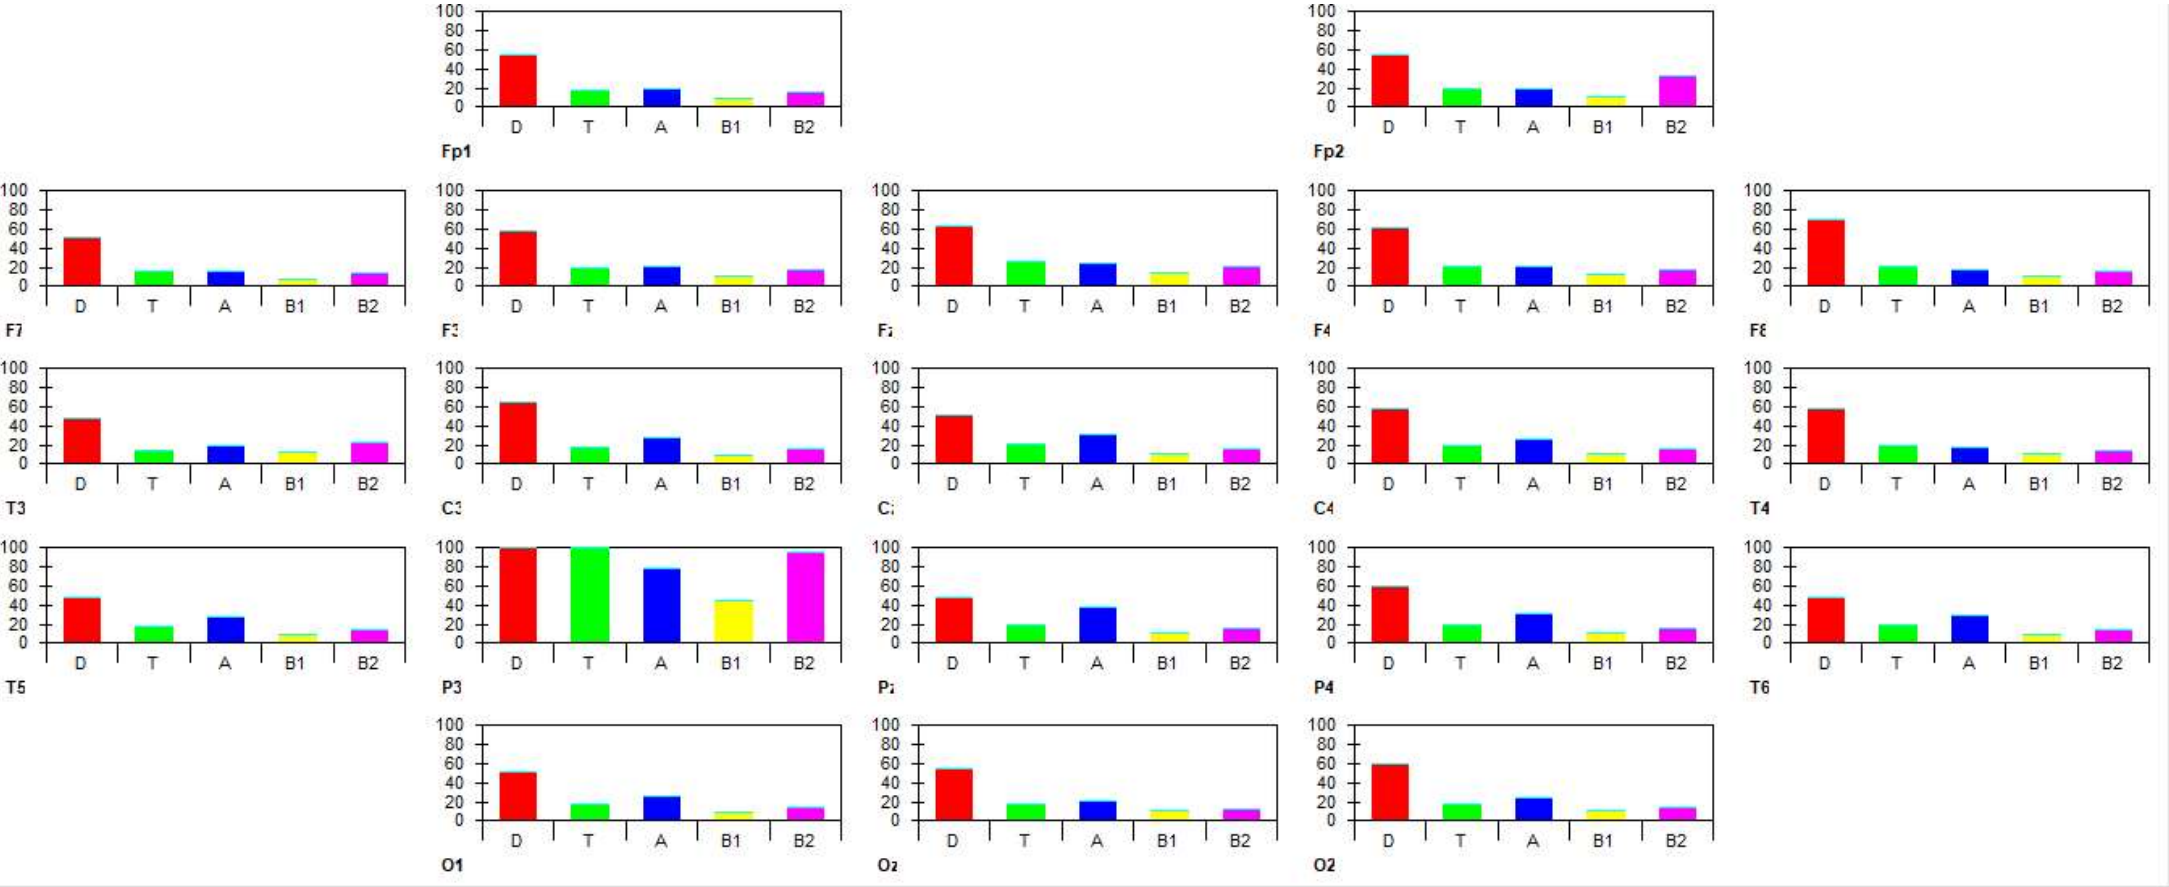

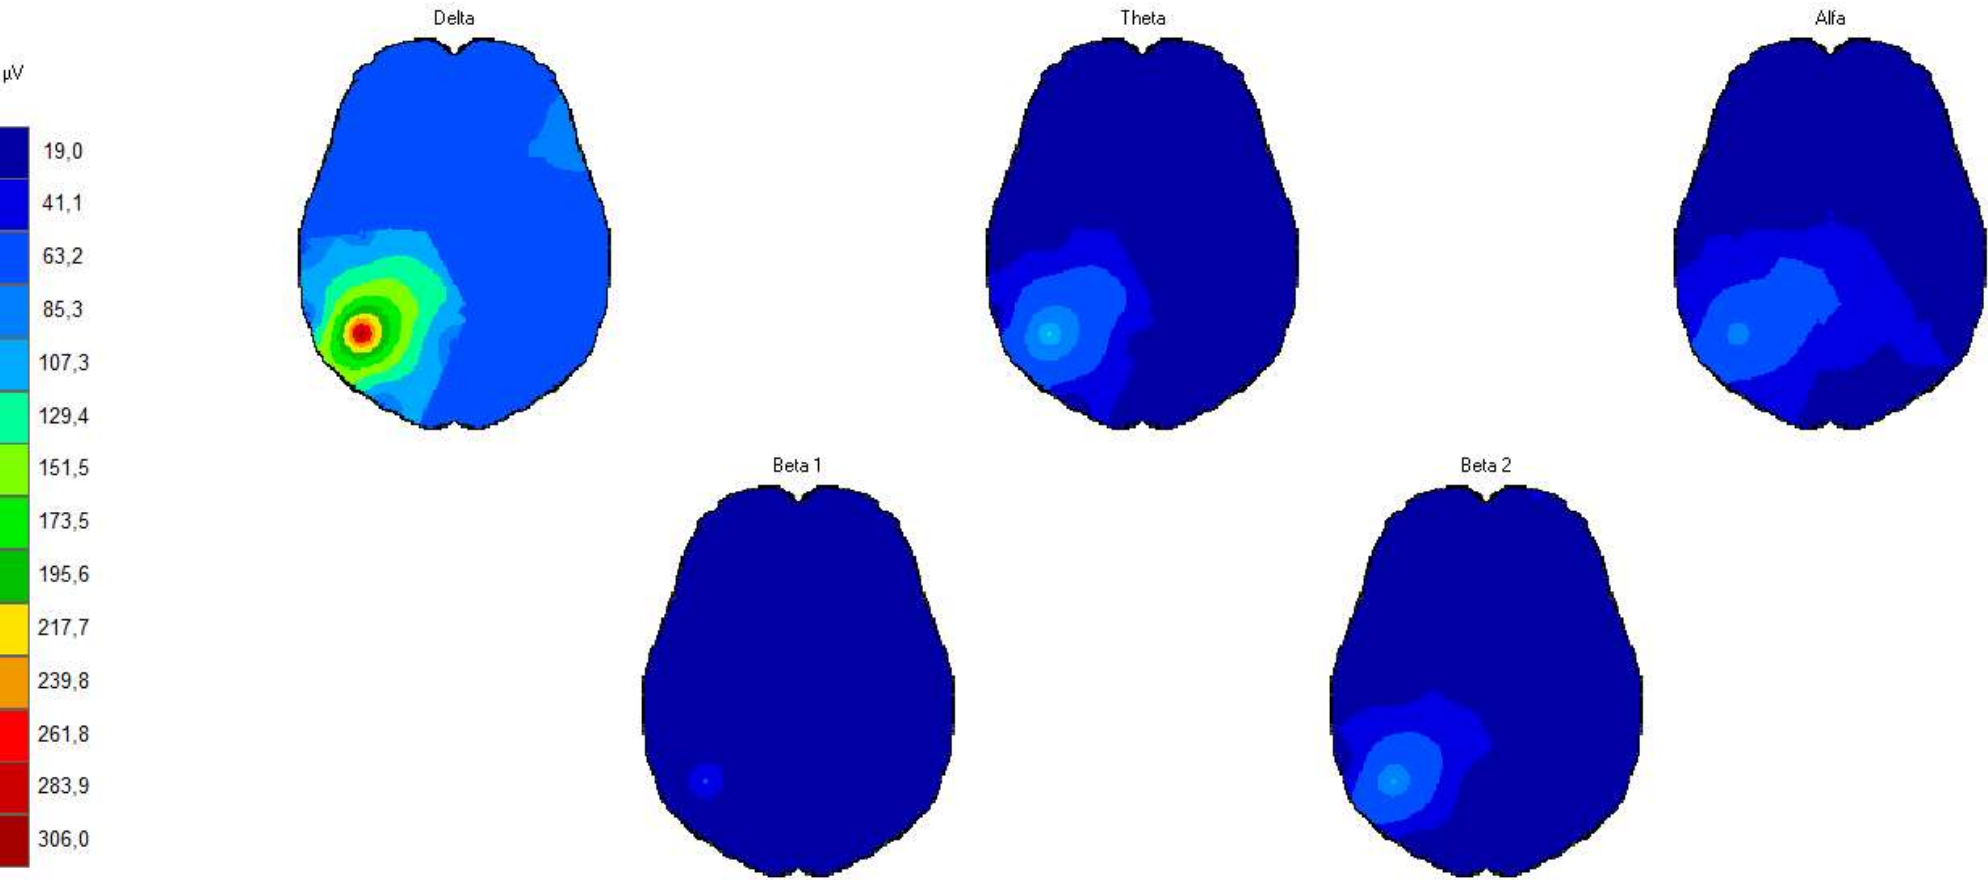

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	54.6	47.0
T	7.5	18.0	15.6
A	8.0	18.7	16.1
B1	13.0	9.0	7.7
B2	18.5	15.7	13.6

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	55.7	40.0
T	7.5	19.6	14.1
A	8.0	20.2	14.5
B1	14.0	11.3	8.1
B2	28.5	32.4	23.3

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	52.4	48.9
T	4.0	15.4	14.4
A	8.5	16.6	15.4
B1	17.0	7.8	7.3
B2	18.5	15.0	14.0

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	58.0	45.8
T	7.5	19.9	15.7
A	8.0	20.3	16.0
B1	17.0	11.1	8.8
B2	18.5	17.3	13.7

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	62.7	42.0
T	4.5	28.7	17.9
A	8.0	24.3	16.3
B1	14.5	14.2	9.5
B2	20.0	21.4	14.3

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	61.4	45.6
T	7.5	21.8	16.2
A	8.0	21.8	16.0
B1	14.5	11.8	8.8
B2	21.5	18.0	13.4

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	69.4	51.4
T	6.0	21.3	15.8
A	8.0	18.0	13.4
B1	16.0	10.8	8.0
B2	19.0	15.4	11.4

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	48.2	41.5
T	7.0	13.9	12.0
A	8.5	18.8	16.2
B1	16.5	12.6	10.9
B2	30.0	22.4	19.3

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	64.3	47.2
T	7.0	18.1	13.3
A	10.5	28.7	21.1
B1	17.0	9.7	7.1
B2	21.5	15.4	11.3

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	51.7	39.9
T	7.0	21.0	16.2
A	10.5	30.5	23.5
B1	13.5	10.8	8.3
B2	21.5	15.7	12.1

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	57.6	44.4
T	4.0	19.2	14.8
A	10.5	25.6	19.7
B1	13.0	11.5	8.9
B2	21.5	15.9	12.2

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	58.4	47.8
T	7.0	19.9	16.3
A	9.0	18.5	15.1
B1	13.0	11.2	9.2
B2	19.0	14.3	11.7

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	48.1	40.5
T	7.0	18.4	15.4
A	9.0	28.0	23.5
B1	13.5	9.8	8.0
B2	19.0	14.9	12.5

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	316.8	48.5
T	7.0	117.2	17.9
A	8.0	79.1	12.1
B1	15.0	45.0	6.9
B2	19.0	95.5	14.8

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	48.1	36.3
T	7.0	19.4	14.8
A	10.5	38.5	29.0
B1	13.5	11.2	8.4
B2	21.5	15.7	11.8

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	59.5	43.3
T	4.0	18.9	13.8
A	10.5	31.7	23.1
B1	13.5	11.5	8.4
B2	19.5	15.9	11.5

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	48.5	40.1
T	7.0	19.5	16.1
A	8.5	29.0	24.0
B1	15.5	9.8	7.9
B2	19.0	14.3	11.8

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	51.5	43.5
T	4.5	17.5	14.8
A	9.5	25.9	21.9
B1	14.5	9.9	8.4
B2	19.0	13.5	11.4

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	54.2	47.3
T	4.5	16.9	14.8
A	10.5	20.8	18.1
B1	14.5	10.2	8.9
B2	21.5	12.6	10.9

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	59.5	47.0
T	4.5	18.0	14.2
A	10.5	24.4	19.3
B1	14.5	10.1	7.9
B2	21.5	14.6	11.5

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	.5	54,6	47,0	7,5	18,0	15,6	8,0	18,7	16,1	13,0	9,0	7,7	18,5	15,7	13,6
FP2	.5	55,7	40,0	7,5	19,6	14,1	8,0	20,2	14,5	14,0	11,3	8,1	28,5	32,4	23,3
F7	.5	52,4	48,9	4,0	15,4	14,4	8,5	16,6	15,4	17,0	7,8	7,3	18,5	15,0	14,0
F3	.5	58,0	45,8	7,5	19,9	15,7	8,0	20,3	16,0	17,0	11,1	8,8	18,5	17,3	13,7
FZ	.5	62,7	42,0	4,5	26,7	17,9	8,0	24,3	16,3	14,5	14,2	9,5	20,0	21,4	14,3
F4	.5	61,4	45,6	7,5	21,8	16,2	8,0	21,6	16,0	14,5	11,8	8,8	21,5	18,0	13,4
F8	.5	69,4	51,4	6,0	21,3	15,8	8,0	18,0	13,4	16,0	10,8	8,0	19,0	15,4	11,4
T3	.5	48,2	41,5	7,0	13,9	12,0	8,5	18,8	16,2	16,5	12,6	10,9	30,0	22,4	19,3
C3	.5	64,3	47,2	7,0	18,1	13,3	10,5	28,7	21,1	17,0	9,7	7,1	21,5	15,4	11,3
CZ	.5	51,7	39,9	7,0	21,0	16,2	10,5	30,5	23,5	13,5	10,8	8,3	21,5	15,7	12,1
C4	.5	57,6	44,4	4,0	19,2	14,8	10,5	25,6	19,7	13,0	11,5	8,9	21,5	15,9	12,2
T4	.5	58,4	47,8	7,0	19,9	16,3	9,0	18,5	15,1	13,0	11,2	9,2	19,0	14,3	11,7
T5	.5	48,1	40,5	7,0	18,4	15,4	9,0	28,0	23,5	13,5	9,6	8,0	19,0	14,9	12,5
P3	1,0	316,8	48,5	7,0	117,2	17,9	8,0	79,1	12,1	15,0	45,0	6,9	19,0	95,5	14,6
PZ	.5	48,1	36,3	7,0	19,4	14,6	10,5	38,5	29,0	13,5	11,2	8,4	21,5	15,7	11,8
P4	.5	59,5	43,3	4,0	18,9	13,8	10,5	31,7	23,1	13,5	11,5	8,4	19,5	15,9	11,5
T6	.5	48,5	40,1	7,0	19,5	16,1	8,5	29,0	24,0	15,5	9,6	7,9	19,0	14,3	11,8
O1	.5	51,5	43,5	4,5	17,5	14,8	9,5	25,9	21,9	14,5	9,9	8,4	19,0	13,5	11,4
OZ	.5	54,2	47,3	4,5	16,9	14,8	10,5	20,8	18,1	14,5	10,2	8,9	21,5	12,6	10,9
O2	.5	59,5	47,0	4,5	18,0	14,2	10,5	24,4	19,3	14,5	10,1	7,9	21,5	14,6	11,5

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	,5	54,6	47,0	7,5	18,0	15,6	8,0	18,7	16,1	13,0	9,0	7,7	18,5	15,7	13,6
FP2	,5	55,7	40,0	7,5	19,6	14,1	8,0	20,2	14,5	14,0	11,3	8,1	28,5	32,4	23,3
F7	,5	52,4	48,9	4,0	15,4	14,4	8,5	16,6	15,4	17,0	7,8	7,3	18,5	15,0	14,0
F3	,5	58,0	45,8	7,5	19,9	15,7	8,0	20,3	16,0	17,0	11,1	8,8	18,5	17,3	13,7
FZ	,5	62,7	42,0	4,5	26,7	17,9	8,0	24,3	16,3	14,5	14,2	9,5	20,0	21,4	14,3
F4	,5	61,4	45,6	7,5	21,8	16,2	8,0	21,6	16,0	14,5	11,8	8,8	21,5	18,0	13,4
F8	,5	69,4	51,4	6,0	21,3	15,8	8,0	18,0	13,4	16,0	10,8	8,0	19,0	15,4	11,4
T3	,5	48,2	41,5	7,0	13,9	12,0	8,5	18,8	16,2	16,5	12,6	10,9	30,0	22,4	19,3
C3	,5	64,3	47,2	7,0	18,1	13,3	10,5	28,7	21,1	17,0	9,7	7,1	21,5	15,4	11,3
CZ	,5	51,7	39,9	7,0	21,0	16,2	10,5	30,5	23,5	13,5	10,8	8,3	21,5	15,7	12,1
C4	,5	57,6	44,4	4,0	19,2	14,8	10,5	25,6	19,7	13,0	11,5	8,9	21,5	15,9	12,2
T4	,5	58,4	47,8	7,0	19,9	16,3	9,0	18,5	15,1	13,0	11,2	9,2	19,0	14,3	11,7
T5	,5	48,1	40,5	7,0	18,4	15,4	9,0	28,0	23,5	13,5	9,6	8,0	19,0	14,9	12,5
P3	1,0	316,8	48,5	7,0	117,2	17,9	8,0	79,1	12,1	15,0	45,0	6,9	19,0	95,5	14,6
PZ	,5	48,1	36,3	7,0	19,4	14,6	10,5	38,5	29,0	13,5	11,2	8,4	21,5	15,7	11,8
P4	,5	59,5	43,3	4,0	18,9	13,8	10,5	31,7	23,1	13,5	11,5	8,4	19,5	15,9	11,5
T6	,5	48,5	40,1	7,0	19,5	16,1	8,5	29,0	24,0	15,5	9,6	7,9	19,0	14,3	11,8
O1	,5	51,5	43,5	4,5	17,5	14,8	9,5	25,9	21,9	14,5	9,9	8,4	19,0	13,5	11,4
OZ	,5	54,2	47,3	4,5	16,9	14,8	10,5	20,8	18,1	14,5	10,2	8,9	21,5	12,6	10,9
O2	,5	59,5	47,0	4,5	18,0	14,2	10,5	24,4	19,3	14,5	10,1	7,9	21,5	14,6	11,5

Relação de modos de gravação e eventos

Pág. 1

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	09:11:03	02:02	Olhos abertos
5	09:13:05	02:28	Olhos fechados
10	09:15:33	01:40	Vigília
13	09:17:13	01:11	Foto Estimulação
13	09:17:20	00:00	Foto 1 hz
13	09:17:25	00:00	Foto 3 hz
13	09:17:30	00:00	Foto 6 hz
14	09:17:35	00:00	Foto Desativado
14	09:17:35	00:00	Foto 1 hz
14	09:17:40	00:00	Foto 3 hz
14	09:17:45	00:00	Foto 6 hz
14	09:17:50	00:00	Foto Desativado
14	09:17:51	00:00	Foto 1 hz
14	09:17:56	00:00	Foto 3 hz
14	09:18:01	00:00	Foto 6 hz
15	09:18:24	01:00	Olhos fechados
15	09:18:06	00:00	Foto Desativado
15	09:18:07	00:00	Foto 1 hz
15	09:18:11	00:00	Foto 3 hz
15	09:18:16	00:00	Foto 6 hz
15	09:18:21	00:00	Foto Desativado
17	09:19:23	01:11	Hiperpneia
20	09:20:34	01:09	Pós hiperpneia
22	09:21:43	00:29	Vigília