


NEUROCLINIC


Informe o nome do médico

Pág. 1/29

16:13:53 Olhos abertos 16:13:54 Olhos abertos 16:13:55 Olhos abertos 16:13:56 Olhos abertos 16:13:57 Olhos abertos 16:13:58 Olhos abertos 16:13:59 Olhos abertos 16:14:00 Olhos abertos


Época: 1 - Horário: 16:13:54 - Estágio: 0 (8 seg.)

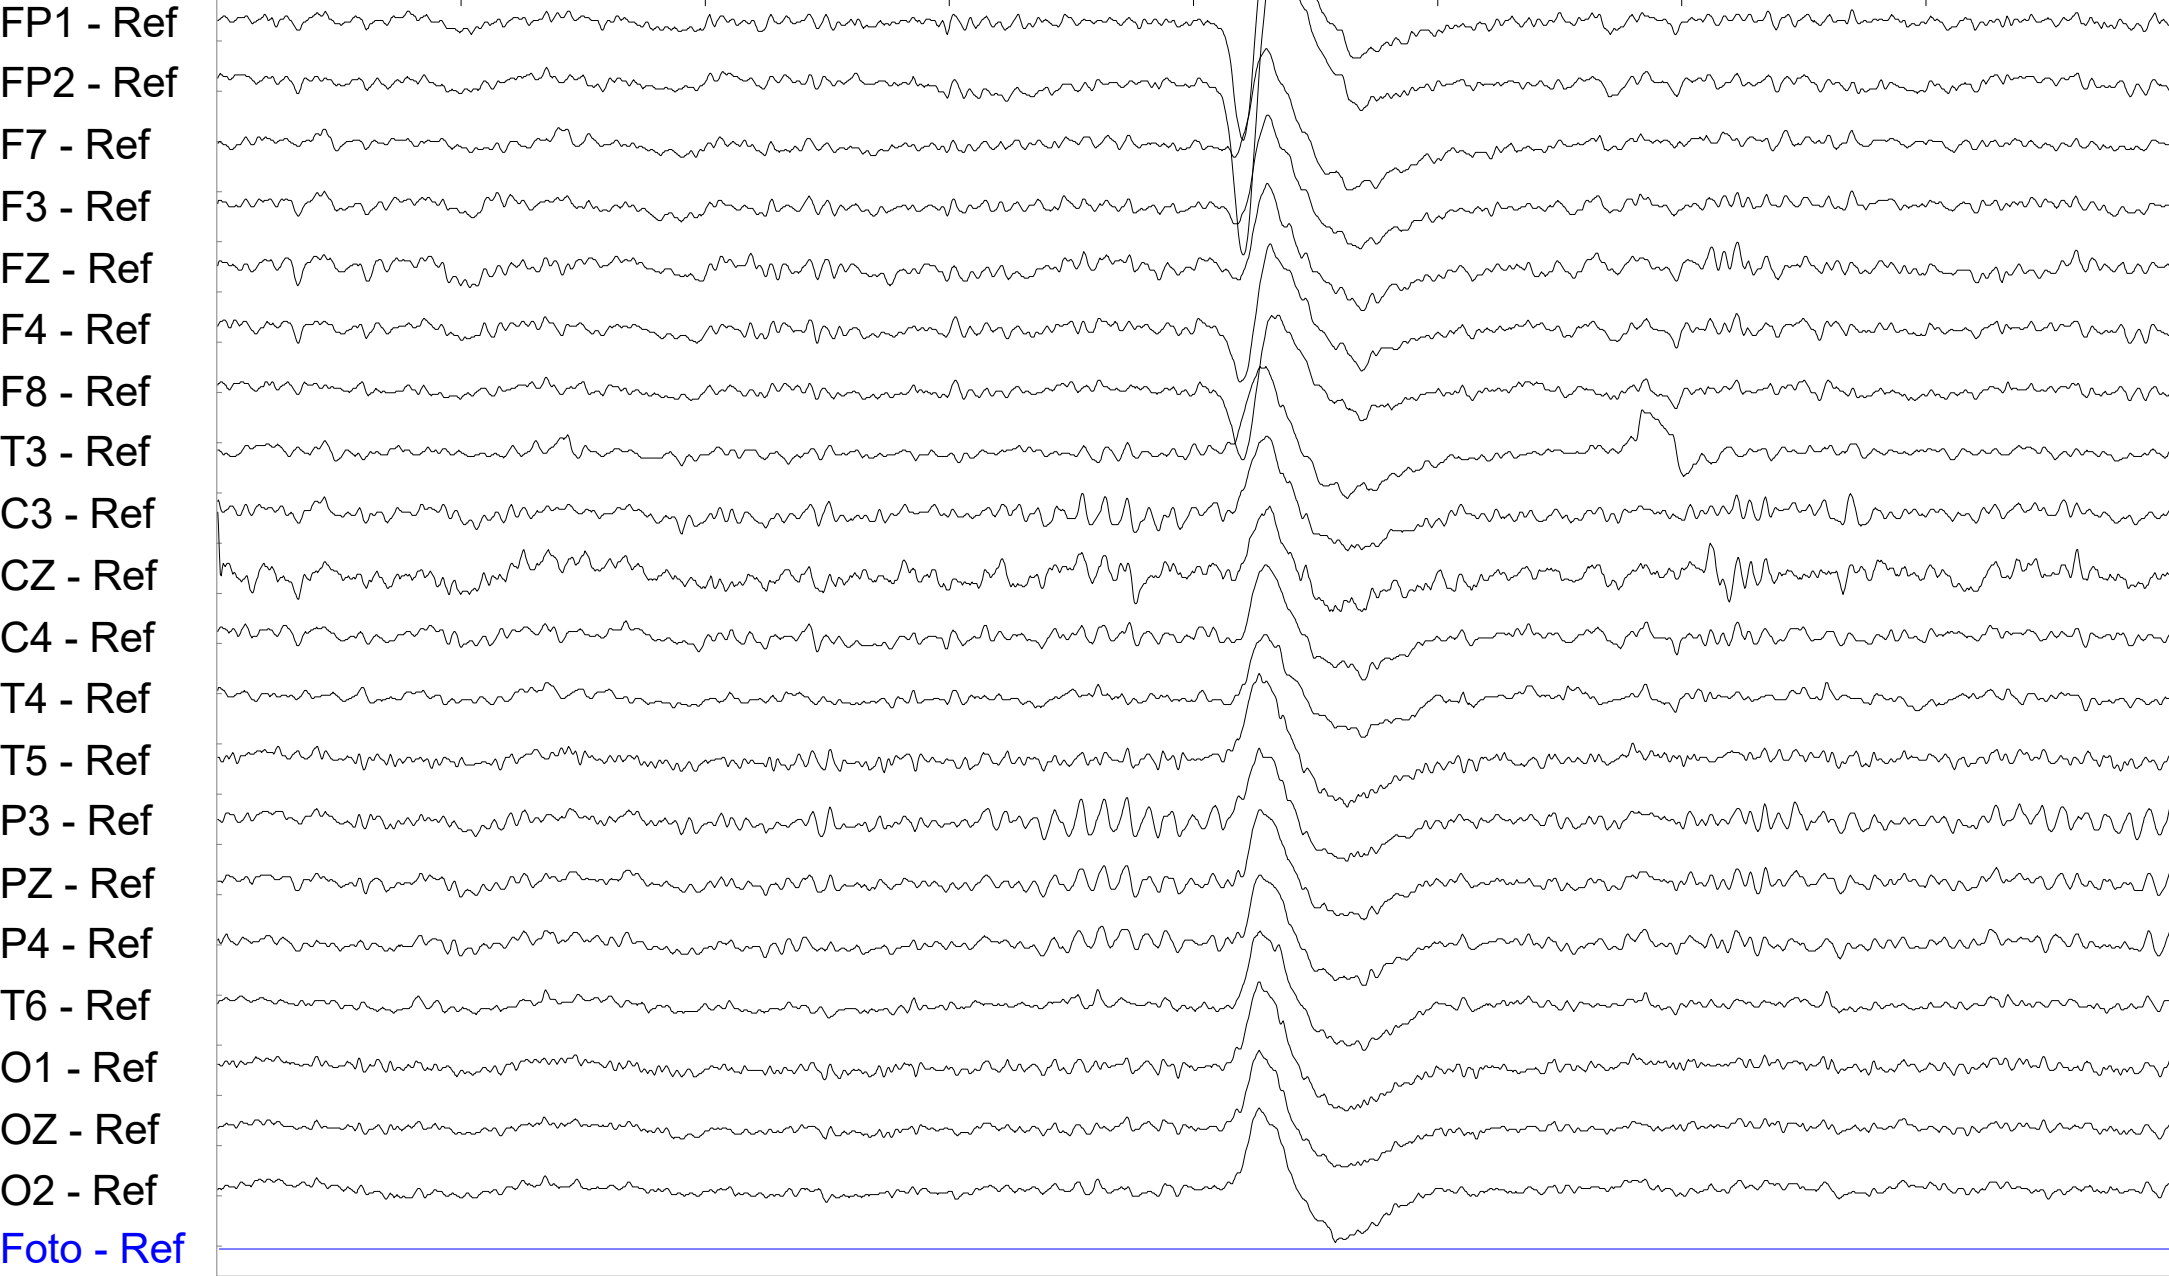



16:15:53 Olhos abertos 16:15:54 Olhos abertos 16:15:55 Olhos abertos 16:15:56 Olhos abertos 16:15:57 Olhos abertos 16:15:58 Olhos abertos 16:15:59 Olhos abertos 16:16:00 Olhos abertos

Época: 5 - Horário: 16:15:54 - Estágio: 0 (8 seg.)

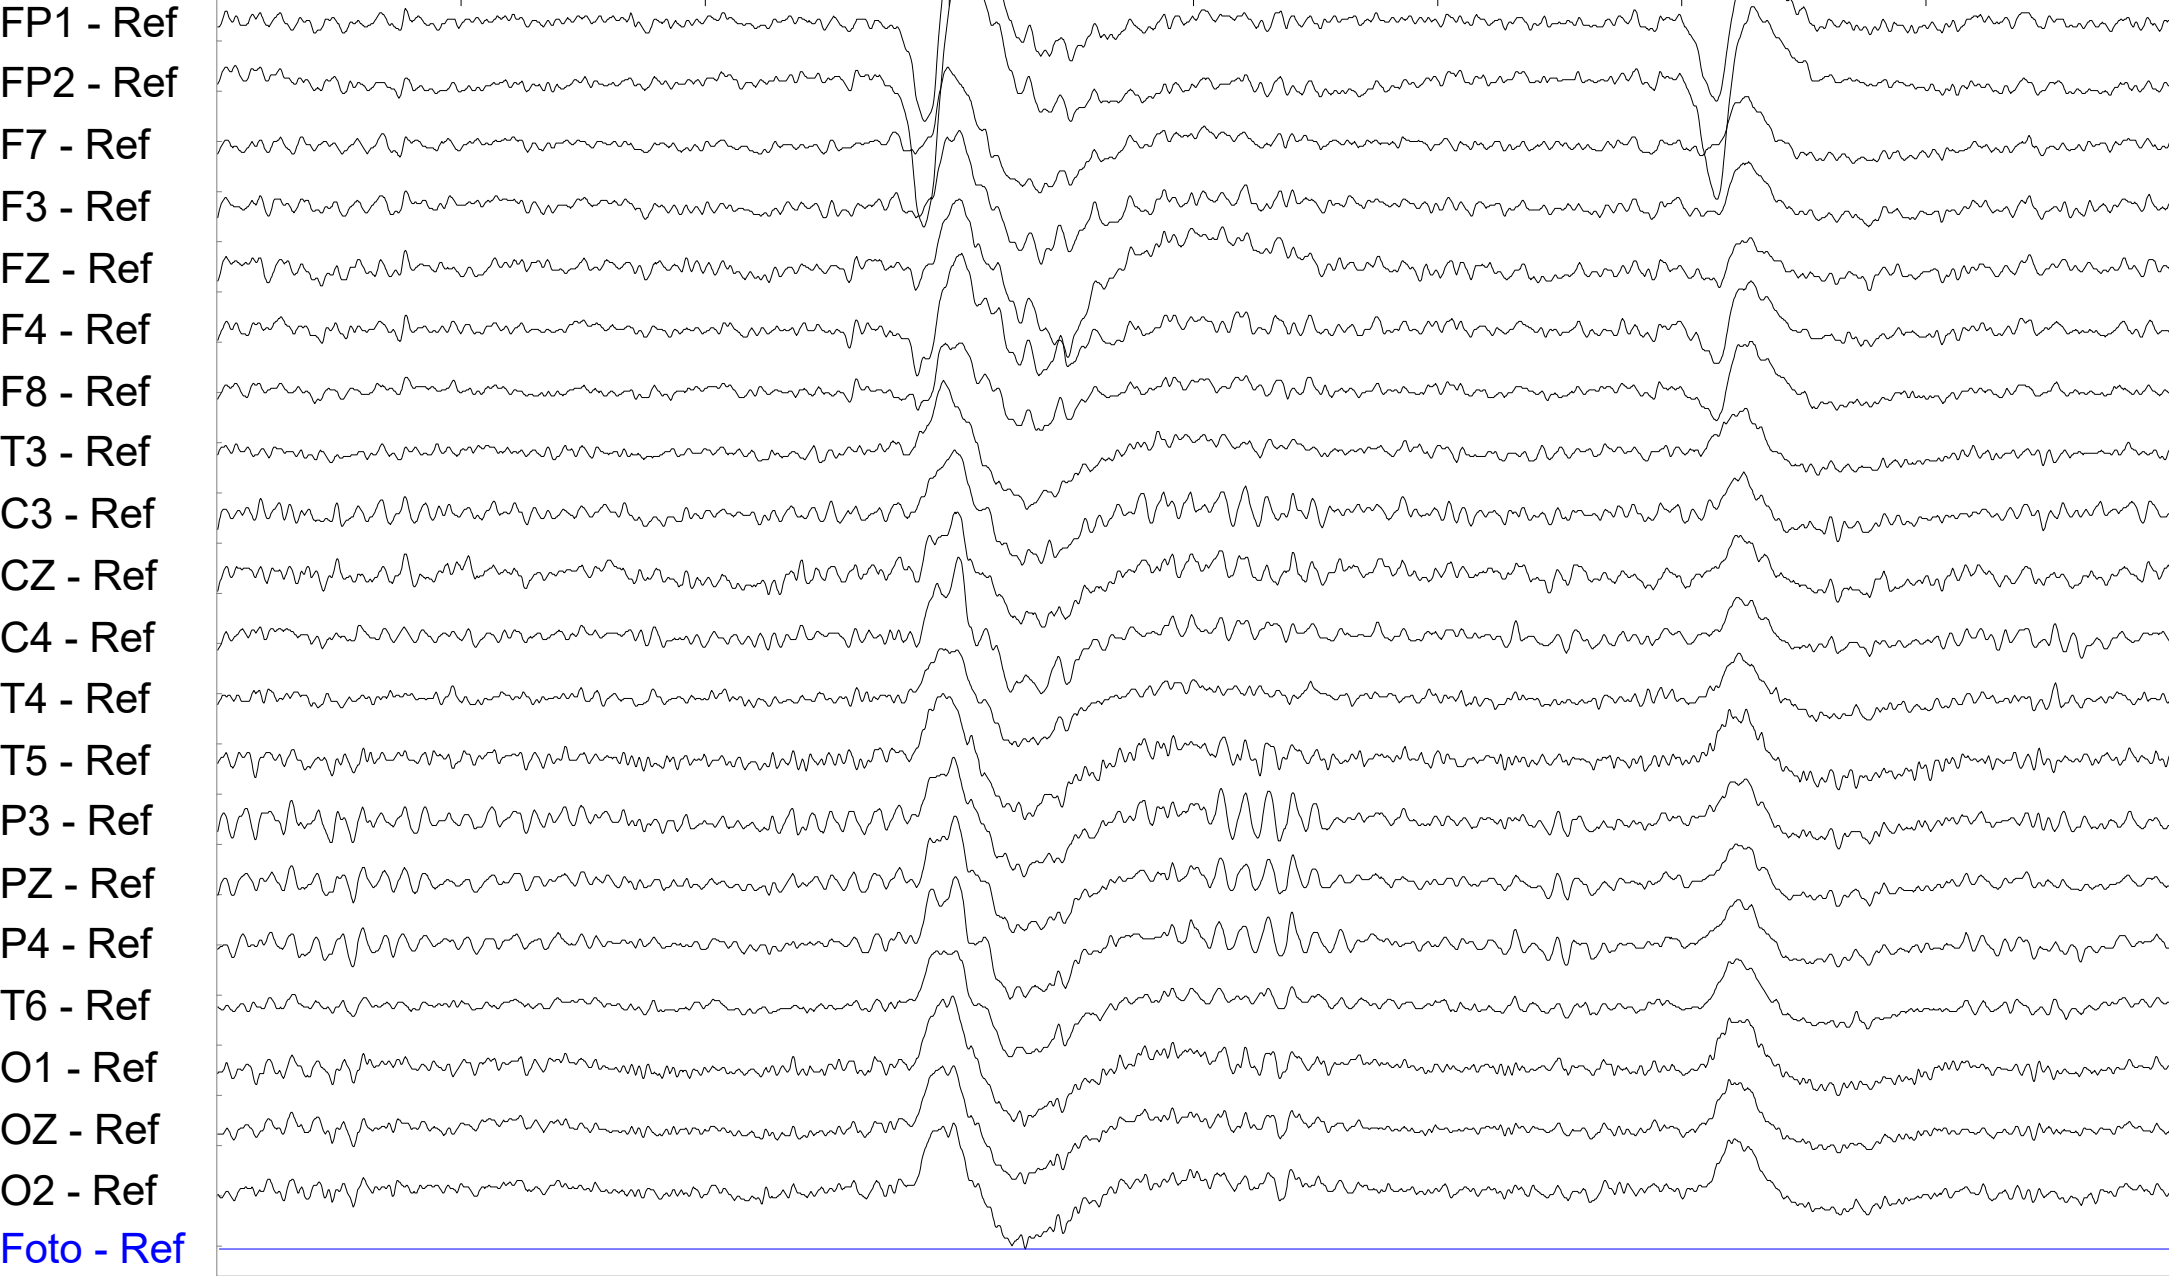


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 9/29

16:17:53 Olhos fechados 16:17:54 Olhos fechados 16:17:55 Olhos fechados 16:17:56 Olhos fechados 16:17:57 Olhos fechados 16:17:58 Olhos fechados 16:17:59 Olhos fechados 16:18:00 Olhos fechados

Época: 9 - Horário: 16:17:54 - Estágio: 0 (8 seg.)

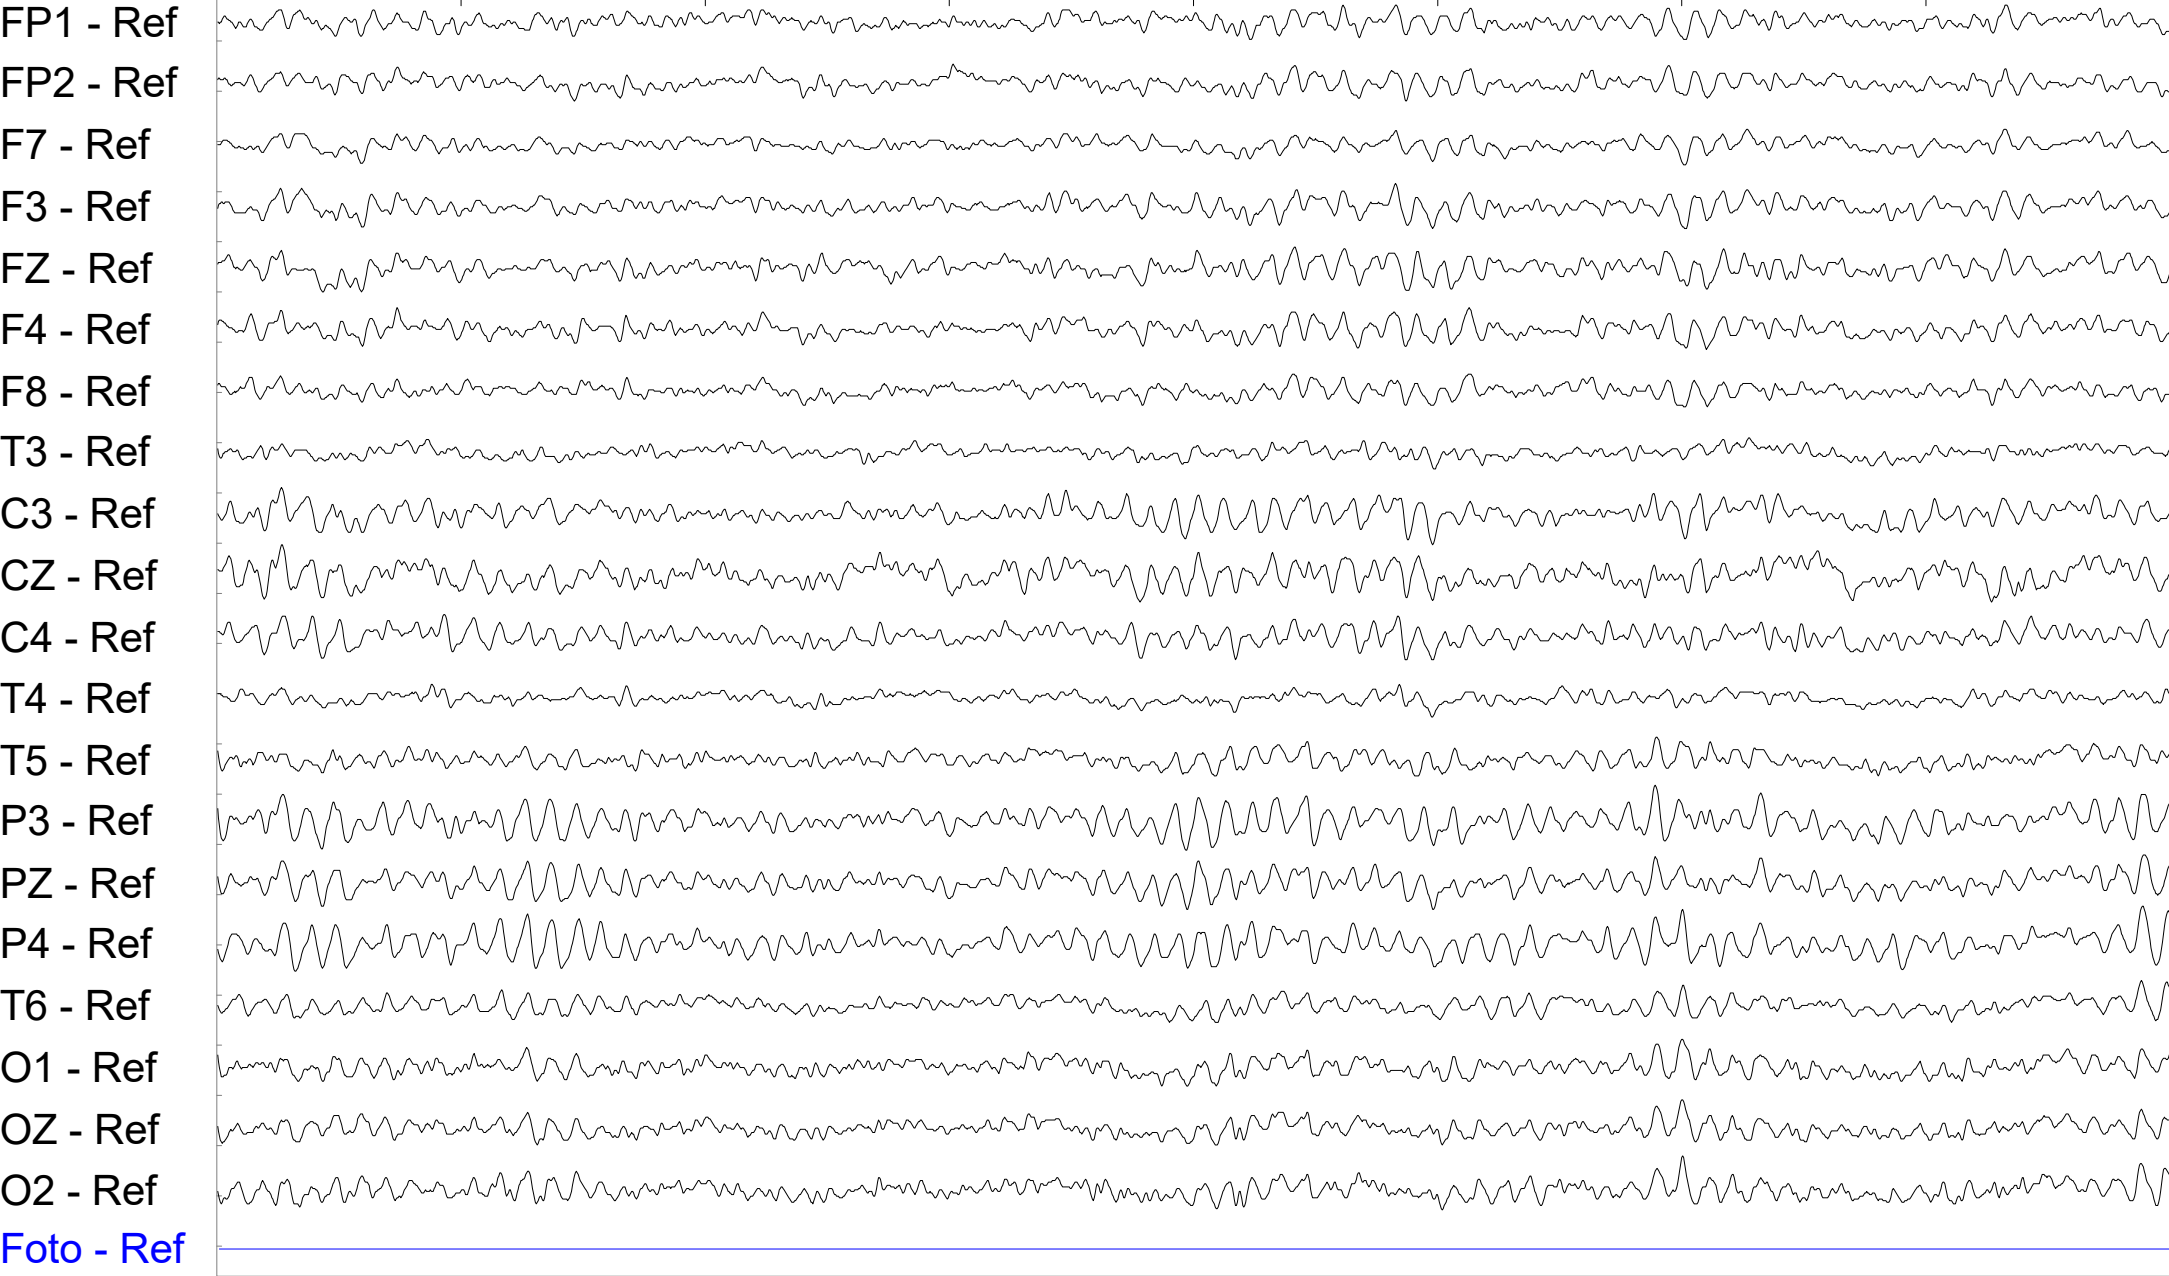



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 10/29

16:18:23 Olhos fechados 16:18:24 Olhos fechados 16:18:25 Olhos fechados 16:18:26 Olhos fechados 16:18:27 Olhos fechados 16:18:28 Olhos fechados 16:18:29 Olhos fechados 16:18:30 Olhos fechados
Época: 10 - Horário: 16:18:24 - Estágio: 0 (8 seg.)

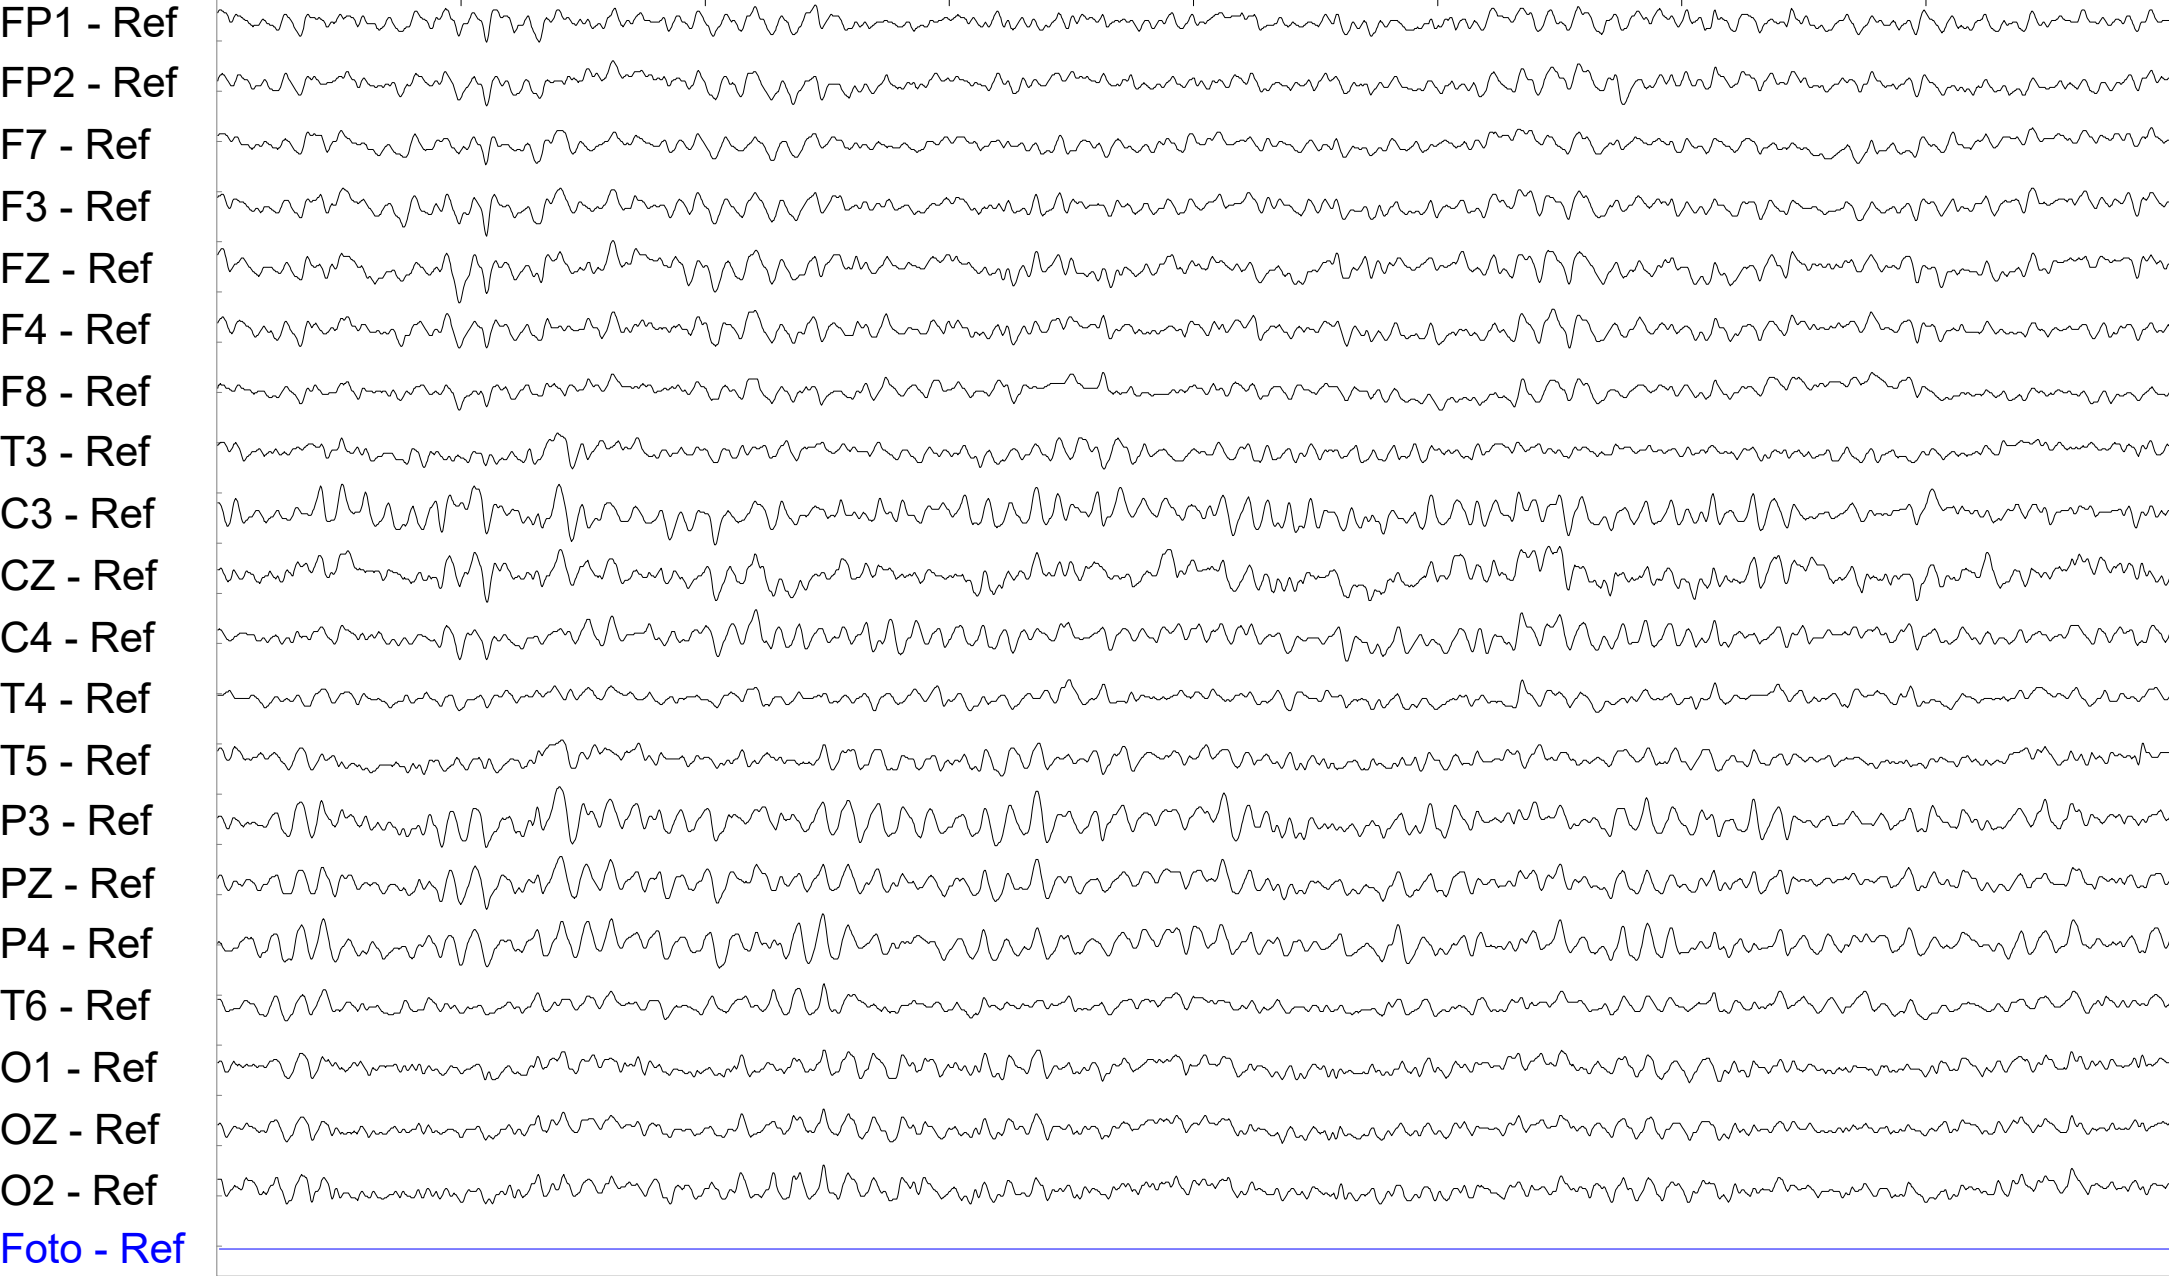

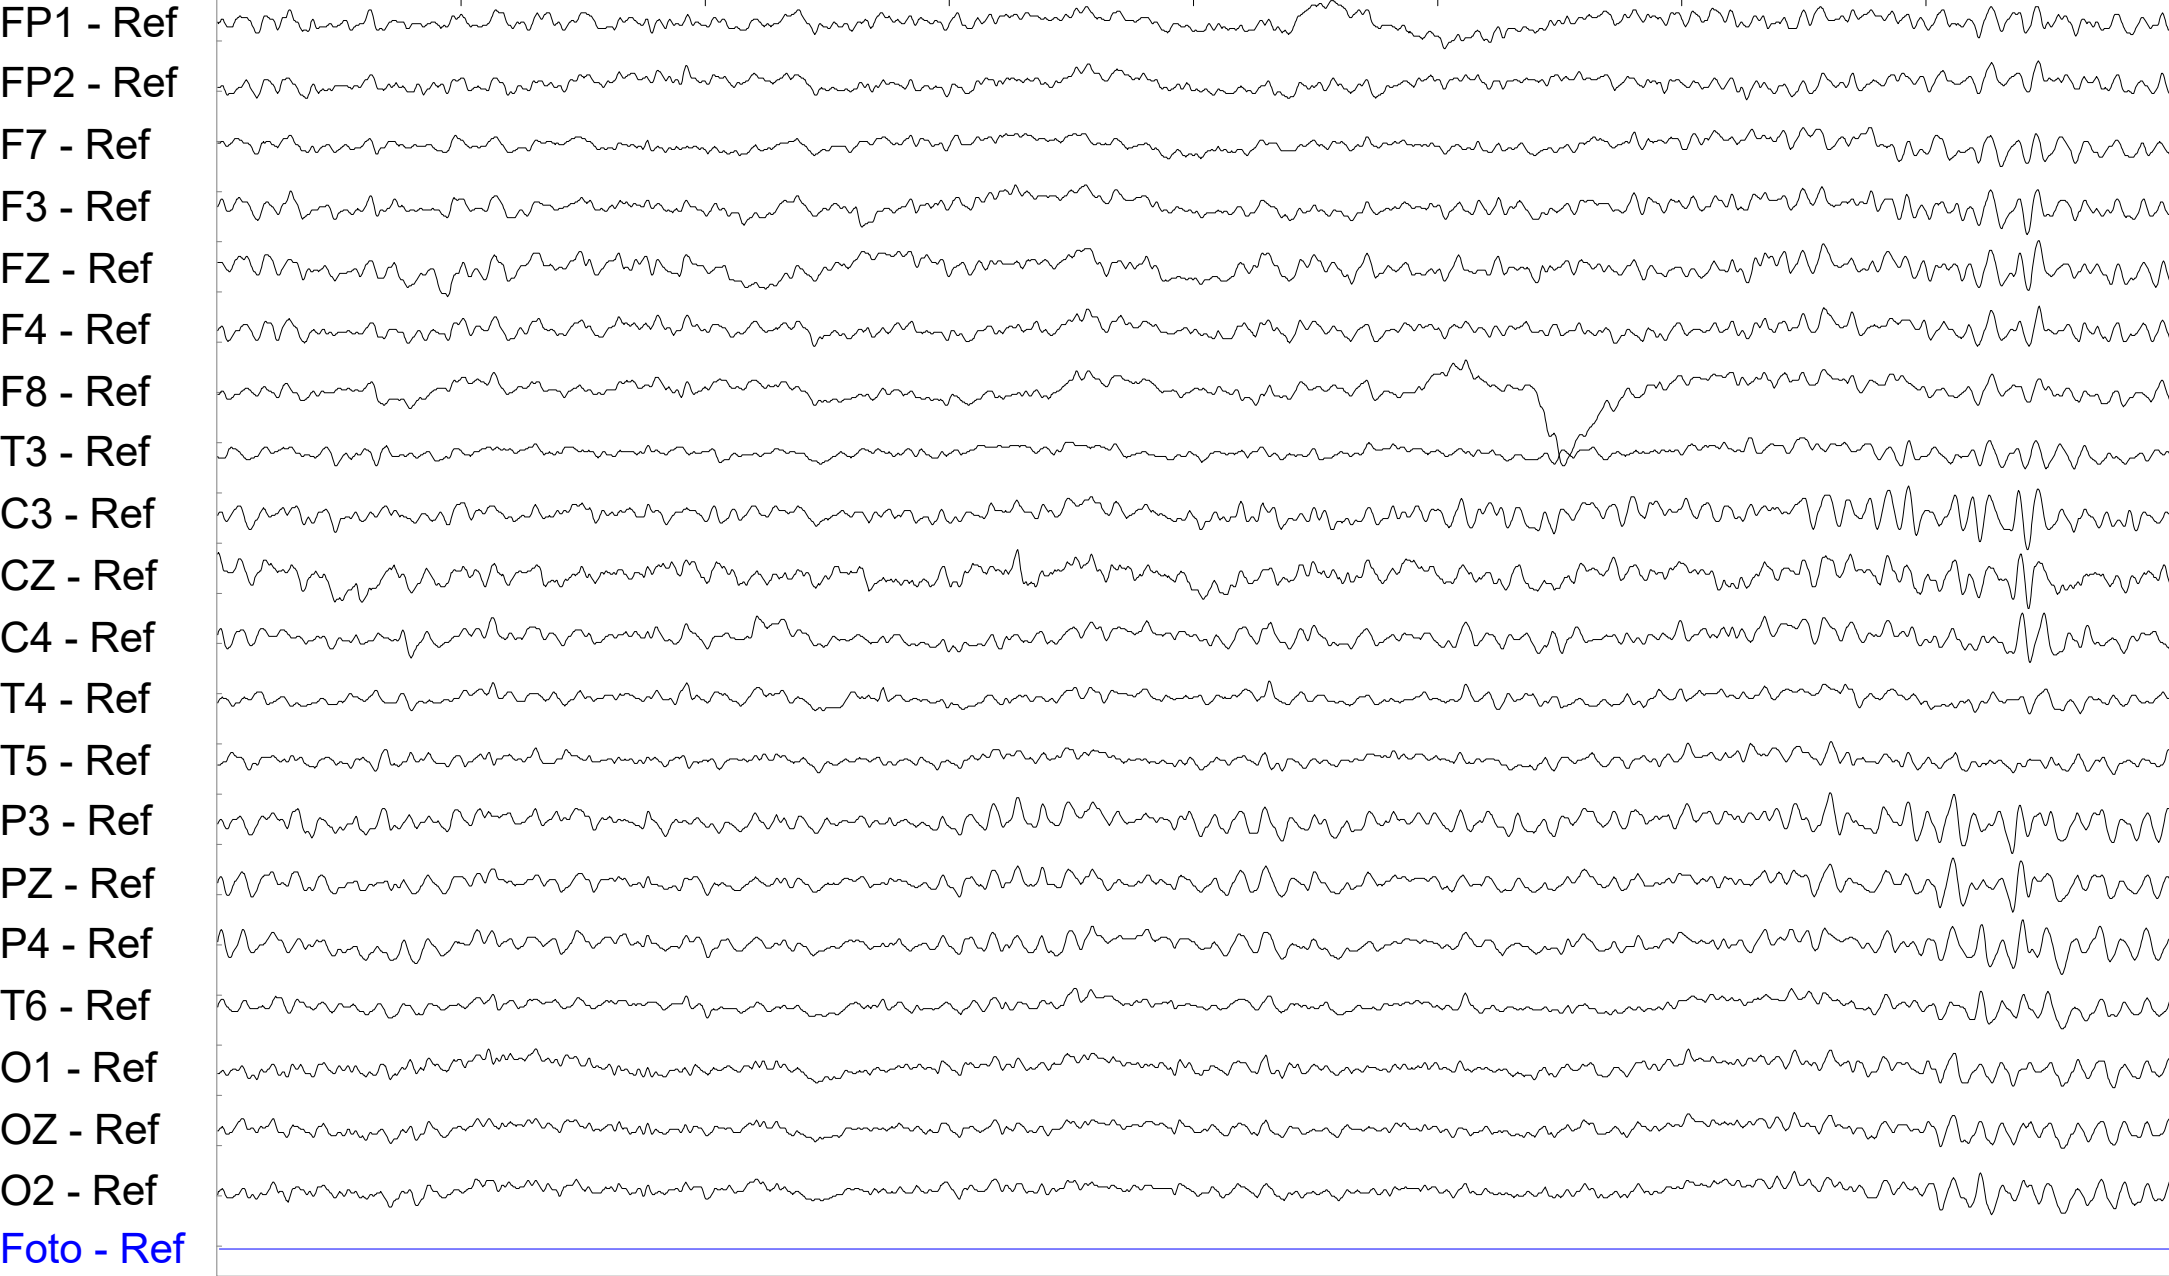

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 17/29

16:21:53

Vigília

16:21:54

Vigília

16:21:55

Vigília

16:21:56

Vigília

16:21:57

Vigília

16:21:58

Vigília


16:21:59

Vigília

16:22:00

Vigília


Época: 17 - Horário: 16:21:54 - Estágio: 0 (8 seg.)

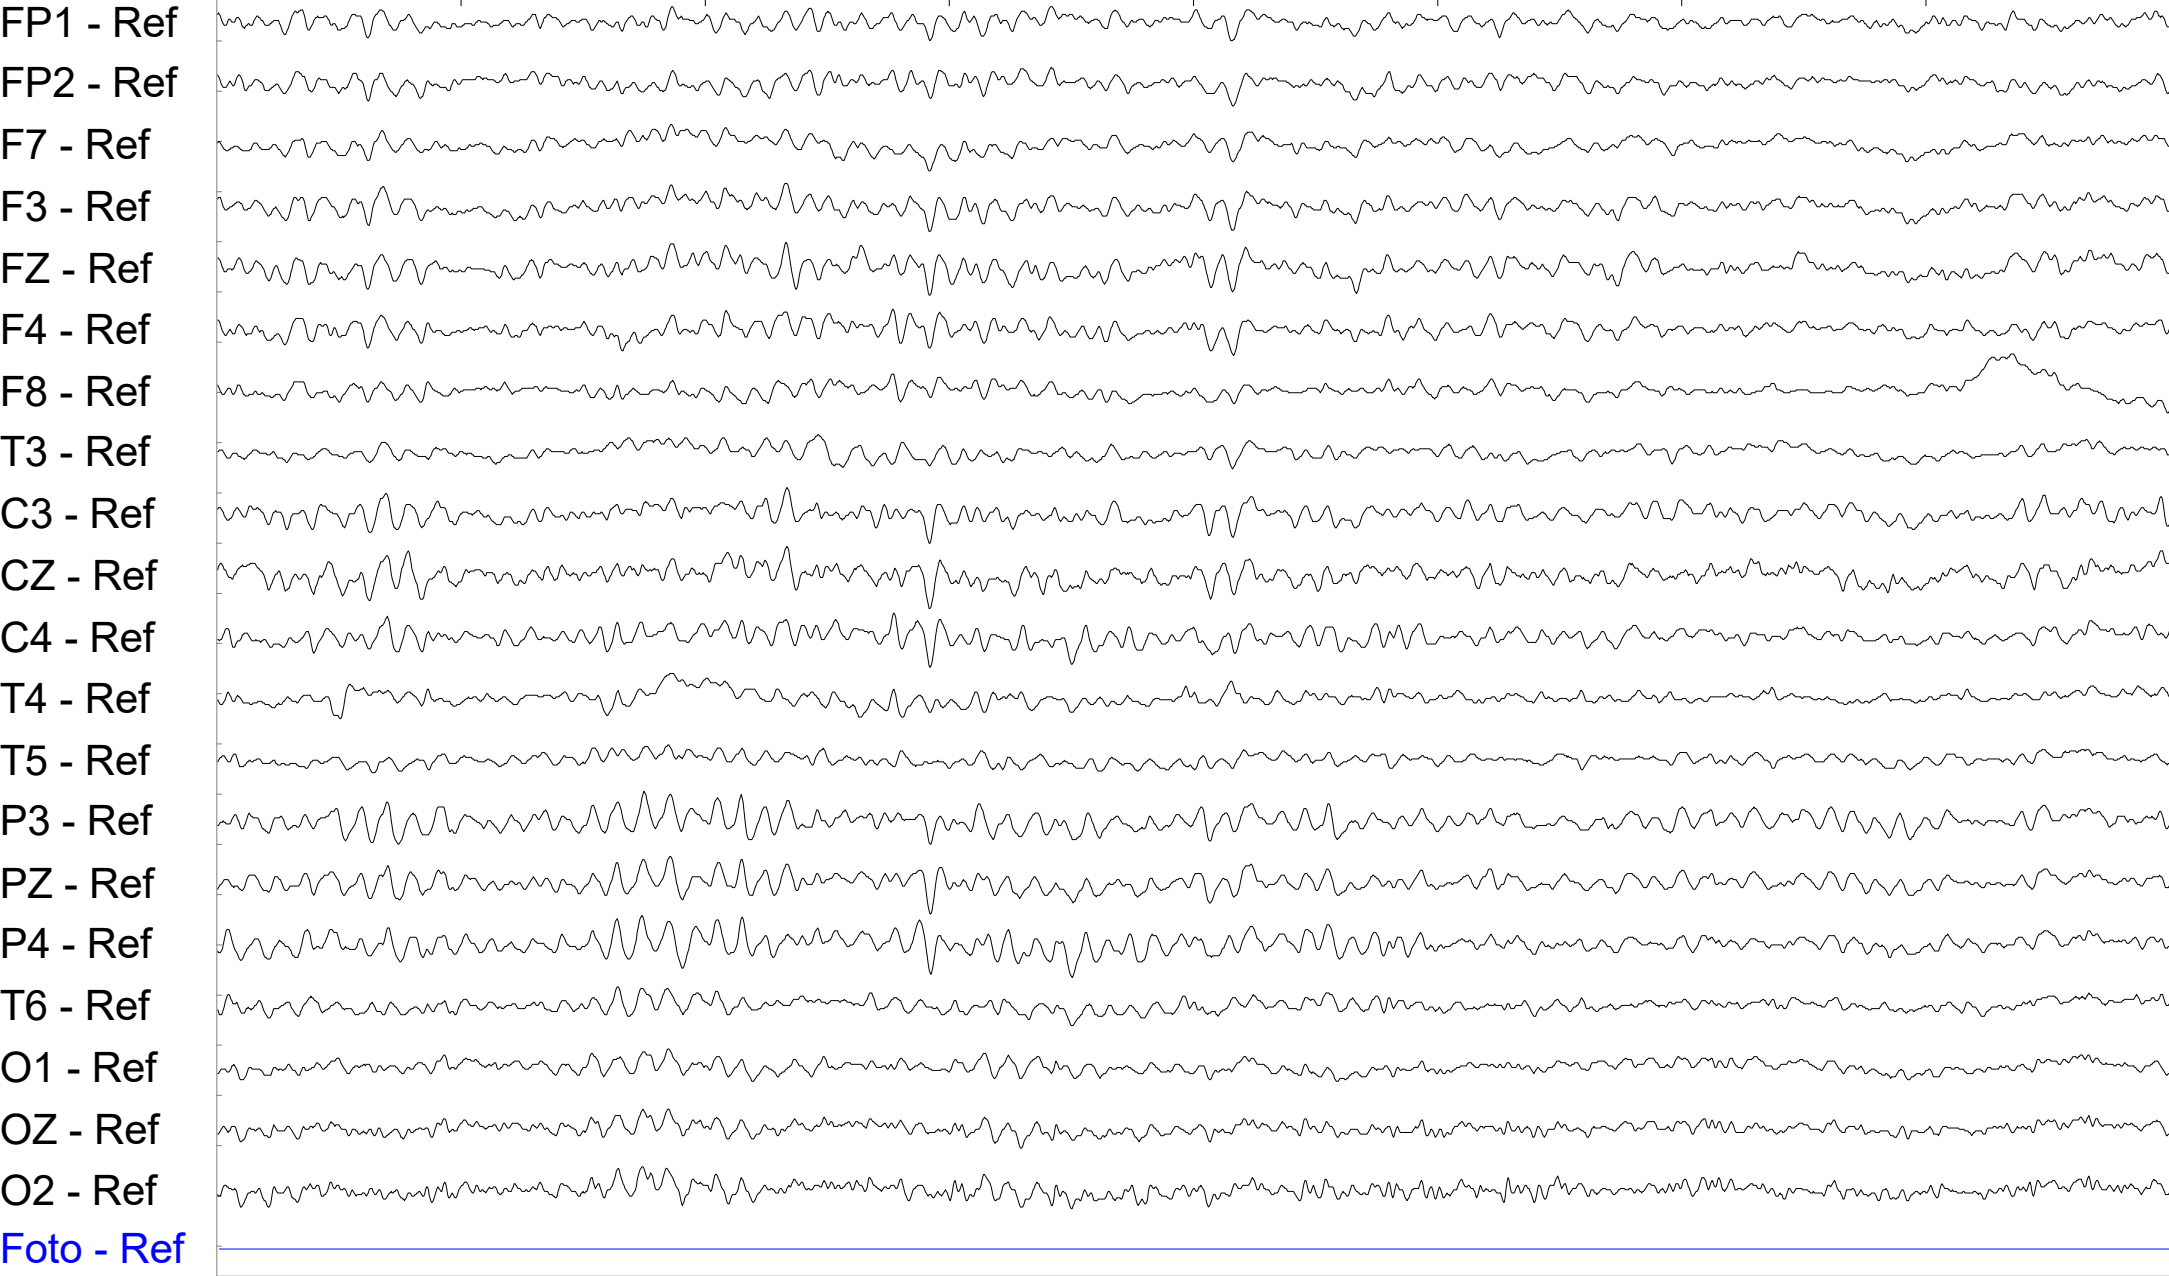

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


16:23:22 Foto Estimulação 16:23:23 Foto Estimulação 16:23:24 Foto Estimulação 16:23:25 Foto Estimulação 16:23:26 Foto Estimulação 16:23:27 Foto Estimulação 16:23:28 Foto Estimulação 16:23:29 Foto Estimulação
Época: 20 - Horário: 16:23:23 - Estágio: 0 (8 seg.)

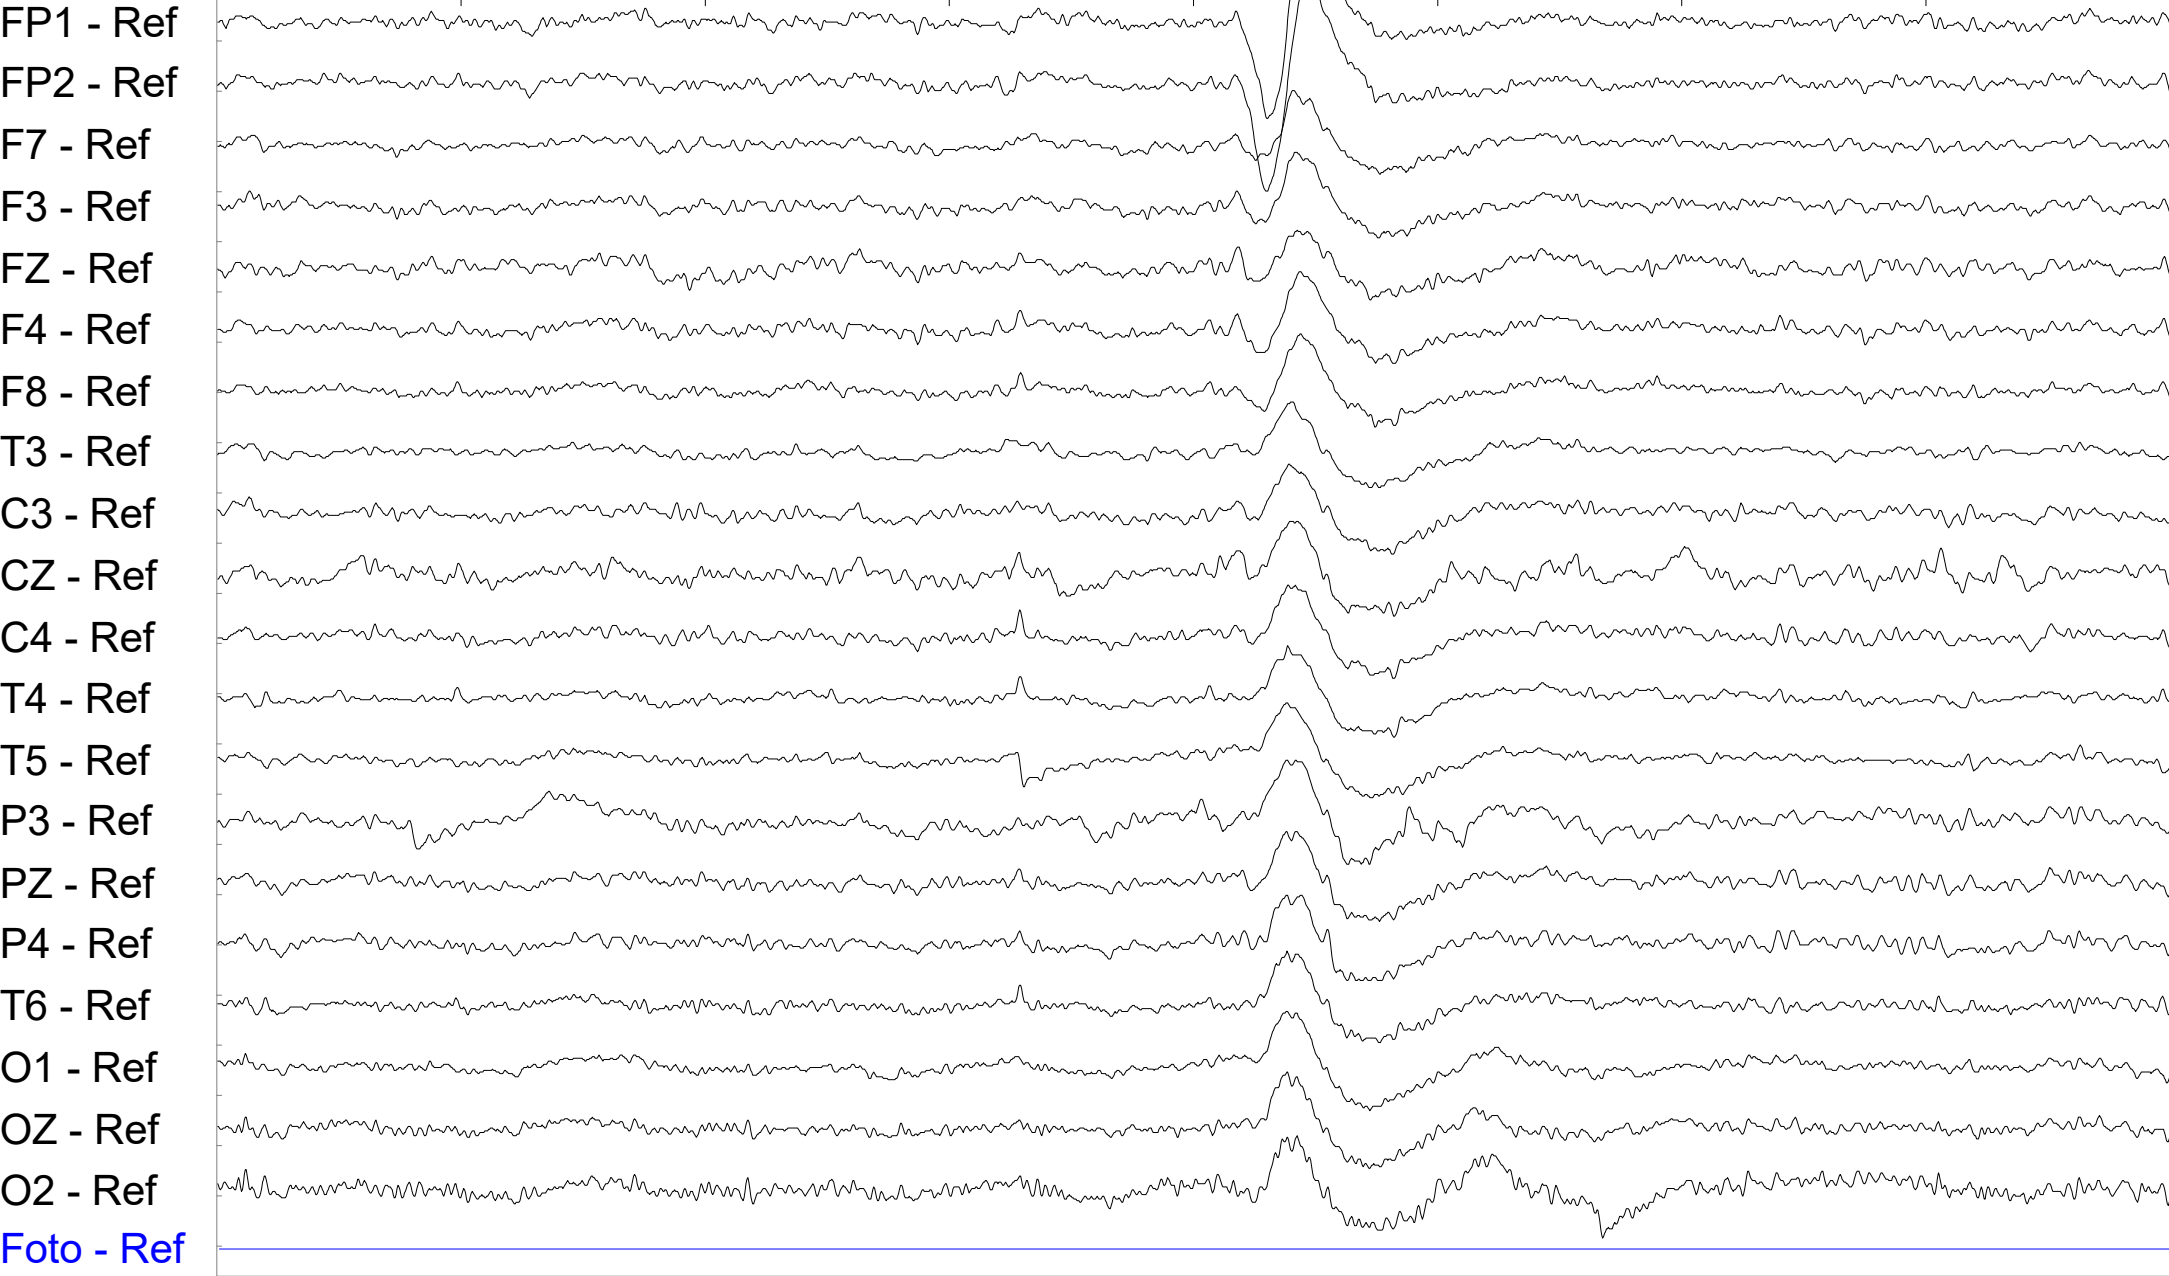


NEUROCLINIC


Informe o nome do médico

16:23:52 Foto Estimulação 16:23:53 Foto Estimulação 16:23:54 Foto Estimulação 16:23:55 Foto Estimulação 16:23:56 Foto Estimulação 16:23:57 Foto Estimulação 16:23:58 Foto Estimulação 16:23:59 Foto Estimulação
Época: 21 - Horário: 16:23:53 - Estágio: 0 (8 seg.)

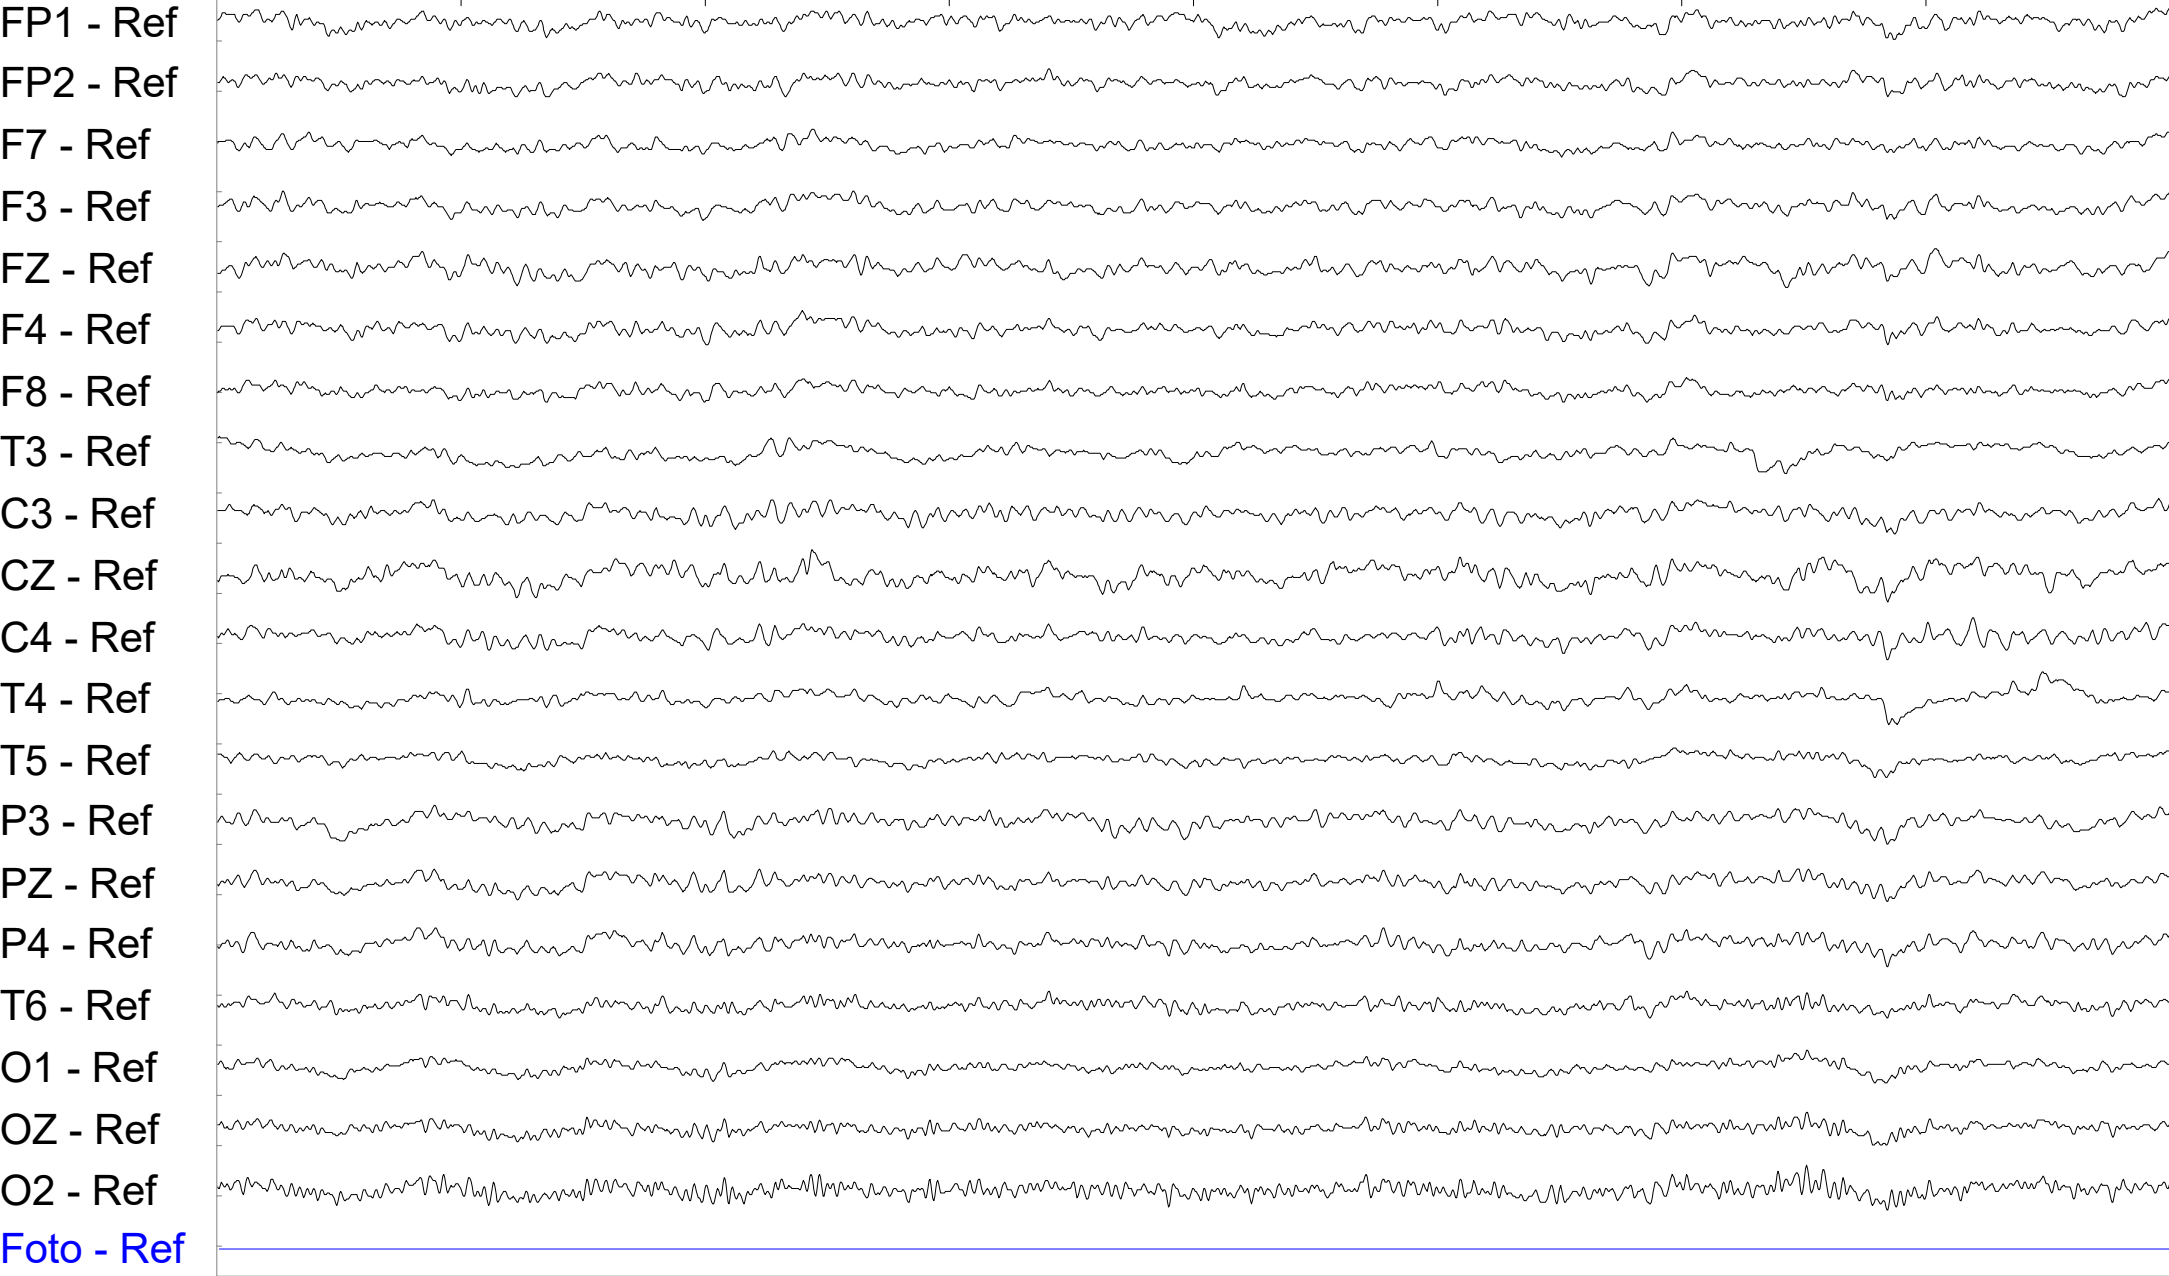



16:25:22	16:25:23	16:25:24	16:25:25	16:25:26	16:25:27	16:25:28	16:25:29
Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia
Época: 24 - Horário: 16:25:23 - Estágio: 0 (8 seg.)							

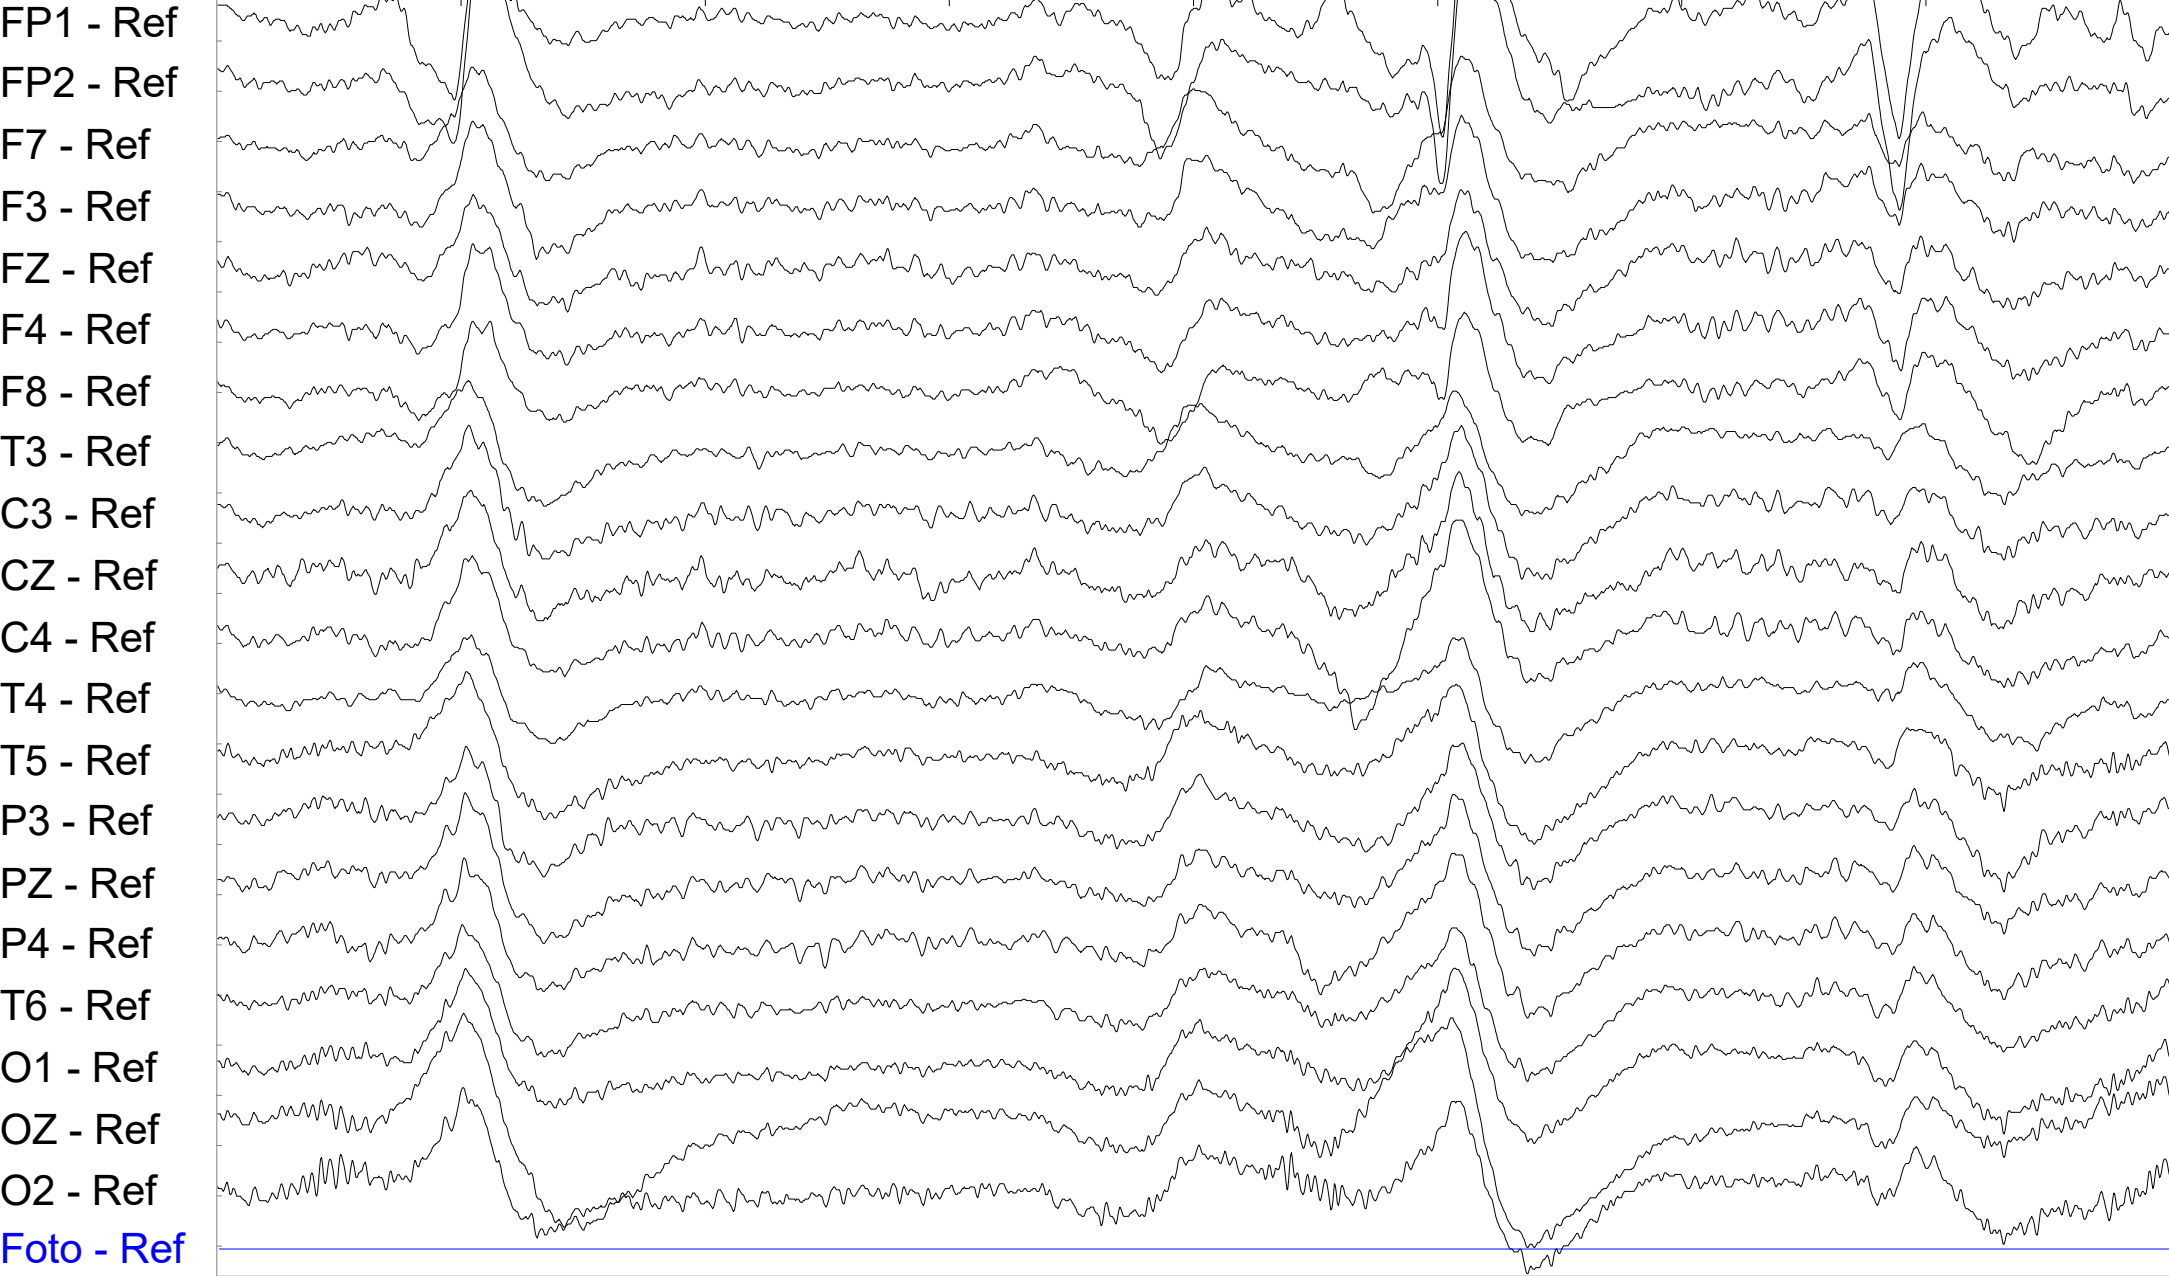


NEUROCLINIC


Informe o nome do médico


Pág. 26/29

16:26:22 16:26:23 16:26:24 16:26:25 16:26:26 16:26:27 16:26:28 16:26:29
Pós hiperpneia Pós hiperpneia Pós hiperpneia Pós hiperpneia Pós hiperpneia Pós hiperpneia Pós hiperpneia Pós hiperpneia
Época: 26 - Horário: 16:26:23 - Estágio: 0 (8 seg.)

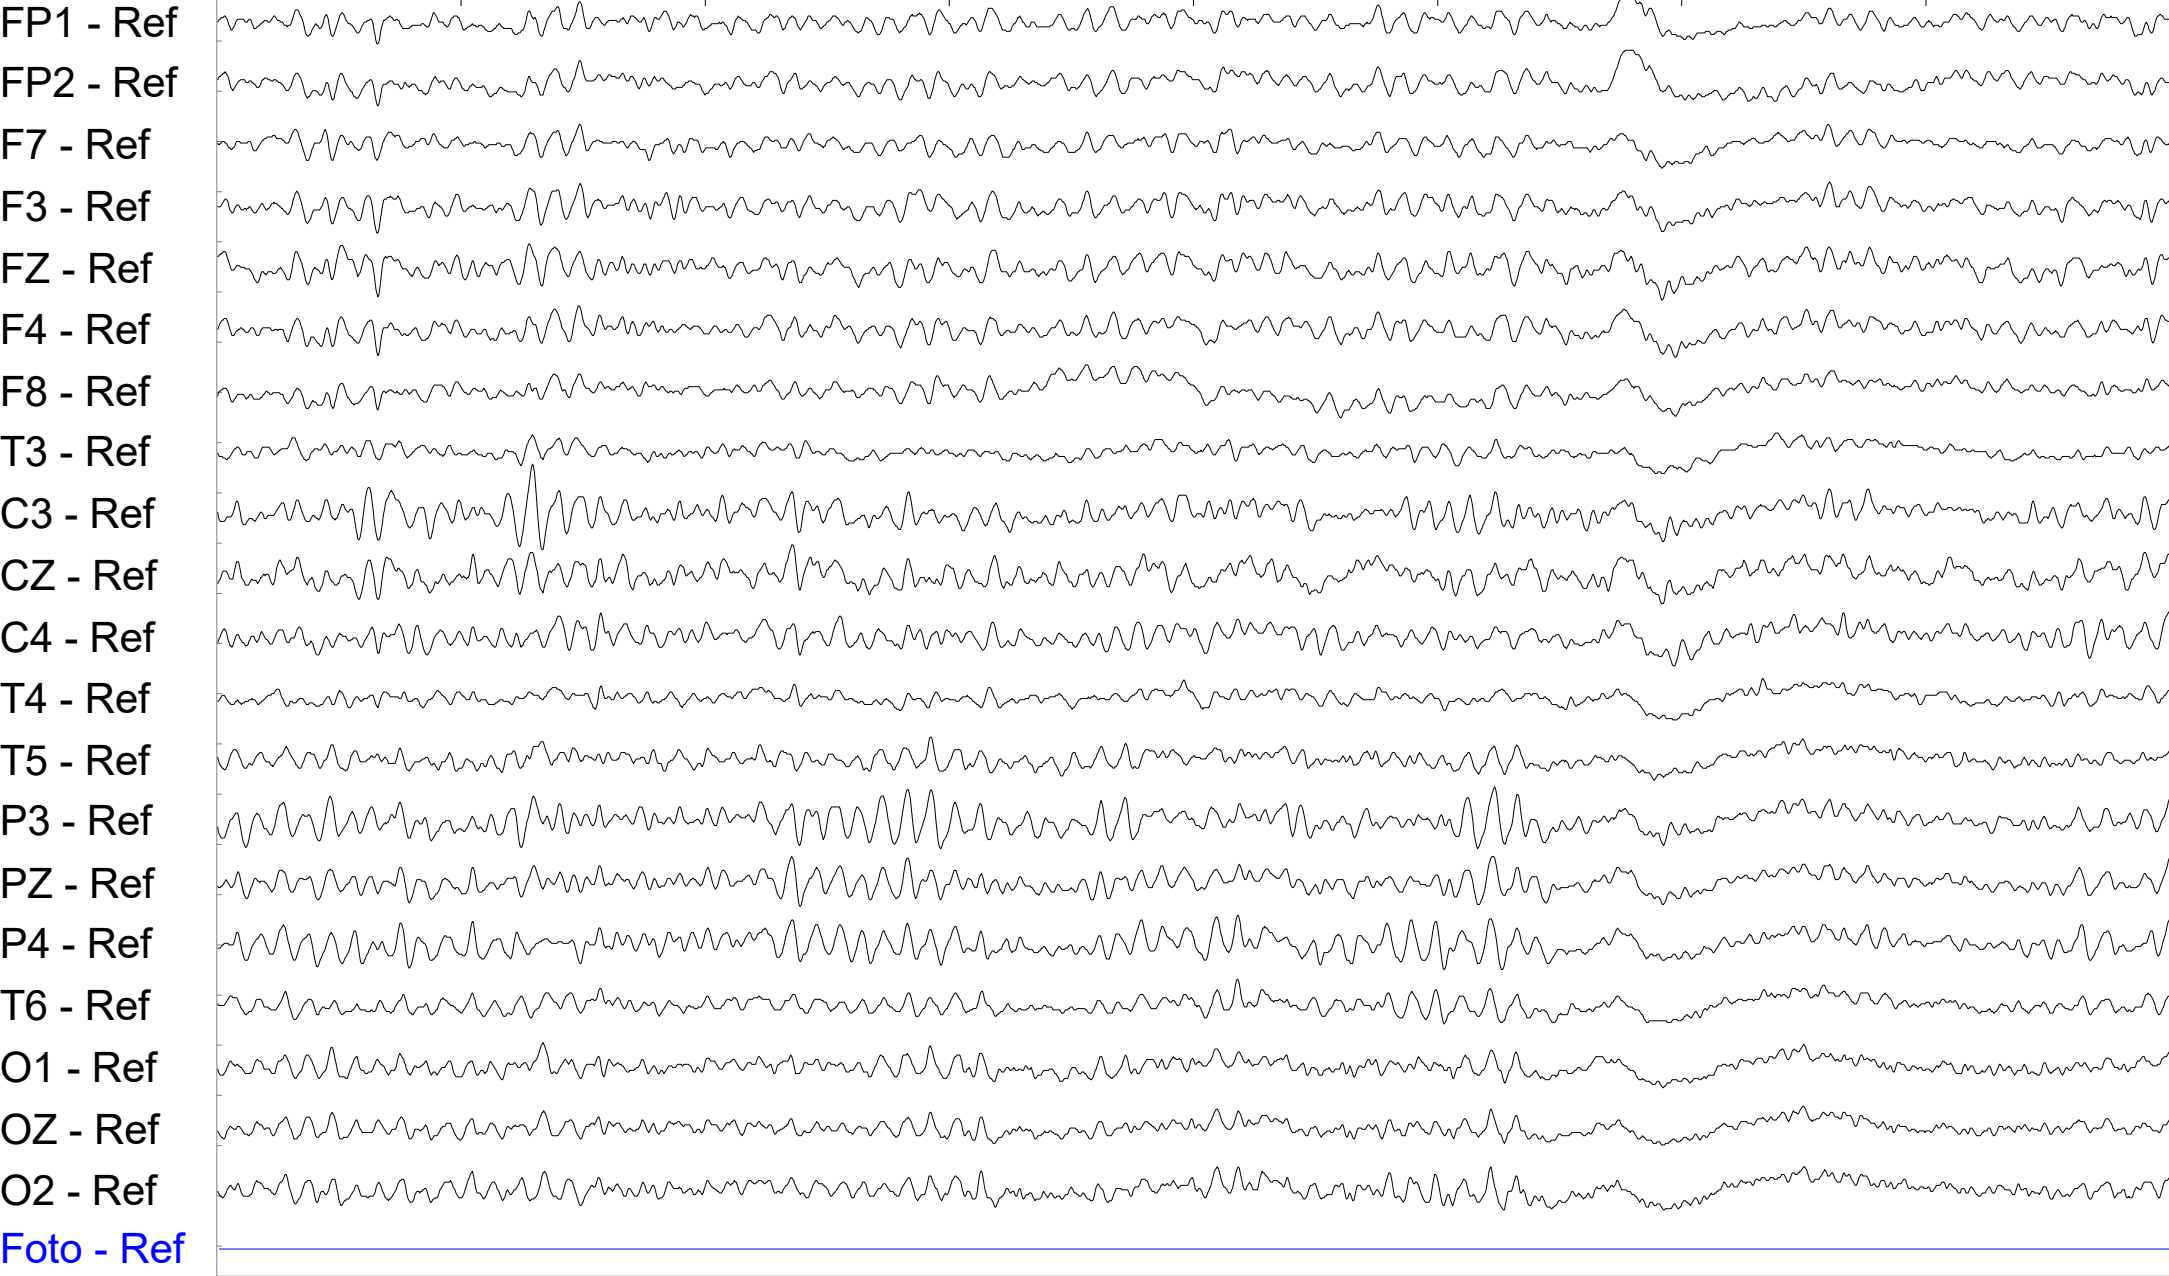

16:28:18 Vigília 16:28:19 Vigília 16:28:20 Vigília 16:28:21 Vigília 16:28:22 Vigília 16:28:23 Vigília 16:28:24 Vigília 16:28:25 Vigília
Época: 29 - Horário: 16:28:19 - Estágio: 0 (8 seg.)

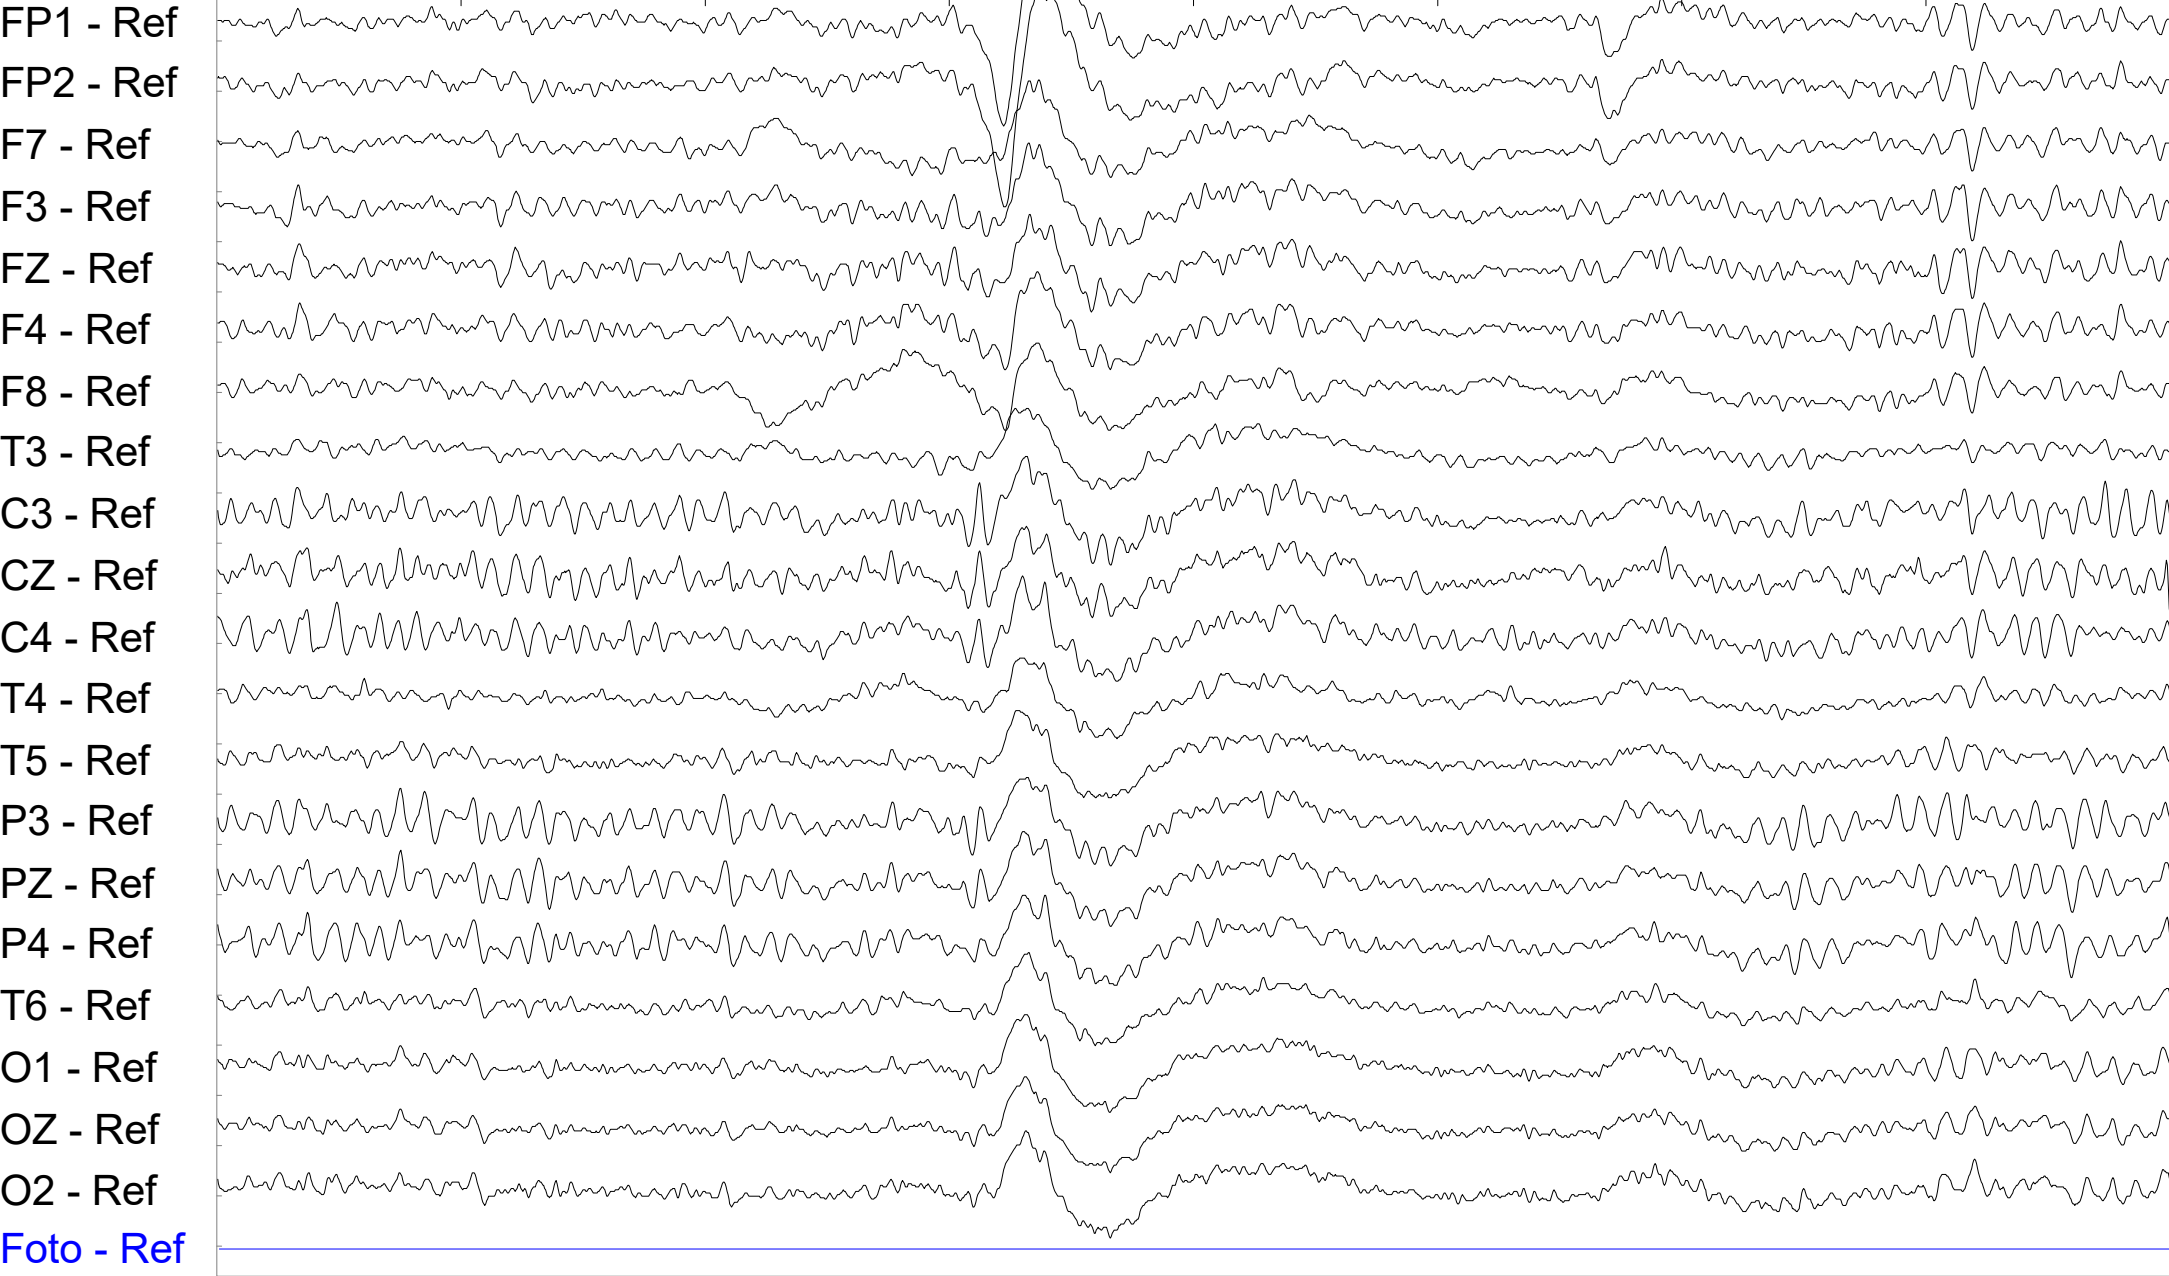


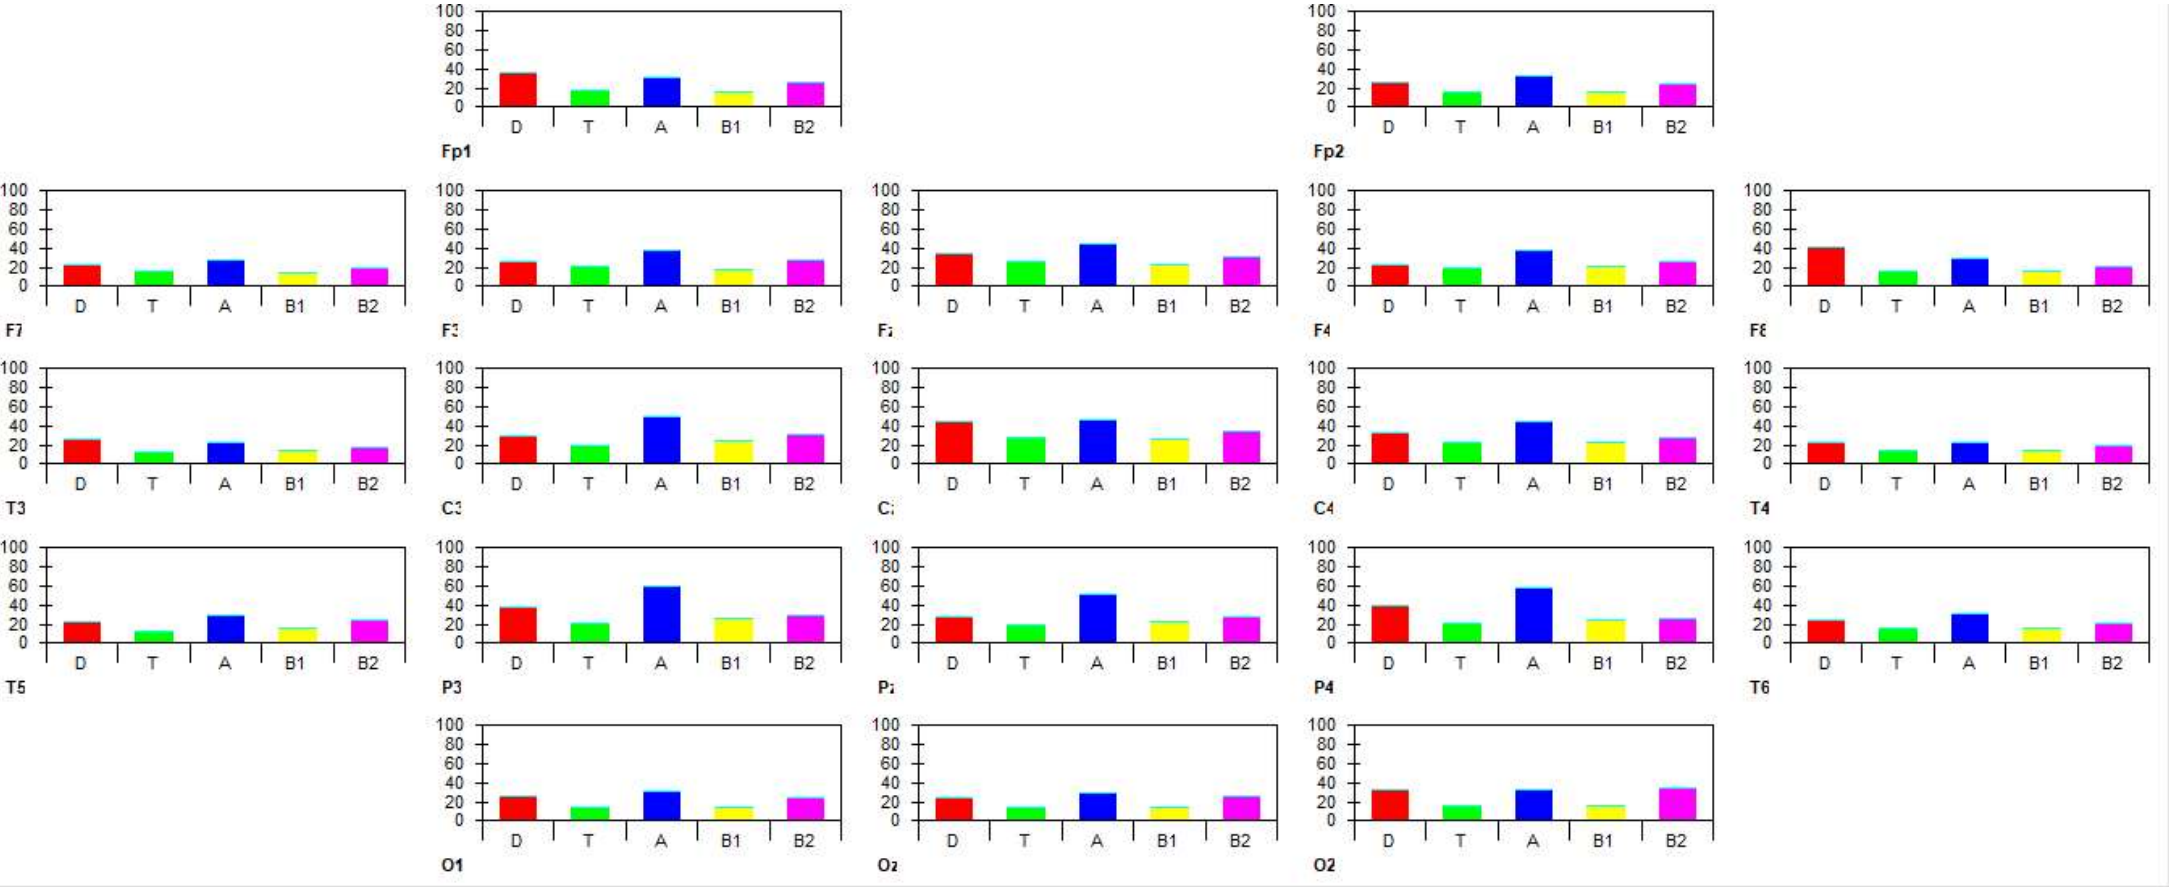

ANACLEIA CARDOSO MERREIROS (F) 56 anos - 0,00m - Realização: 17/03/2025 - Arquivo: 01357_01 - RG: - CPF:

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

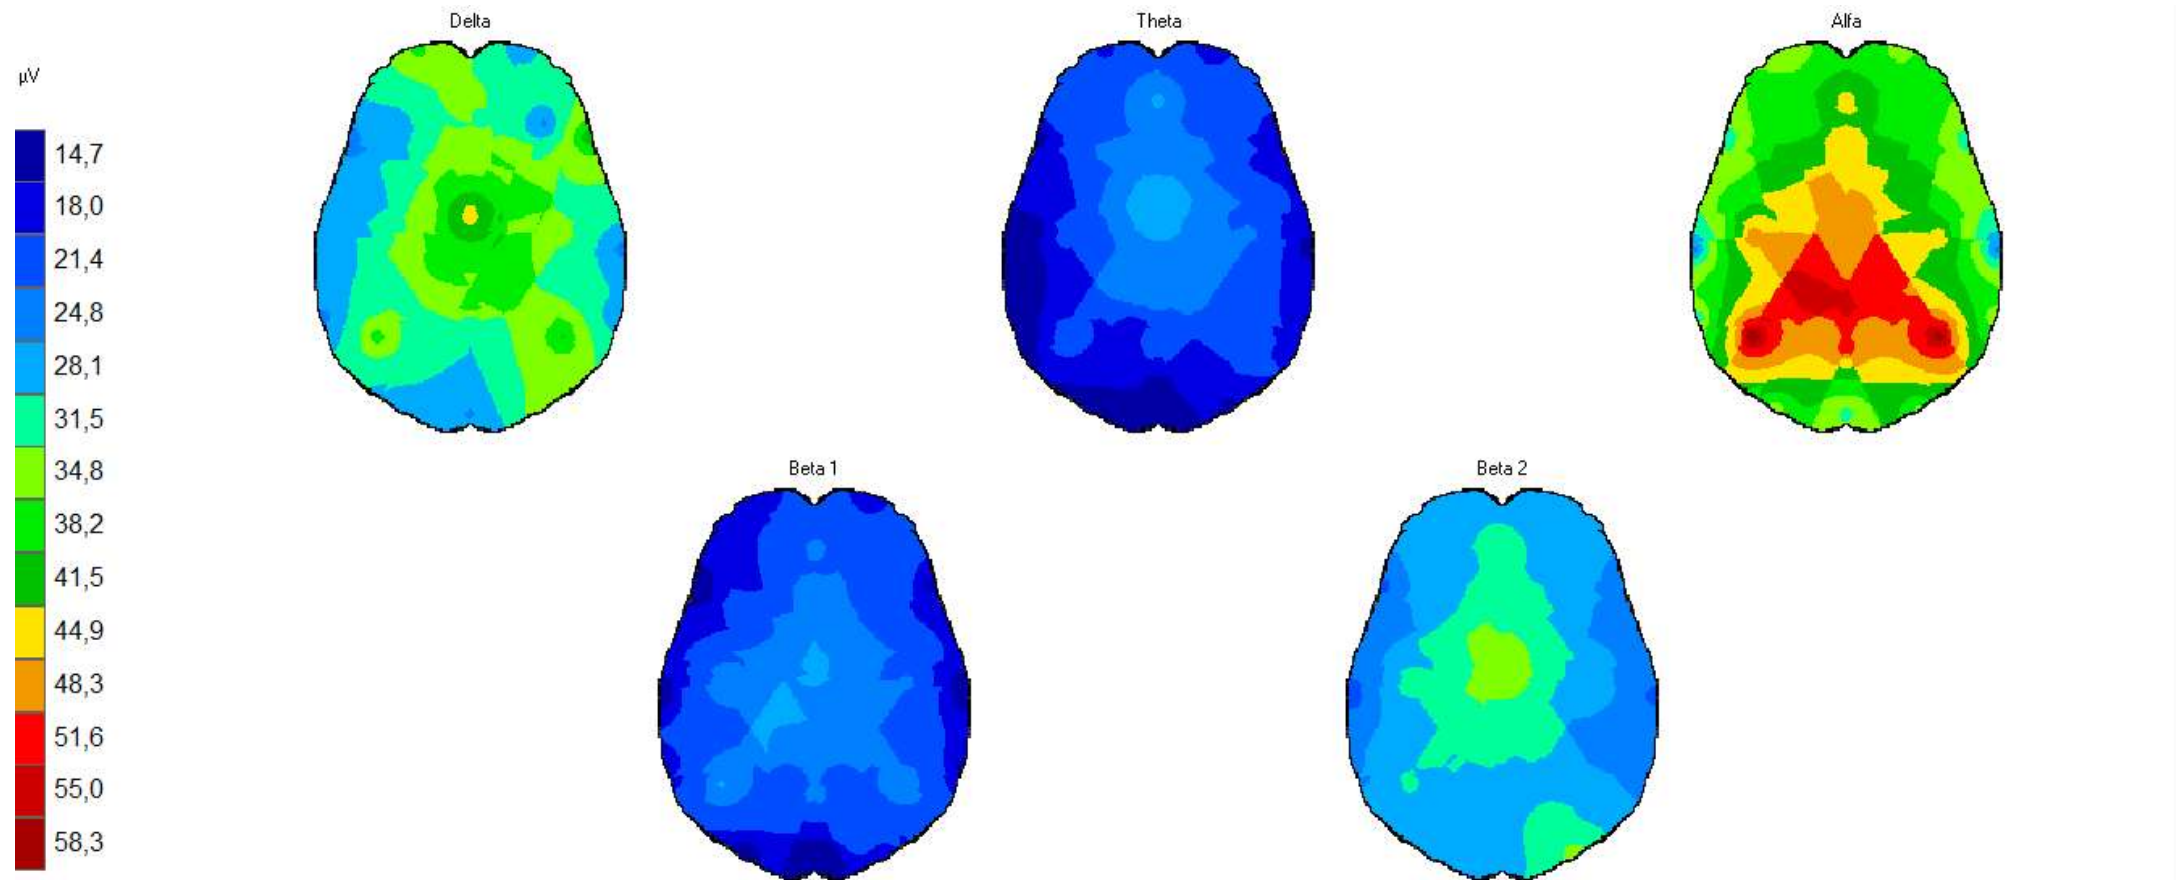

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	36.4	28.5
T	7.5	16.8	13.2
A	9.5	31.4	24.8
B1	17.0	16.8	13.1
B2	20.5	26.4	20.7

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	26.0	22.4
T	7.5	16.1	13.8
A	9.5	33.1	26.4
B1	16.5	16.5	14.2
B2	22.0	24.7	21.2

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	23.1	22.9
T	4.5	15.4	15.3
A	9.5	28.4	28.3
B1	13.5	14.0	13.9
B2	19.0	19.7	19.6

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	26.1	19.9
T	7.5	21.1	16.1
A	10.0	38.5	29.3
B1	17.0	18.0	13.8
B2	19.0	27.4	20.9

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	34.4	21.7
T	6.5	26.6	16.8
A	8.0	44.4	26.0
B1	13.5	22.8	14.4
B2	19.5	30.5	19.2

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	22.7	17.9
T	7.5	18.8	14.8
A	10.0	38.0	29.9
B1	16.5	20.9	16.4
B2	19.5	26.8	21.1

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	41.6	33.5
T	7.5	16.2	13.0
A	10.0	29.2	23.5
B1	16.0	15.3	12.3
B2	19.5	21.8	17.6

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	25.6	27.6
T	4.0	12.6	13.6
A	10.0	22.4	24.1
B1	16.0	14.2	15.4
B2	19.0	18.0	19.4

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	26.9	18.9
T	6.5	19.5	12.7
A	10.0	49.2	32.2
B1	18.0	24.3	15.9
B2	18.5	31.0	20.3

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	44.6	24.7
T	4.5	26.1	15.6
A	8.5	47.3	26.2
B1	16.0	25.6	14.3
B2	18.5	34.6	19.2

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	32.8	21.9
T	7.5	22.2	14.8
A	8.0	44.6	29.7
B1	16.0	22.5	15.0
B2	18.5	26.0	16.7

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	22.9	24.4
T	7.5	15.0	16.0
A	8.0	21.9	23.4
B1	15.0	13.9	14.8
B2	19.0	20.1	21.4

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	22.7	21.7
T	7.5	13.3	12.7
A	9.5	26.9	27.6
B1	14.5	15.6	14.9
B2	19.5	24.1	23.1

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	37.4	21.6
T	6.5	20.4	11.8
A	9.5	60.2	34.6
B1	17.0	26.1	15.1
B2	18.5	29.1	16.8

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	26.1	16.9
T	6.5	19.3	13.0
A	9.0	51.2	34.4
B1	17.0	22.8	15.4
B2	18.5	27.3	16.3

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	39.2	23.2
T	6.5	20.6	12.3
A	9.5	59.1	34.9
B1	17.0	24.8	14.6
B2	18.5	25.4	15.0

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	24.9	22.7
T	7.5	15.9	14.6
A	9.0	31.7	26.9
B1	16.5	15.2	13.9
B2	21.0	21.8	19.9

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	25.4	23.1
T	4.0	14.6	13.3
A	9.5	31.2	26.4
B1	17.5	13.6	12.4
B2	19.5	25.1	22.8

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	24.0	22.4
T	6.5	13.6	12.7
A	9.5	29.4	27.4
B1	17.0	13.7	12.8
B2	19.5	26.3	24.6

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.5	32.9	24.7
T	6.5	15.6	11.9
A	9.5	33.6	25.3
B1	13.0	16.8	12.8
B2	19.5	33.6	25.5

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	.5	36,4	28,5	7,5	16,8	13,2	9,5	31,4	24,6	17,0	16,8	13,1	20,5	26,4	20,7
FP2	.5	26,0	22,4	7,5	16,1	13,8	9,5	33,1	28,4	16,5	16,5	14,2	22,0	24,7	21,2
F7	.5	23,1	22,9	4,5	15,4	15,3	9,5	28,4	28,3	13,5	14,0	13,9	19,0	19,7	19,6
F3	.5	26,1	19,9	7,5	21,1	16,1	10,0	38,5	29,3	17,0	18,0	13,8	19,0	27,4	20,9
FZ	.5	34,4	21,7	6,5	26,6	16,8	8,0	44,4	28,0	13,5	22,8	14,4	19,5	30,5	19,2
F4	.5	22,7	17,9	7,5	18,8	14,8	10,0	38,0	29,9	16,5	20,9	16,4	19,5	26,8	21,1
F8	1,0	41,6	33,5	7,5	16,2	13,0	10,0	29,2	23,5	16,0	15,3	12,3	19,5	21,8	17,6
T3	.5	25,6	27,6	4,0	12,6	13,6	10,0	22,4	24,1	16,0	14,2	15,4	19,0	18,0	19,4
C3	.5	28,9	18,9	6,5	19,5	12,7	10,0	49,2	32,2	18,0	24,3	15,9	18,5	31,0	20,3
CZ	1,0	44,6	24,7	4,5	28,1	15,6	8,5	47,3	26,2	16,0	25,8	14,3	18,5	34,6	19,2
C4	.5	32,8	21,9	7,5	22,2	14,8	8,0	44,6	29,7	16,0	22,5	15,0	18,5	28,0	18,7
T4	.5	22,9	24,4	7,5	15,0	16,0	8,0	21,9	23,4	15,0	13,9	14,8	19,0	20,1	21,4
T5	1,0	22,7	21,7	7,5	13,3	12,7	9,5	28,9	27,6	14,5	15,6	14,9	19,5	24,1	23,1
P3	1,0	37,4	21,6	6,5	20,4	11,8	9,5	60,2	34,8	17,0	26,1	15,1	18,5	29,1	16,8
PZ	1,0	28,1	18,9	6,5	19,3	13,0	9,0	51,2	34,4	17,0	22,8	15,4	18,5	27,3	18,3
P4	.5	39,2	23,2	6,5	20,8	12,3	9,5	59,1	34,9	17,0	24,8	14,6	18,5	25,4	15,0
T6	1,0	24,9	22,7	7,5	15,9	14,6	9,0	31,7	28,9	16,5	15,2	13,9	21,0	21,8	19,9
O1	1,0	25,4	23,1	4,0	14,6	13,3	9,5	31,2	28,4	17,5	13,6	12,4	19,5	25,1	22,8
OZ	1,0	24,0	22,4	6,5	13,6	12,7	9,5	29,4	27,4	17,0	13,7	12,8	19,5	26,3	24,6
O2	1,5	32,9	24,7	6,5	15,8	11,9	9,5	33,6	25,3	13,0	16,8	12,6	19,5	33,8	25,5

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	,5	36,4	28,5	7,5	16,8	13,2	9,5	31,4	24,6	17,0	16,8	13,1	20,5	26,4	20,7
FP2	,5	26,0	22,4	7,5	16,1	13,8	9,5	33,1	28,4	16,5	16,5	14,2	22,0	24,7	21,2
F7	,5	23,1	22,9	4,5	15,4	15,3	9,5	28,4	28,3	13,5	14,0	13,9	19,0	19,7	19,6
F3	,5	26,1	19,9	7,5	21,1	16,1	10,0	38,5	29,3	17,0	18,0	13,8	19,0	27,4	20,9
FZ	,5	34,4	21,7	6,5	26,6	16,8	8,0	44,4	28,0	13,5	22,8	14,4	19,5	30,5	19,2
F4	,5	22,7	17,9	7,5	18,8	14,8	10,0	38,0	29,9	16,5	20,9	16,4	19,5	26,8	21,1
F8	1,0	41,6	33,5	7,5	16,2	13,0	10,0	29,2	23,5	16,0	15,3	12,3	19,5	21,8	17,6
T3	,5	25,6	27,6	4,0	12,6	13,6	10,0	22,4	24,1	16,0	14,2	15,4	19,0	18,0	19,4
C3	,5	28,9	18,9	6,5	19,5	12,7	10,0	49,2	32,2	18,0	24,3	15,9	18,5	31,0	20,3
CZ	1,0	44,6	24,7	4,5	28,1	15,6	8,5	47,3	26,2	16,0	25,8	14,3	18,5	34,6	19,2
C4	,5	32,8	21,9	7,5	22,2	14,8	8,0	44,6	29,7	16,0	22,5	15,0	18,5	28,0	18,7
T4	,5	22,9	24,4	7,5	15,0	16,0	8,0	21,9	23,4	15,0	13,9	14,8	19,0	20,1	21,4
T5	1,0	22,7	21,7	7,5	13,3	12,7	9,5	28,9	27,6	14,5	15,6	14,9	19,5	24,1	23,1
P3	1,0	37,4	21,6	6,5	20,4	11,8	9,5	60,2	34,8	17,0	26,1	15,1	18,5	29,1	16,8
PZ	1,0	28,1	18,9	6,5	19,3	13,0	9,0	51,2	34,4	17,0	22,8	15,4	18,5	27,3	18,3
P4	,5	39,2	23,2	6,5	20,8	12,3	9,5	59,1	34,9	17,0	24,8	14,6	18,5	25,4	15,0
T6	1,0	24,9	22,7	7,5	15,9	14,6	9,0	31,7	28,9	16,5	15,2	13,9	21,0	21,8	19,9
O1	1,0	25,4	23,1	4,0	14,6	13,3	9,5	31,2	28,4	17,5	13,6	12,4	19,5	25,1	22,8
OZ	1,0	24,0	22,4	6,5	13,6	12,7	9,5	29,4	27,4	17,0	13,7	12,8	19,5	26,3	24,6
O2	1,5	32,9	24,7	6,5	15,8	11,9	9,5	33,6	25,3	13,0	16,8	12,6	19,5	33,8	25,5

Relação de modos de gravação e eventos

Pág. 1

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	16:13:53	03:21	Olhos abertos
7	16:17:14	03:54	Olhos fechados
15	16:21:08	01:32	Vigília
18	16:22:40	01:31	Foto Estimulação
18	16:22:46	00:00	Foto 1 hz
19	16:22:58	00:00	Foto 1 hz
19	16:23:03	00:00	Foto 3 hz
19	16:23:08	00:00	Foto 6 hz
19	16:23:13	00:00	Foto Desativado
19	16:23:13	00:00	Foto 1 hz
20	16:23:27	00:00	Foto 1 hz
20	16:23:31	00:00	Foto 1 hz
20	16:23:36	00:00	Foto 3 hz
20	16:23:41	00:00	Foto 6 hz
20	16:23:46	00:00	Foto Desativado
20	16:23:49	00:00	Foto 1 hz
21	16:24:10	00:49	Olhos fechados
21	16:23:54	00:00	Foto 3 hz
21	16:23:59	00:00	Foto 6 hz
21	16:24:04	00:00	Foto Desativado
23	16:24:59	01:21	Hiperpneia
25	16:26:20	01:36	Pós hiperpneia
29	16:27:56	00:30	Vigília