


11:05:10 Olhos abertos 11:05:11 Olhos abertos 11:05:12 Olhos abertos 11:05:13 Olhos abertos 11:05:14 Olhos abertos 11:05:15 Olhos abertos 11:05:16 Olhos abertos 11:05:17 Olhos abertos
Época: 1 - Horário: 11:05:11 - Estágio: 0 (8 seg.)

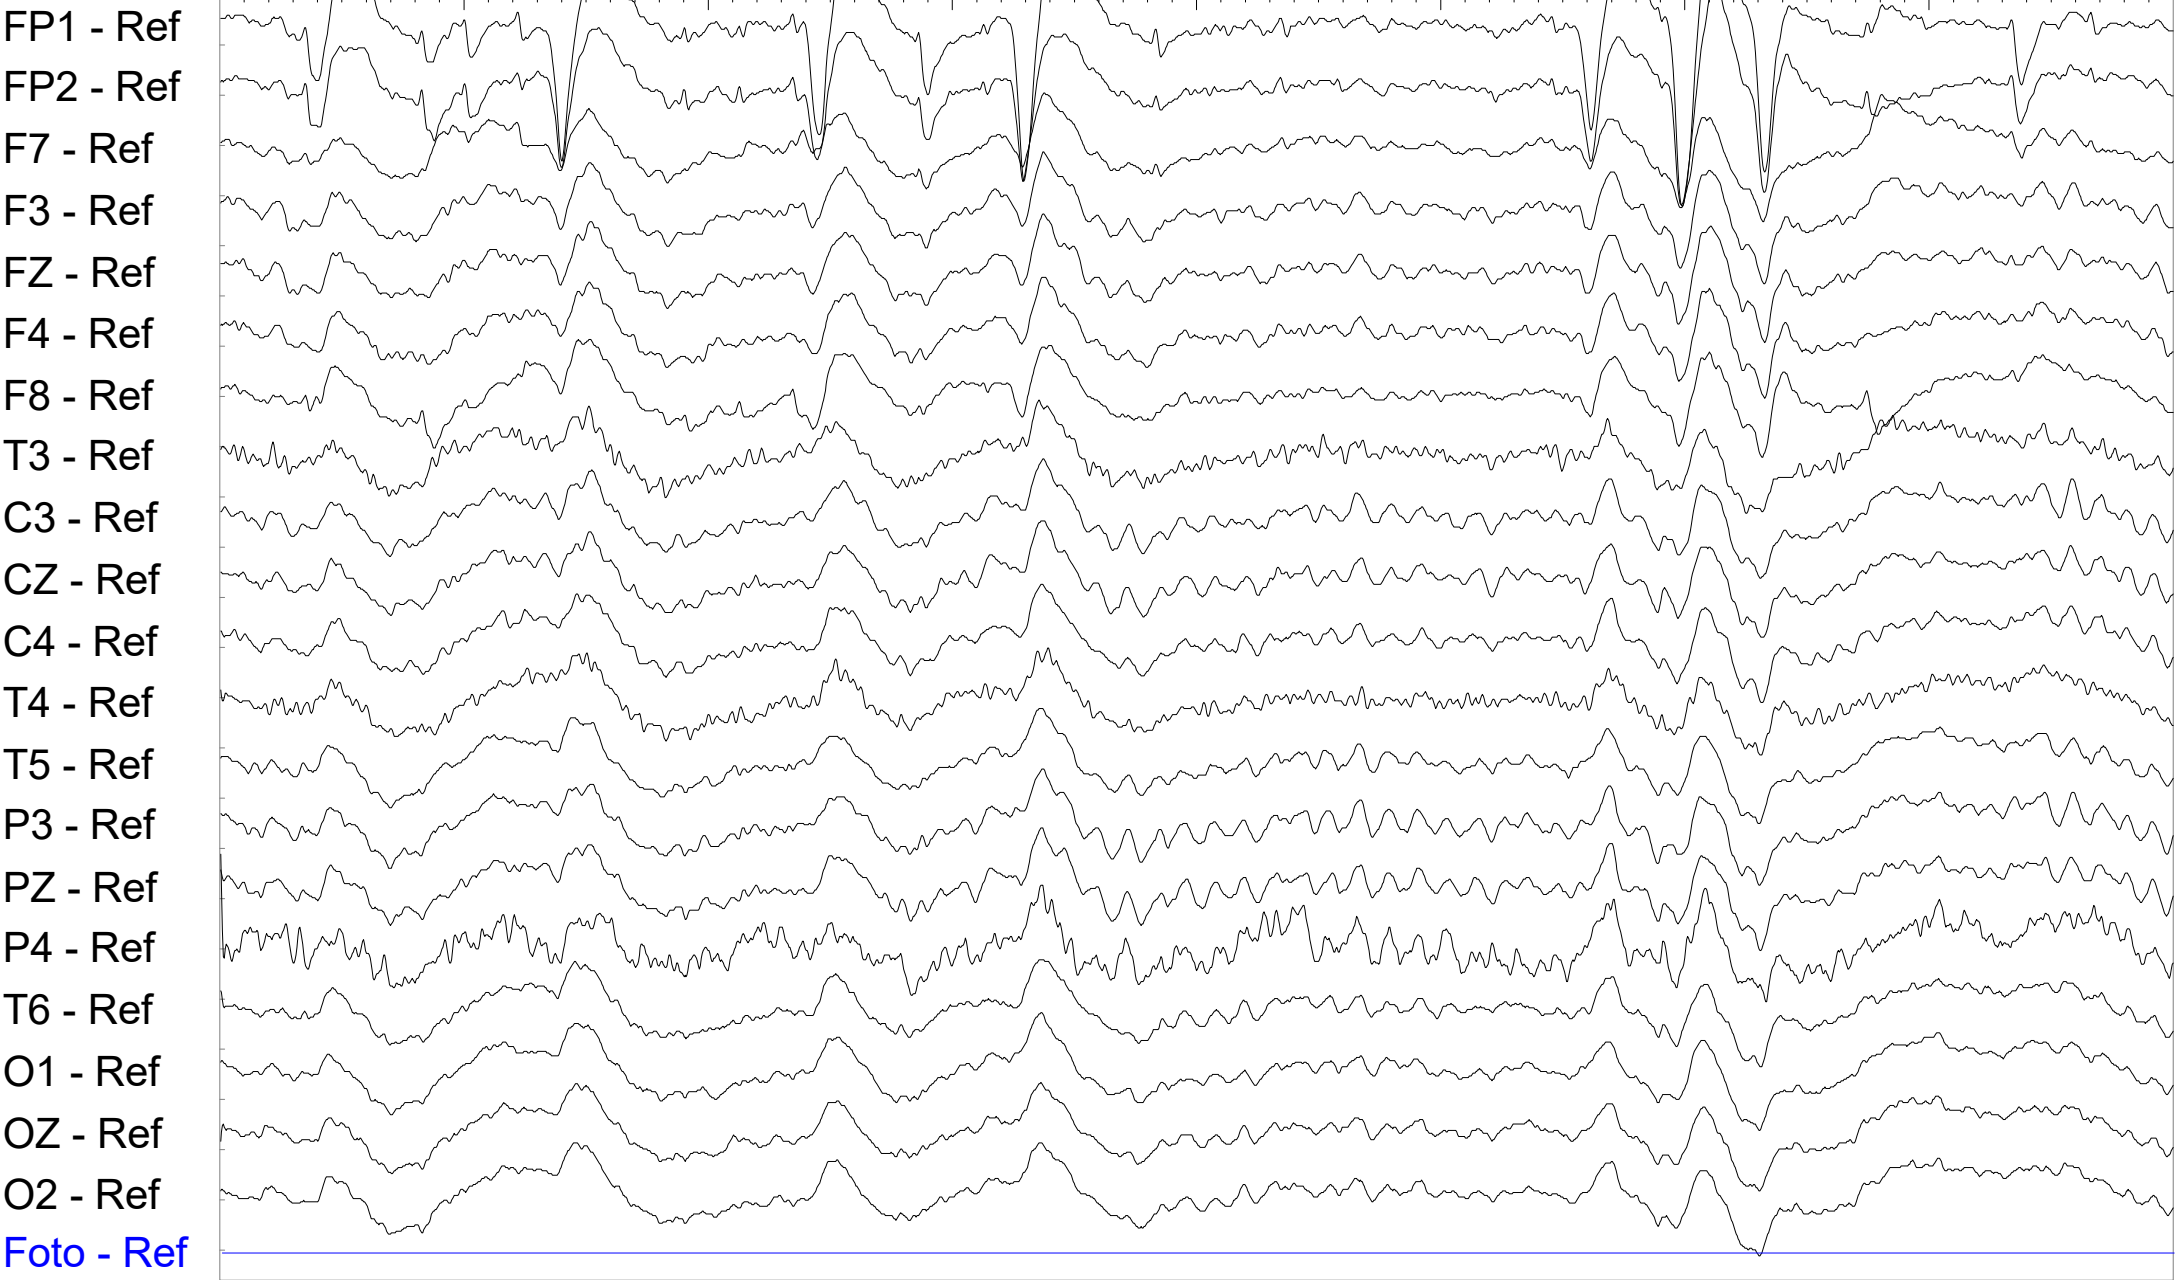



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


Pág. 5/28

11:07:09 Olhos abertos 11:07:10 Olhos abertos 11:07:11 Olhos abertos 11:07:12 Olhos abertos 11:07:13 Olhos abertos 11:07:14 Olhos abertos 11:07:15 Olhos abertos 11:07:16 Olhos abertos
Época: 5 - Horário: 11:07:10 - Estágio: 0 (8 seg.)

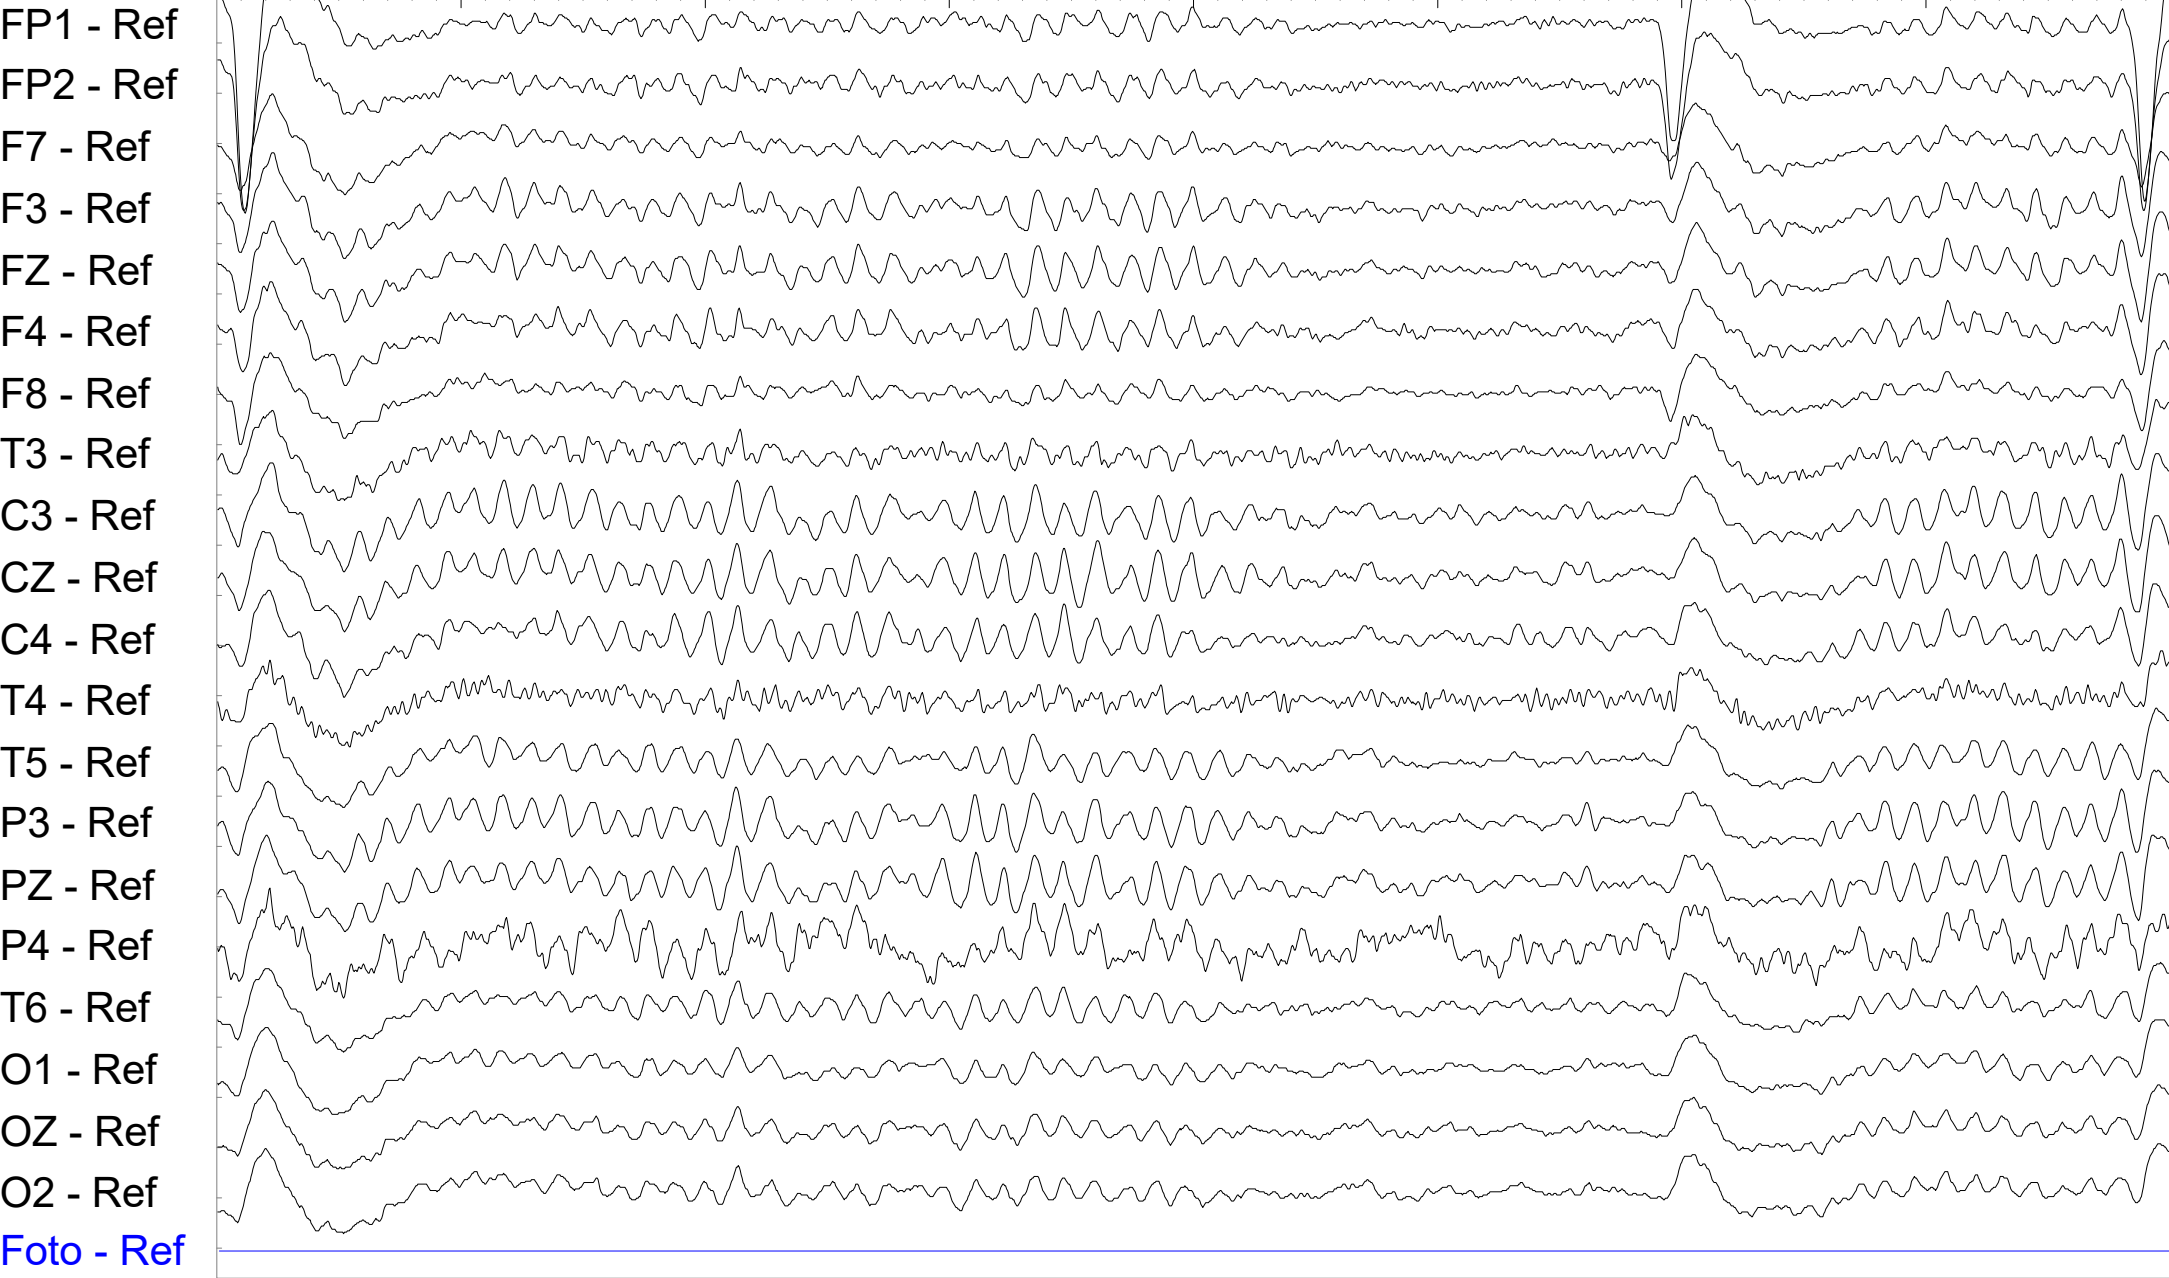




11:07:39 Olhos abertos 11:07:40 Olhos abertos 11:07:41 Olhos abertos 11:07:42 Olhos abertos 11:07:43 Olhos abertos 11:07:44 Olhos abertos 11:07:45 Olhos abertos 11:07:46 Olhos fechados
Época: 6 - Horário: 11:07:40 - Estágio: 0 (8 seg.)

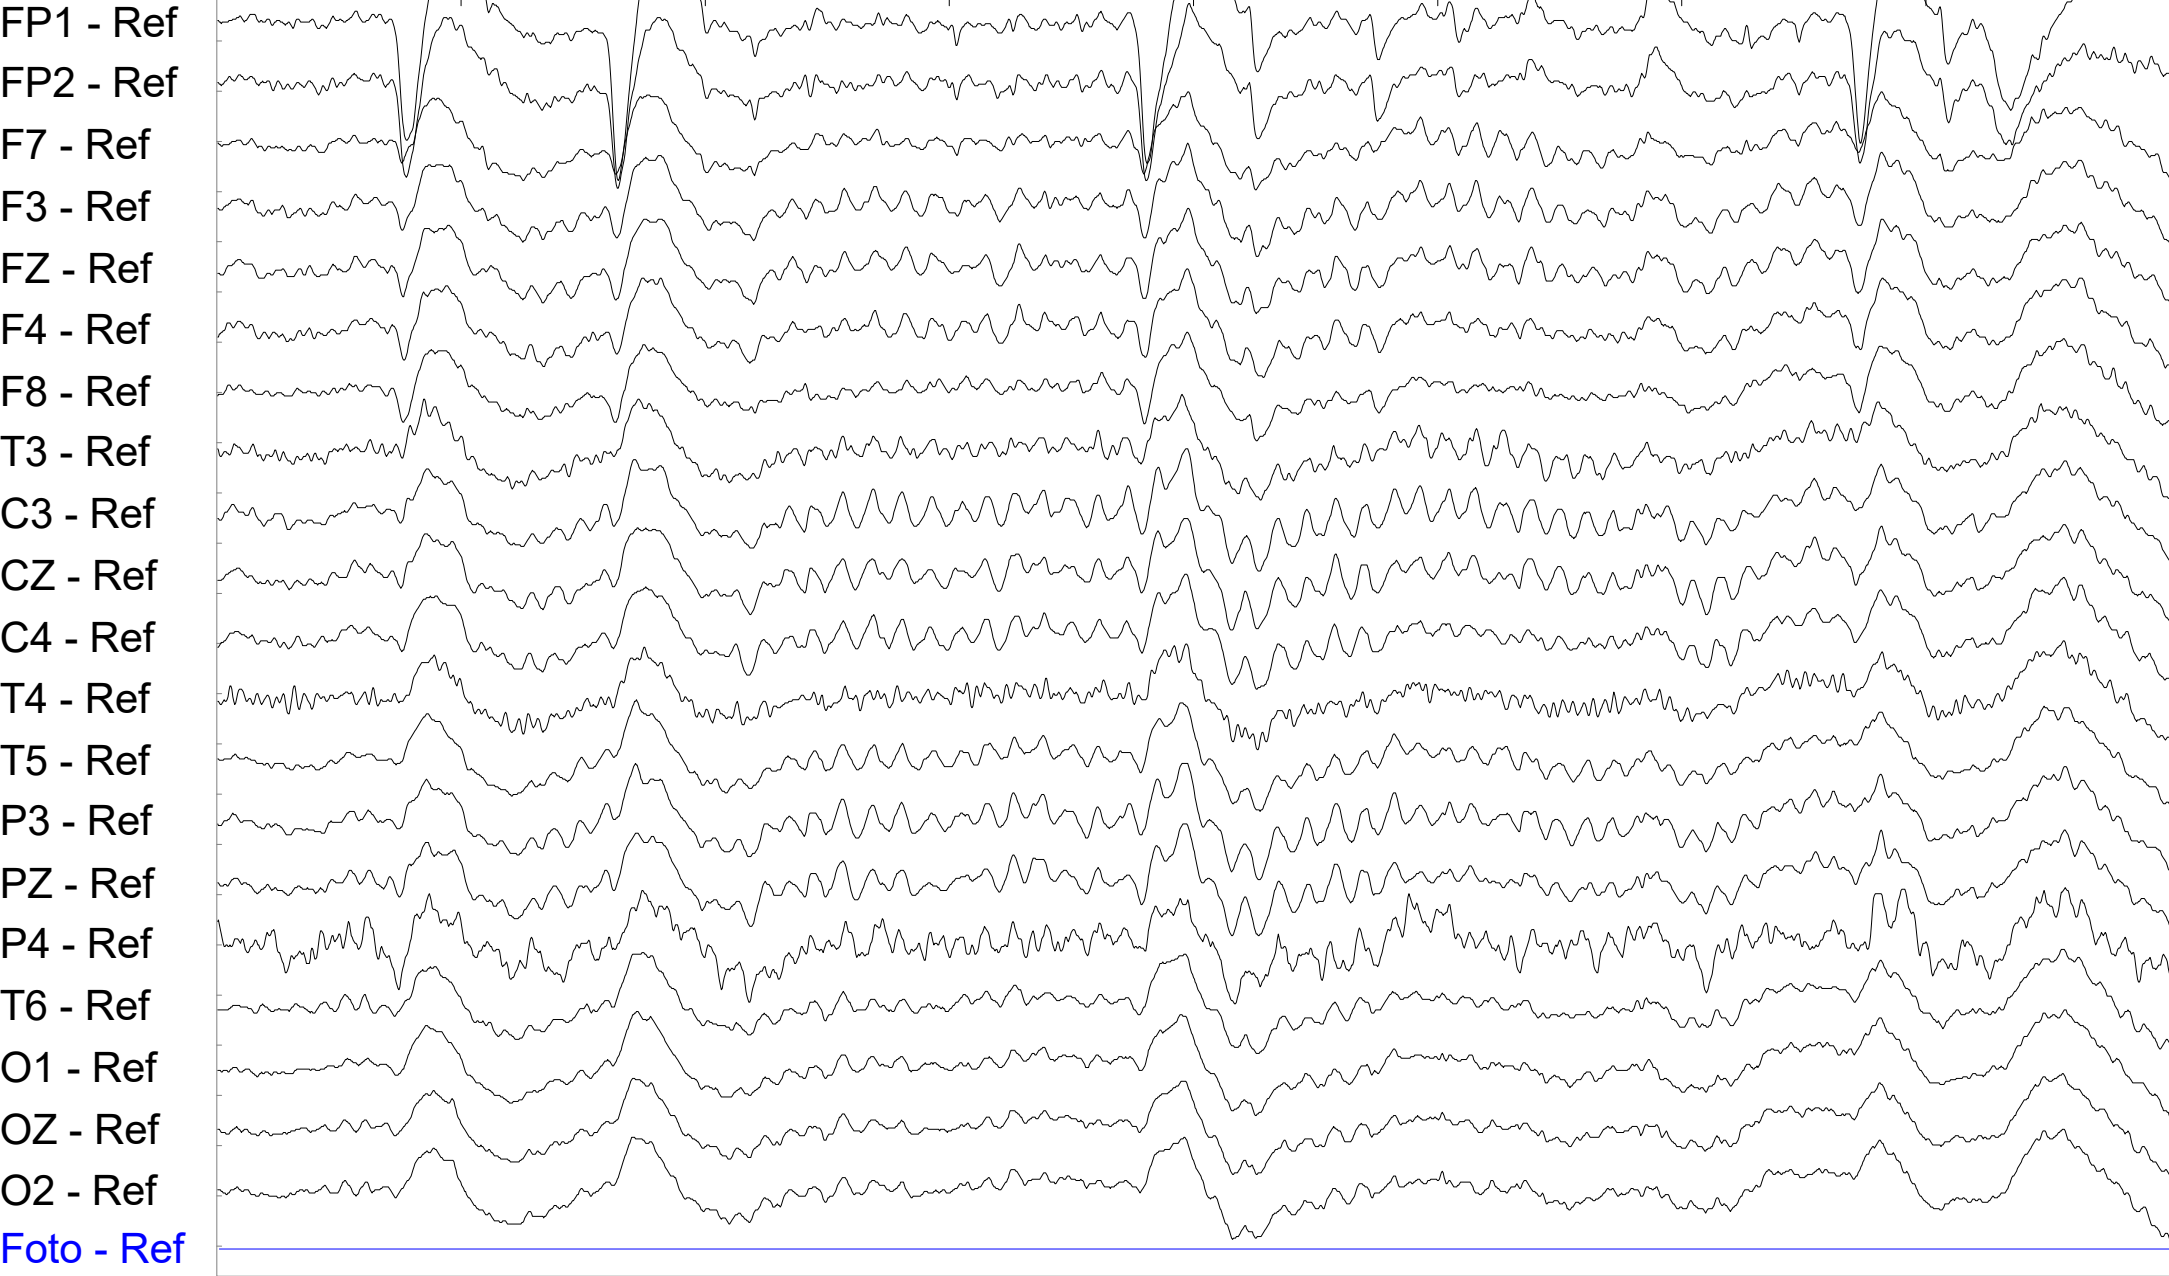


11:10:39	11:10:40	11:10:41	11:10:42	11:10:43	11:10:44	11:10:45	11:10:46
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados


Época: 12 - Horário: 11:10:40 - Estágio: 0 (8 seg.)

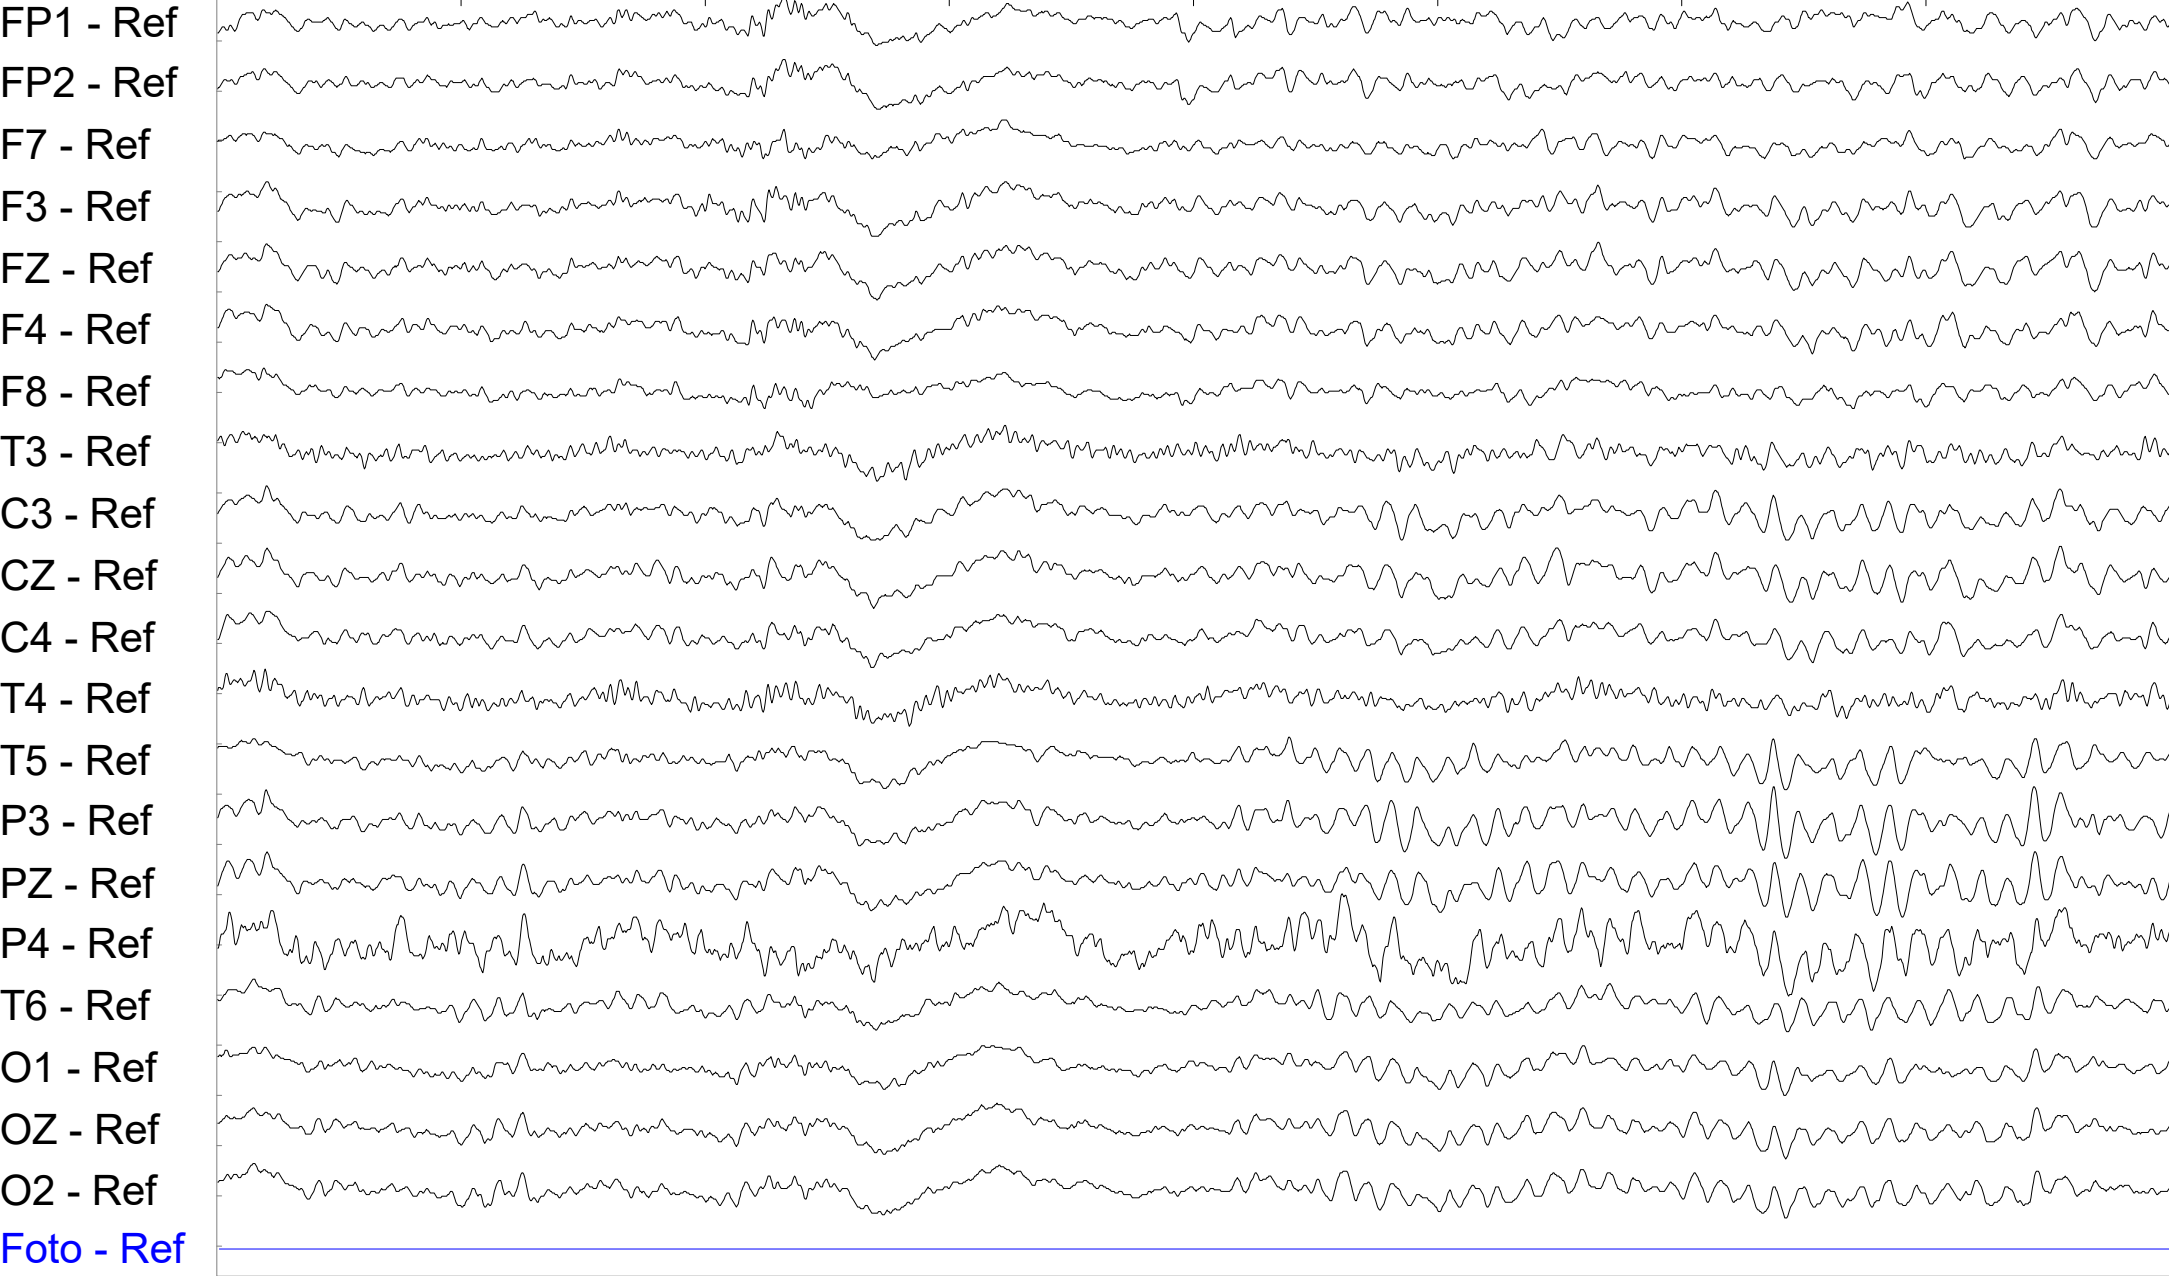

11:11:39	11:11:40	11:11:41	11:11:42	11:11:43	11:11:44	11:11:45	11:11:46
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados


Época: 14 - Horário: 11:11:40 - Estágio: 0 (8 seg.)

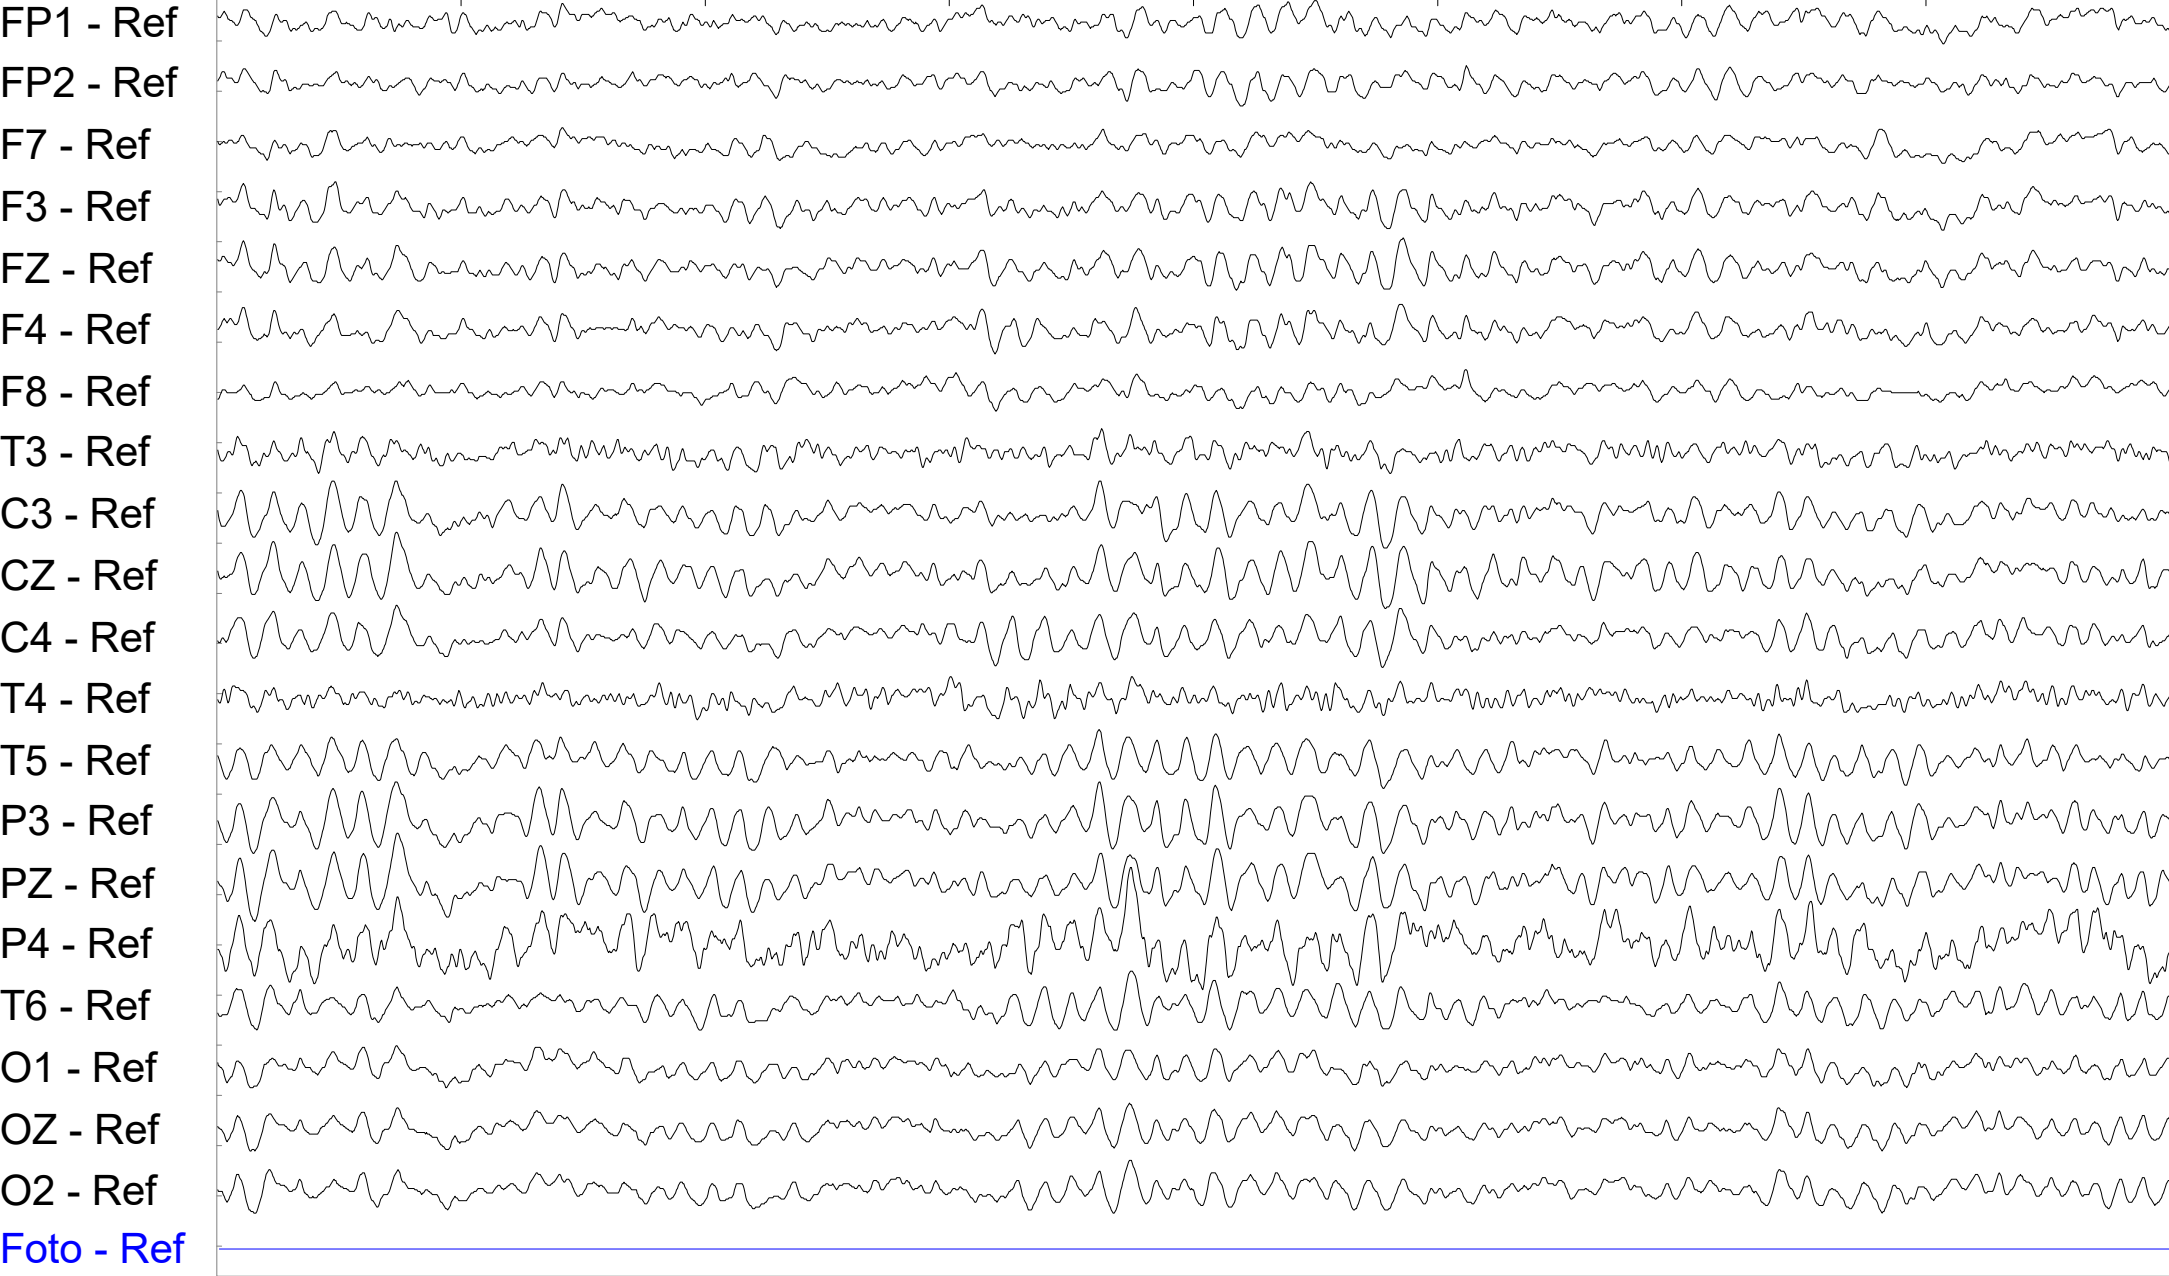




11:14:09 Foto Estimulação 11:14:10 Foto Estimulação 11:14:11 Foto Estimulação 11:14:12 Foto Estimulação 11:14:13 Foto Estimulação 11:14:14 Foto Estimulação 11:14:15 Foto Estimulação 11:14:16 Foto Estimulação


Época: 19 - Horário: 11:14:10 - Estágio: 0 (8 seg.)

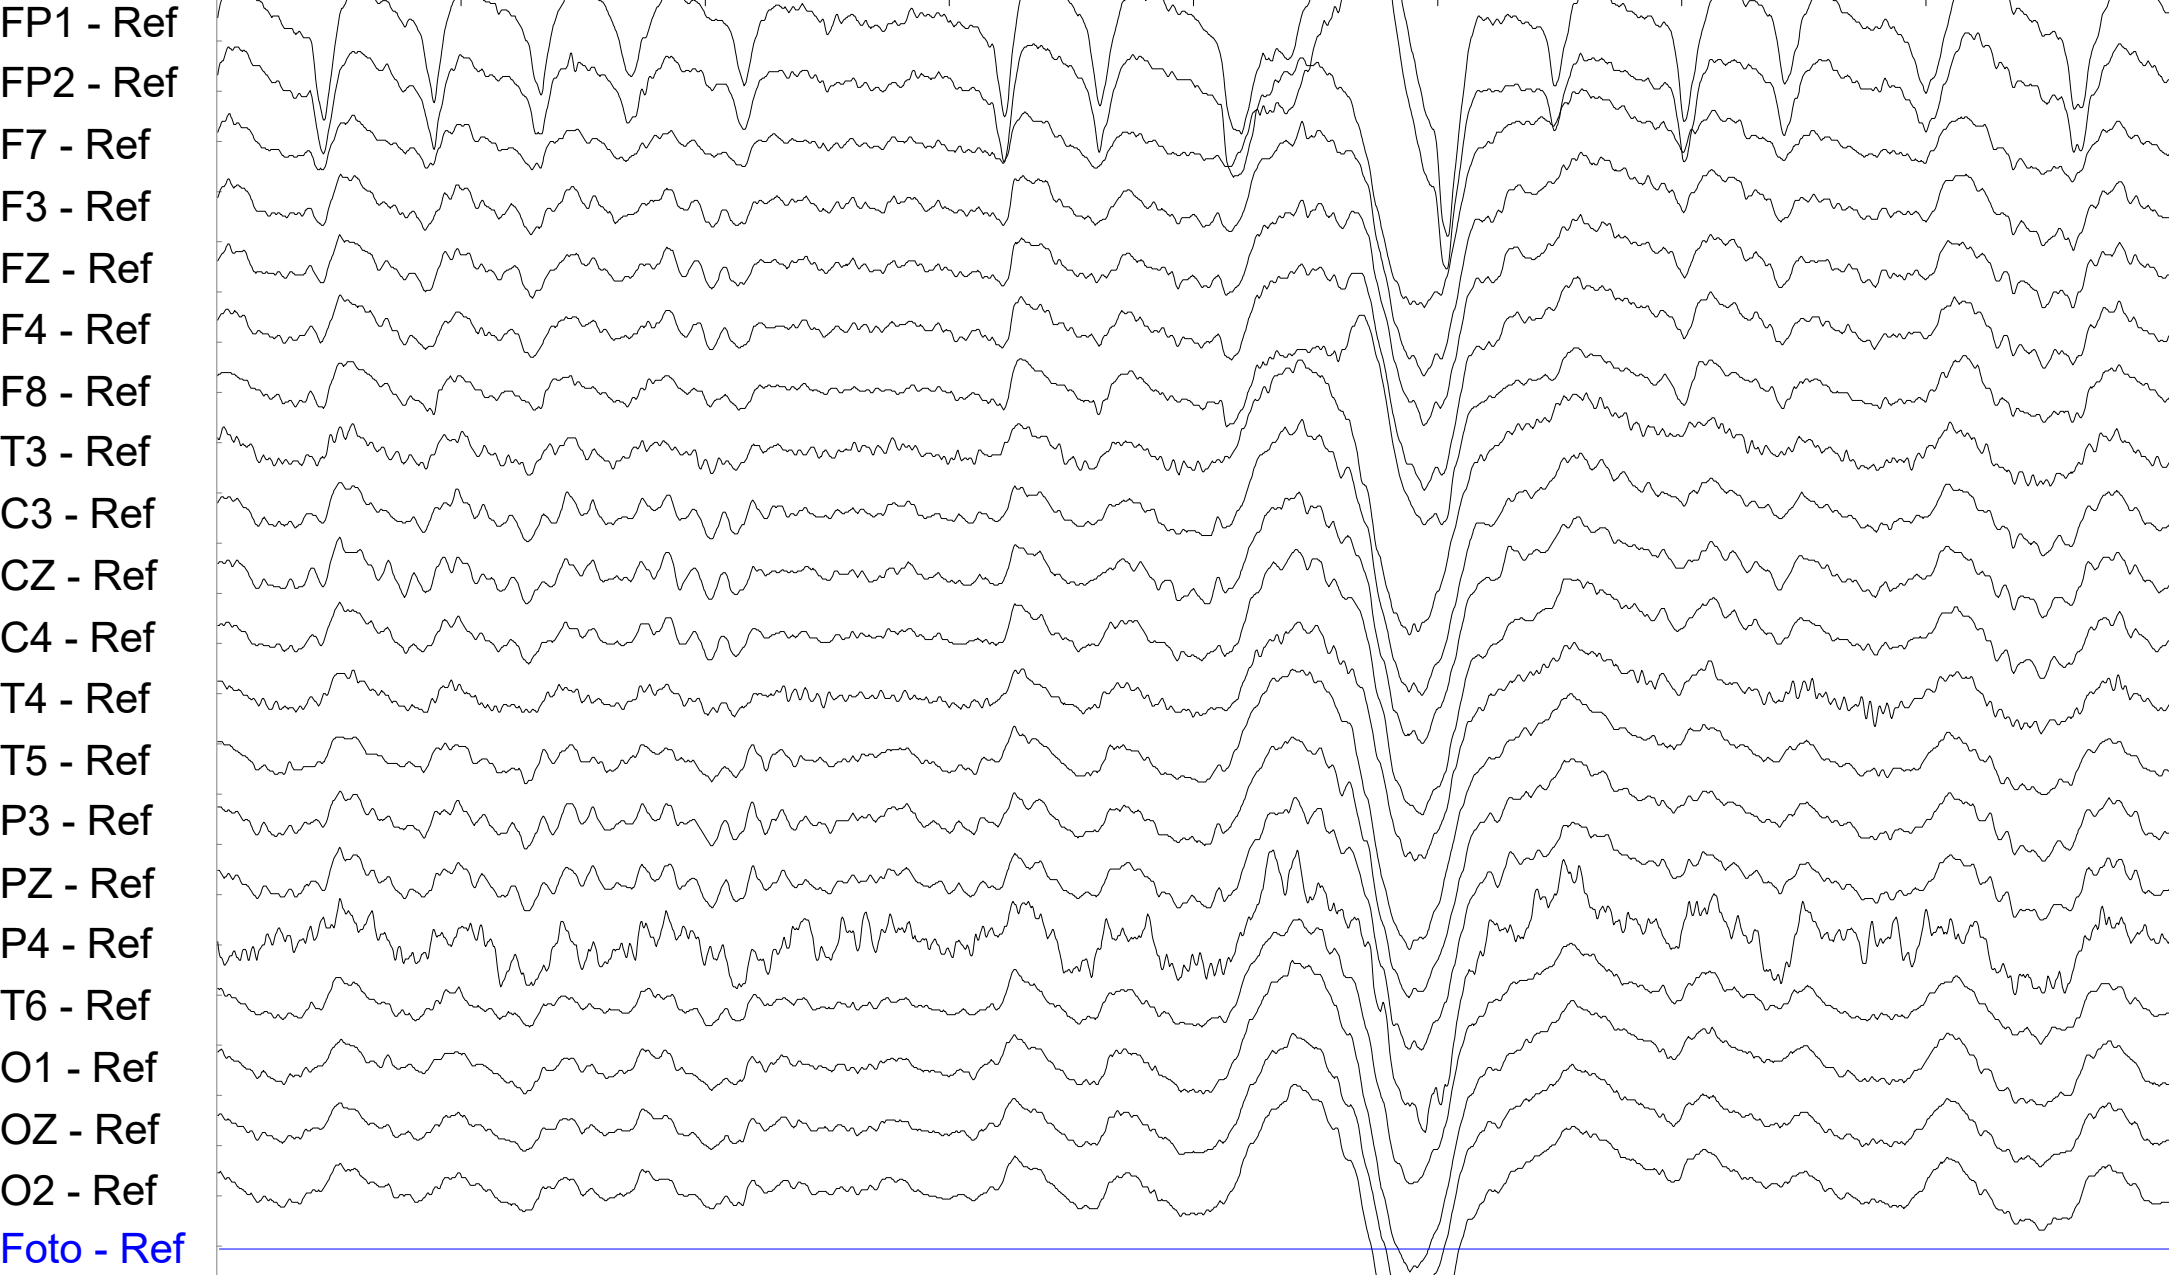



11:14:39 Vigília 11:14:40 Vigília 11:14:41 Vigília 11:14:42 Vigília 11:14:43 Vigília 11:14:44 Vigília 11:14:45 Vigília 11:14:46 Vigília

Época: 20 - Horário: 11:14:40 - Estágio: 0 (8 seg.)

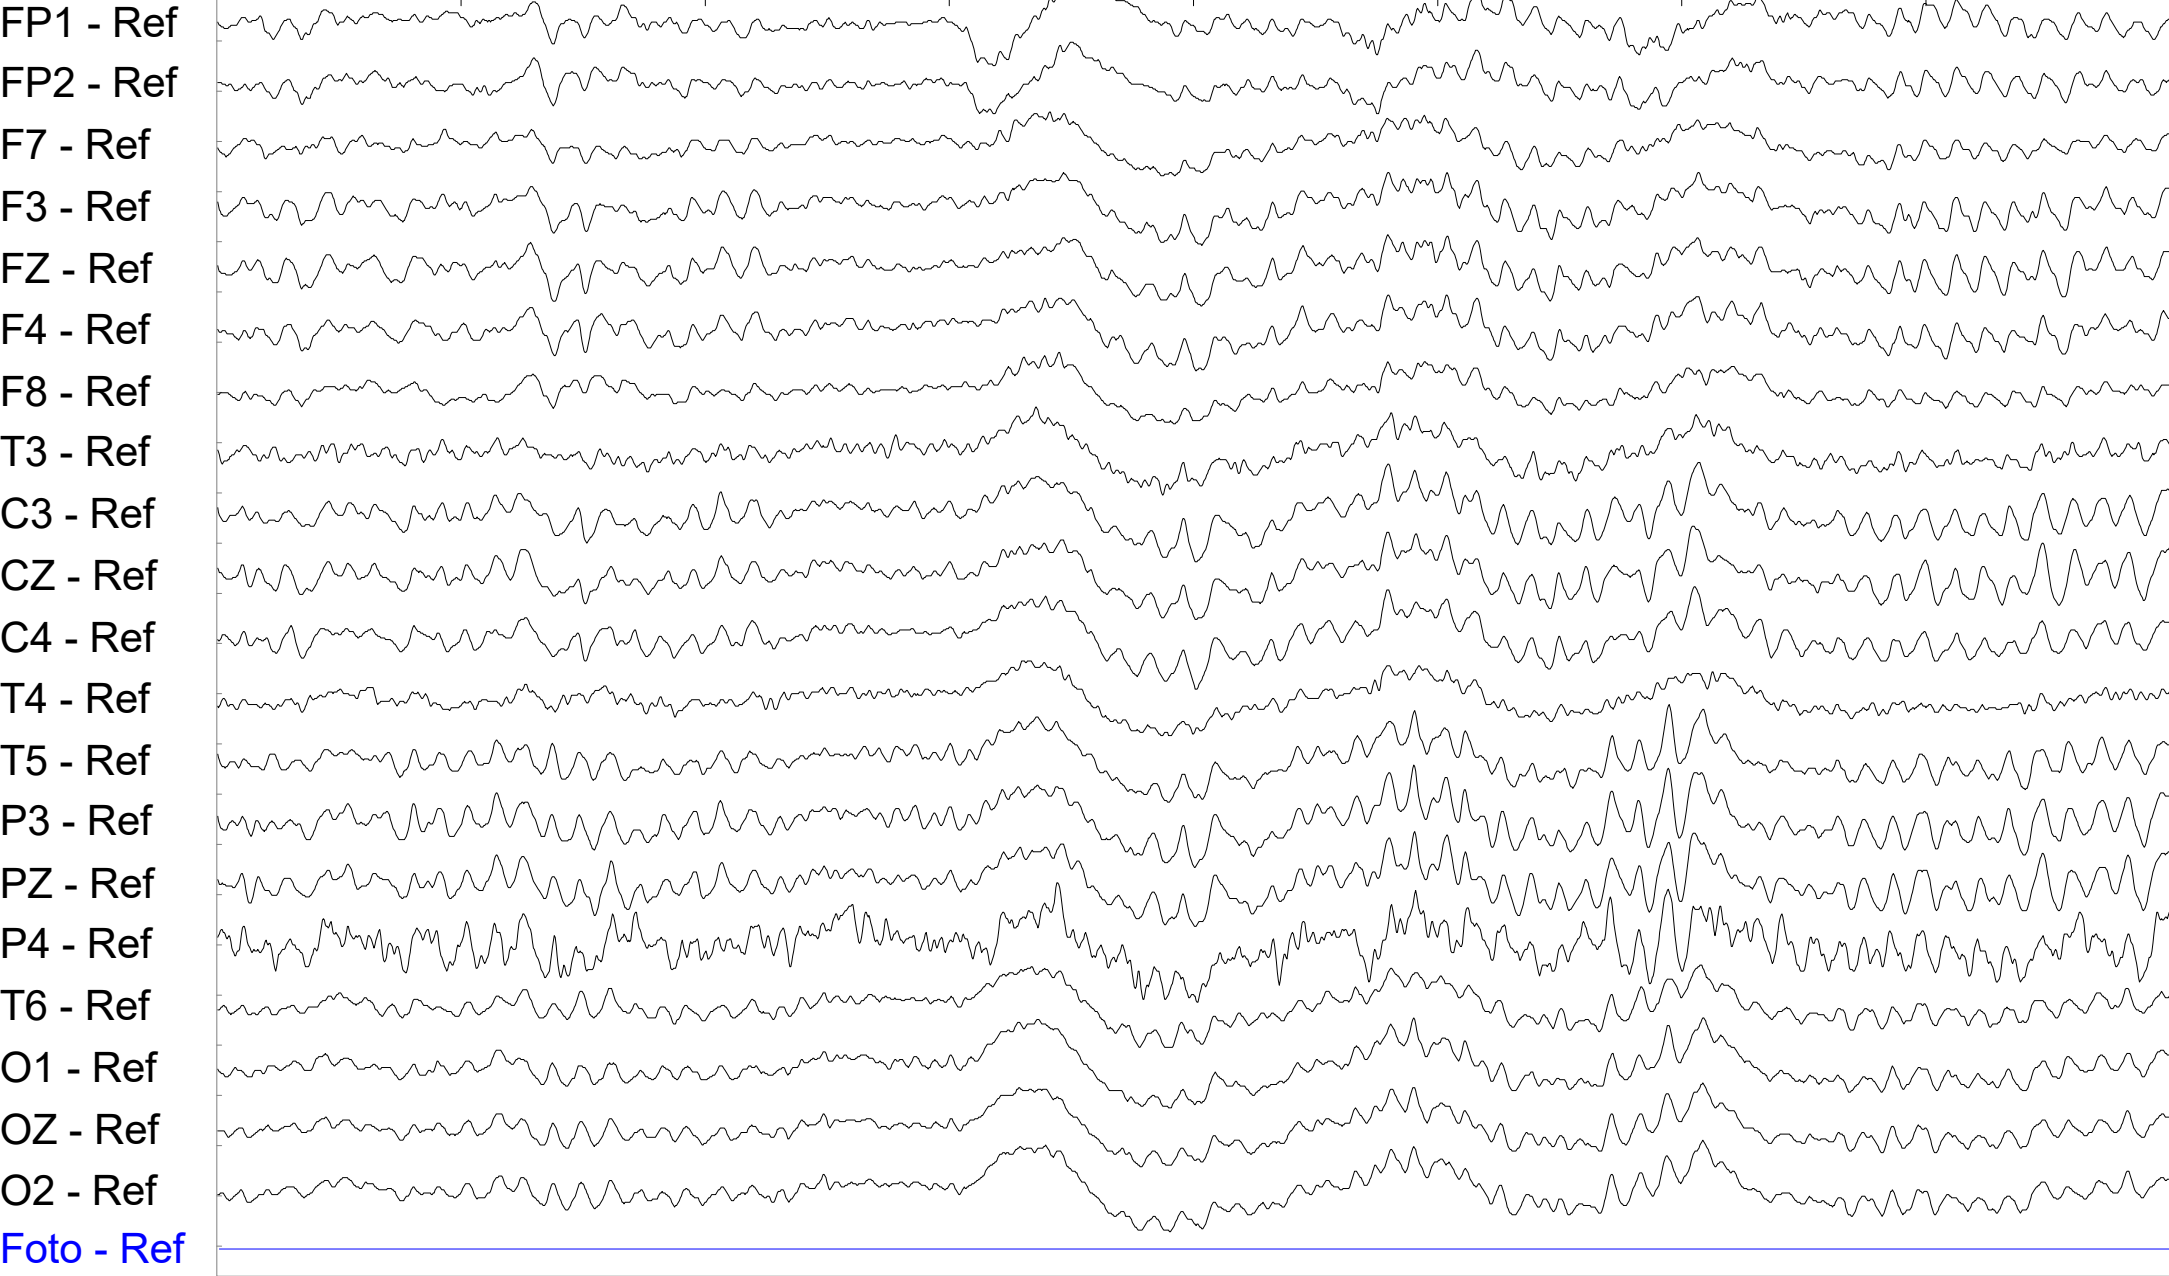


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico


Pág. 22/28

11:15:39 11:15:40 11:15:41 11:15:42 11:15:43 11:15:44 11:15:45 11:15:46
Hiperpneia Hiperpneia Hiperpneia Hiperpneia Hiperpneia Hiperpneia Hiperpneia Hiperpneia
Época: 22 - Horário: 11:15:40 - Estágio: 0 (8 seg.)

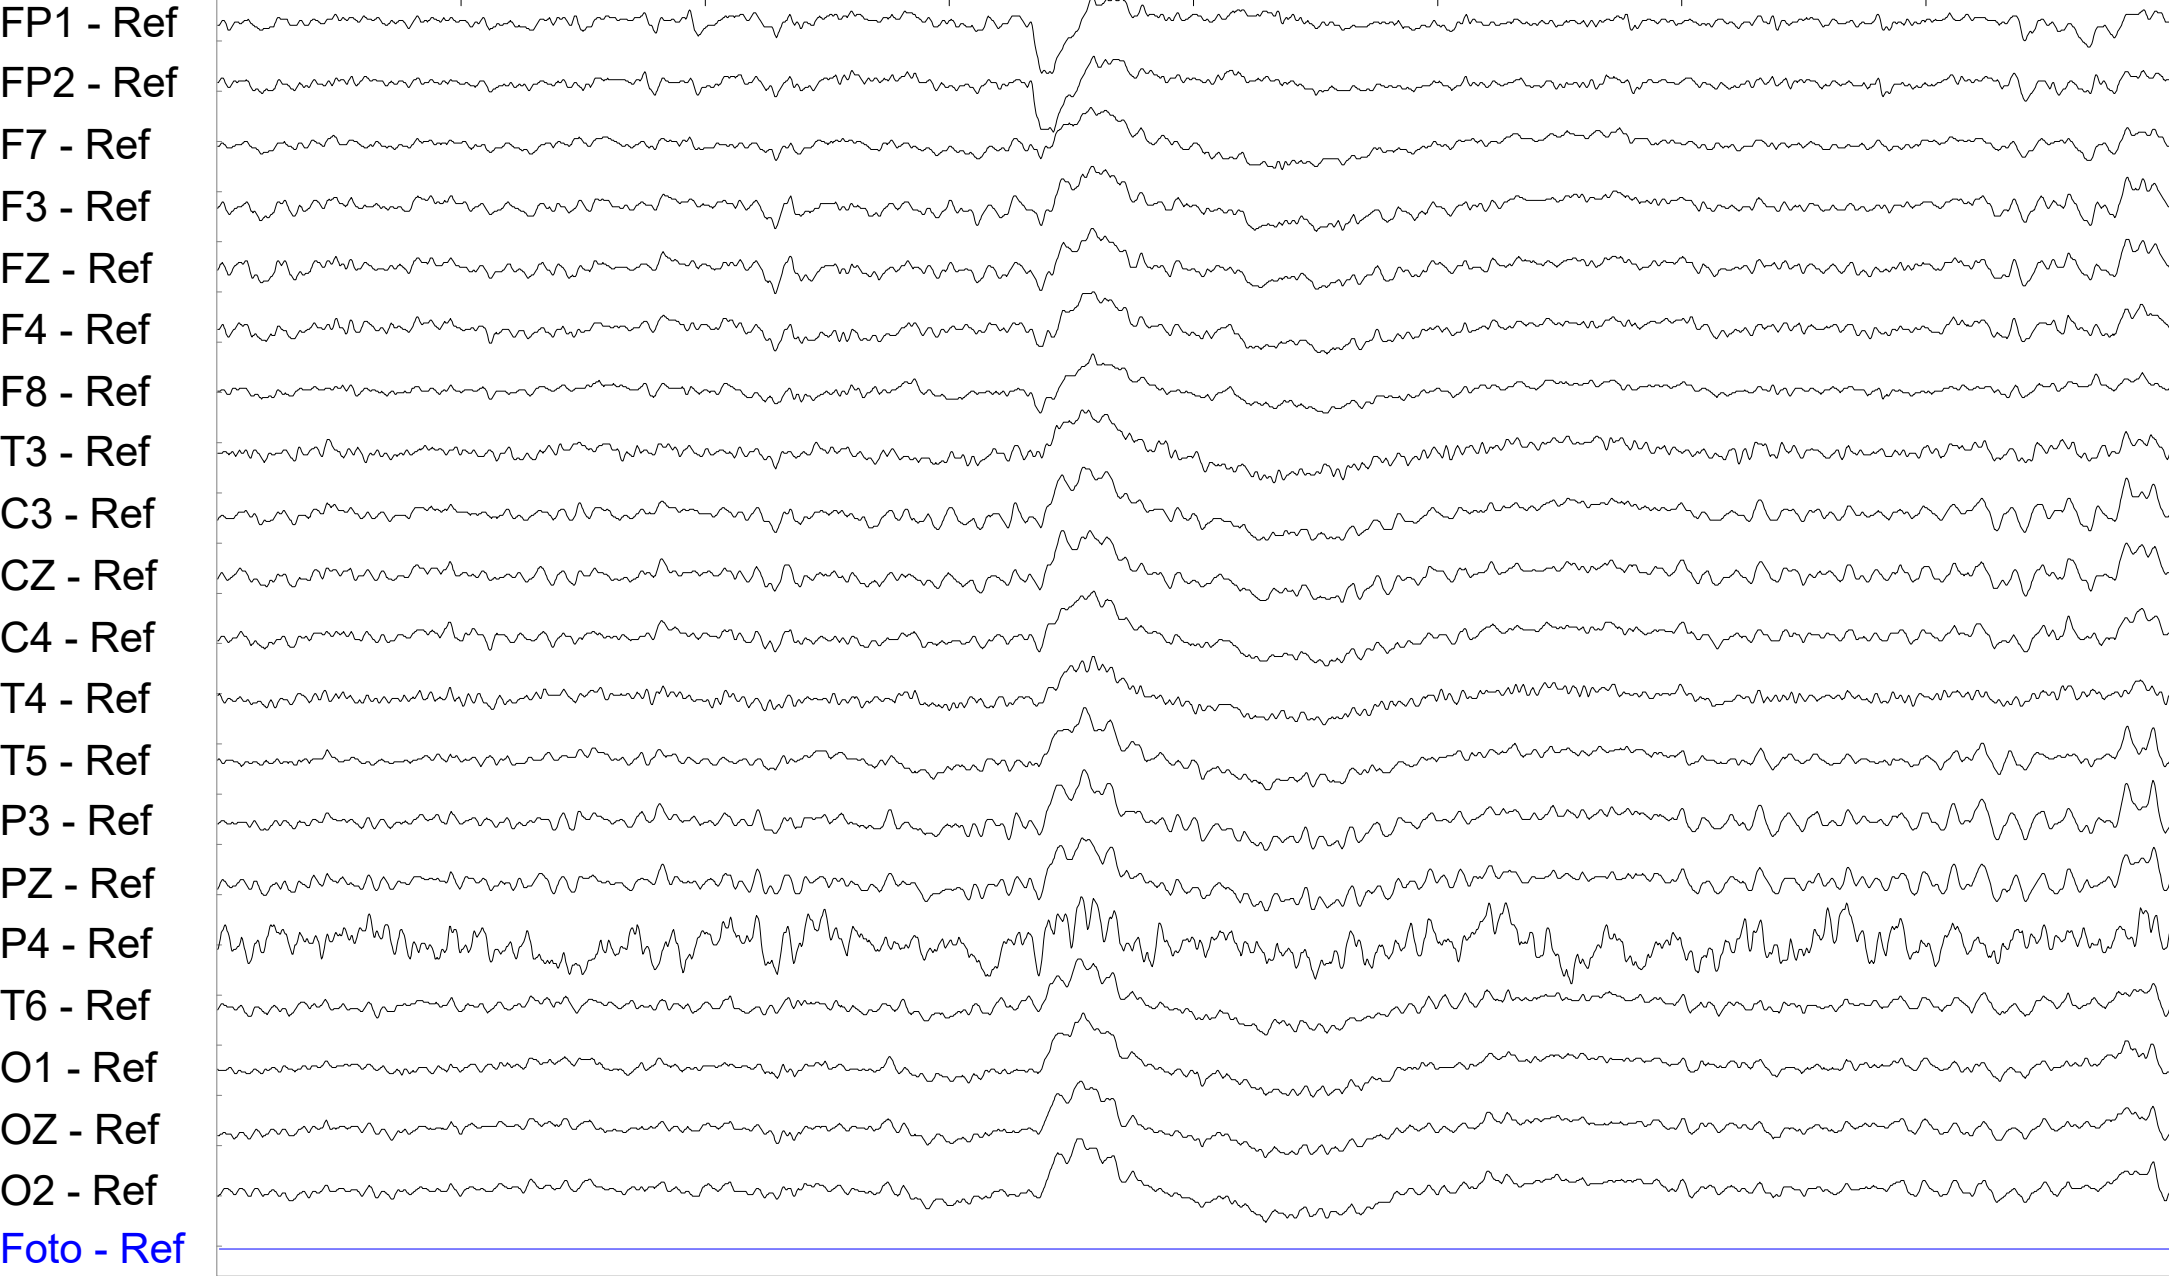


11:17:09 Pós hiperpneia 11:17:10 Pós hiperpneia 11:17:11 Pós hiperpneia 11:17:12 Pós hiperpneia 11:17:13 Pós hiperpneia 11:17:14 Pós hiperpneia 11:17:15 Pós hiperpneia 11:17:16 Pós hiperpneia


Época: 25 - Horário: 11:17:10 - Estágio: 0 (8 seg.)

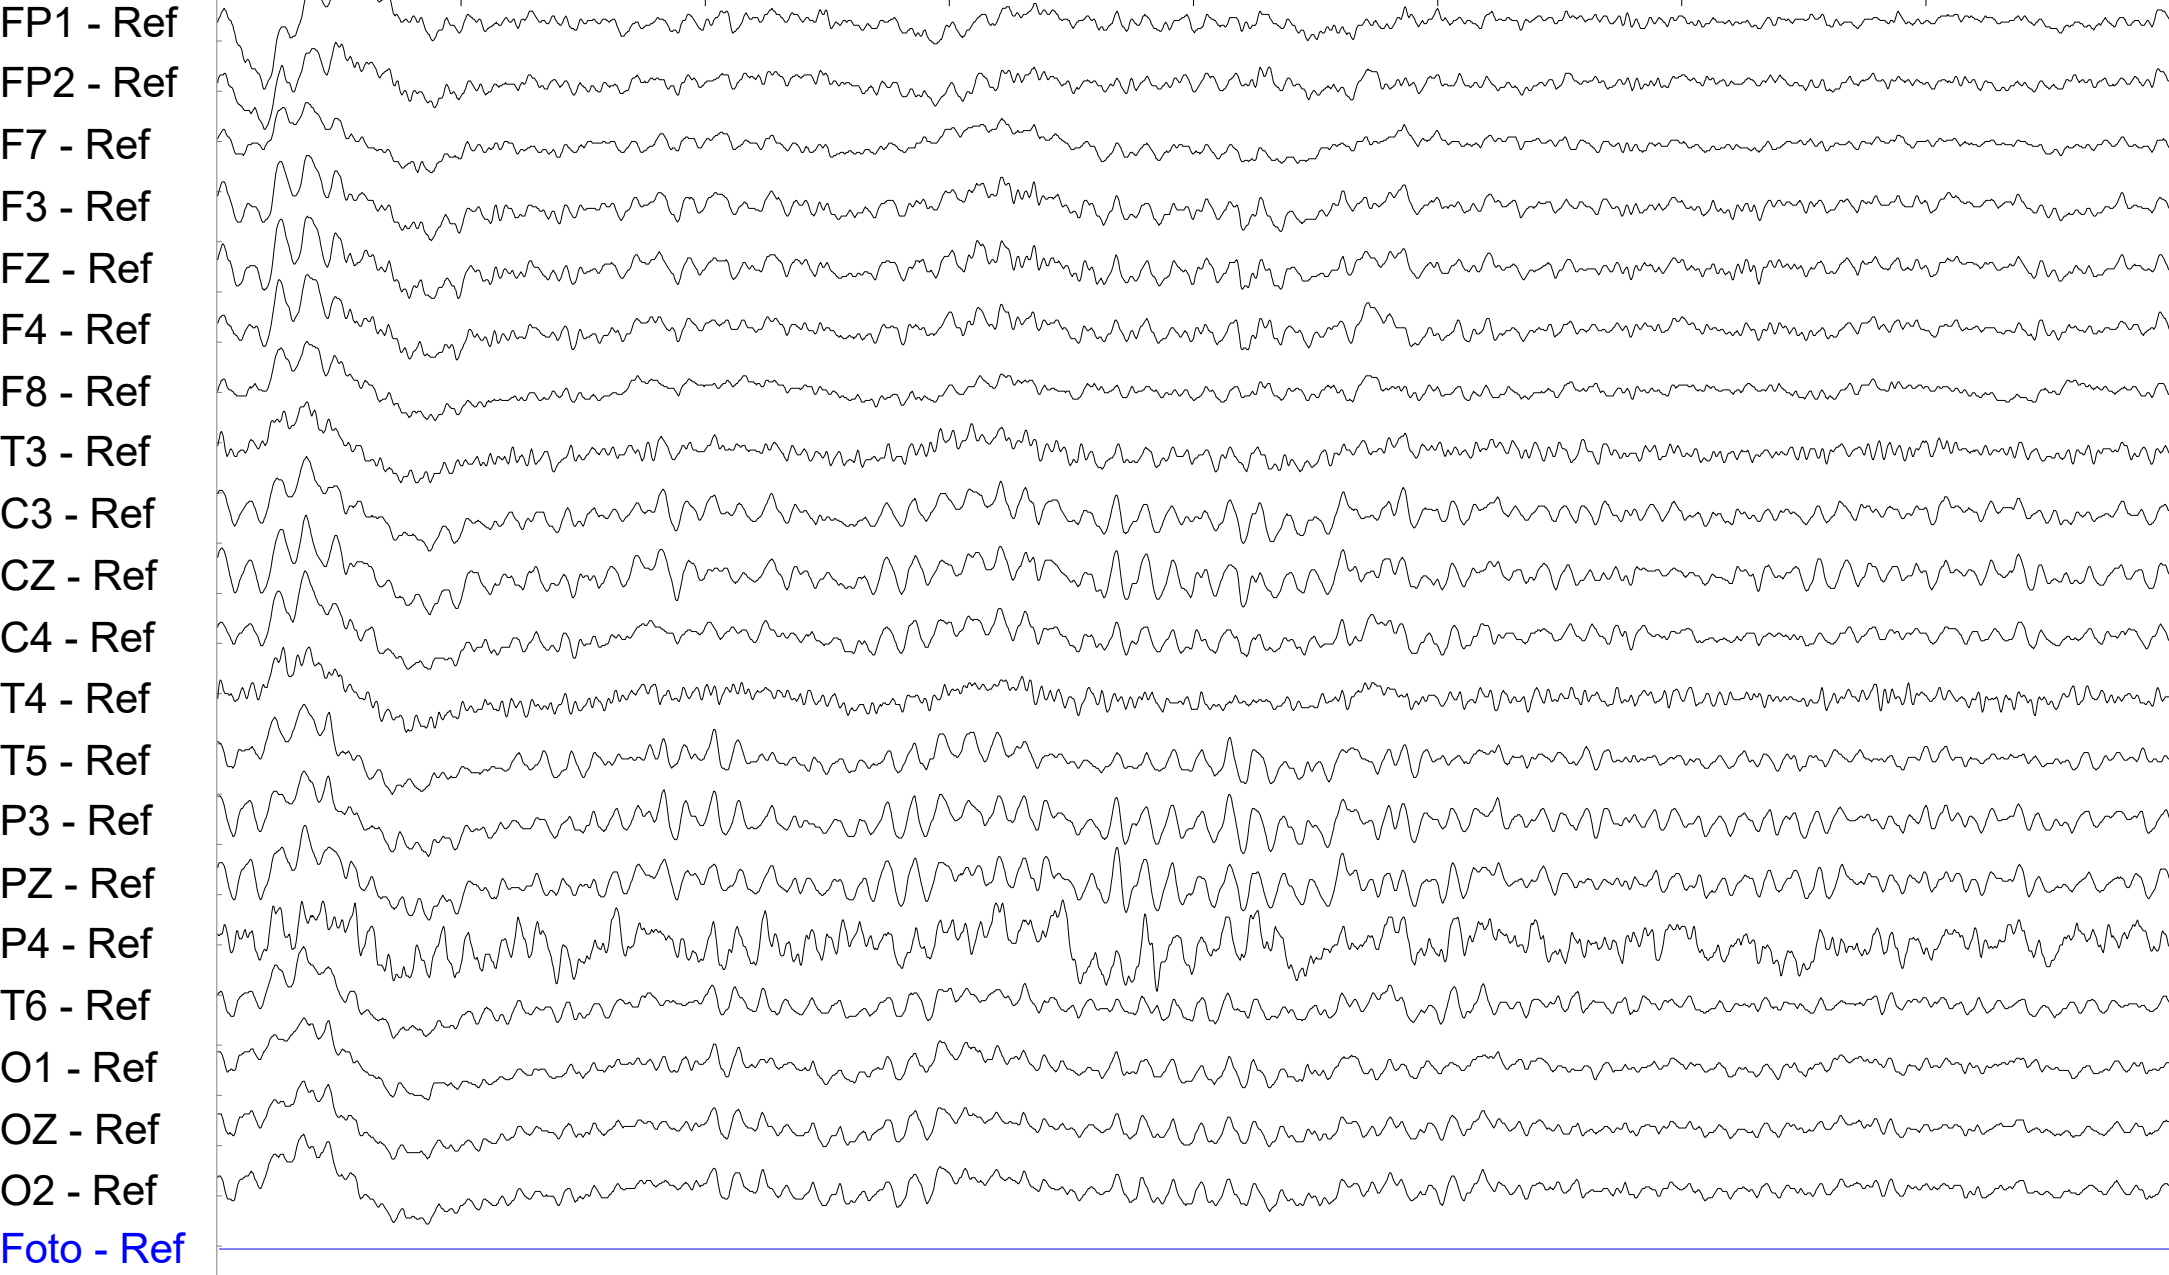

11:17:39 Pós hiperpneia 11:17:40 Pós hiperpneia 11:17:41 Pós hiperpneia 11:17:42 Pós hiperpneia 11:17:43 Pós hiperpneia 11:17:44 Pós hiperpneia 11:17:45 Pós hiperpneia 11:17:46 Pós hiperpneia


Época: 26 - Horário: 11:17:40 - Estágio: 0 (8 seg.)

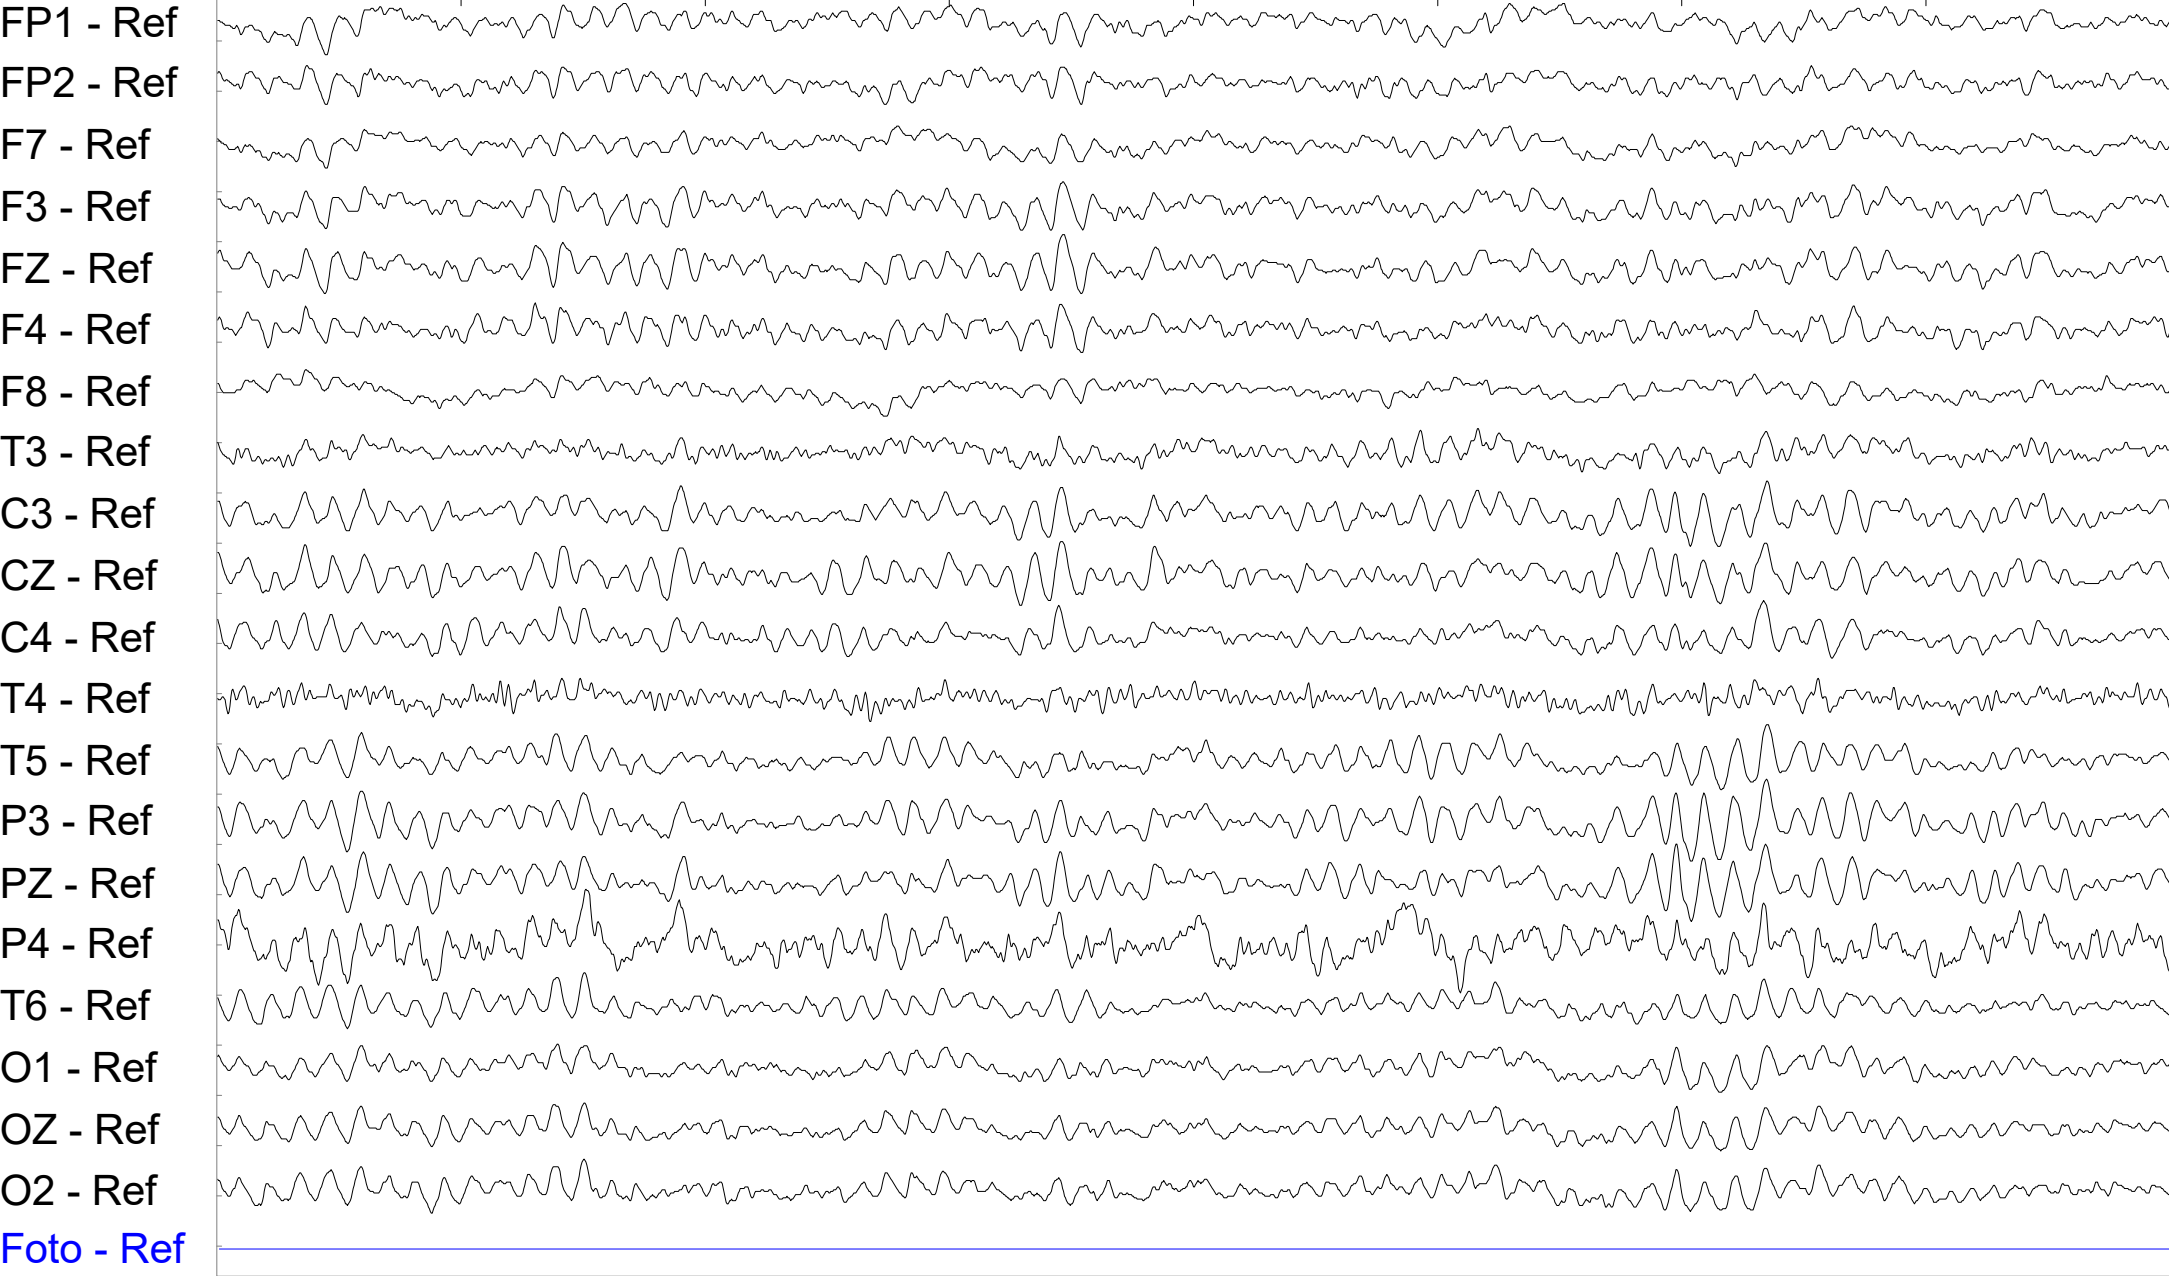





11:18:57 Vigília 11:18:58 Vigília 11:18:59 Vigília 11:19:00 Vigília 11:19:01 Vigília 11:19:02 Vigília 11:19:03 Vigília 11:19:04 Vigília

Época: 28 - Horário: 11:18:58 - Estágio: 0 (8 seg.)

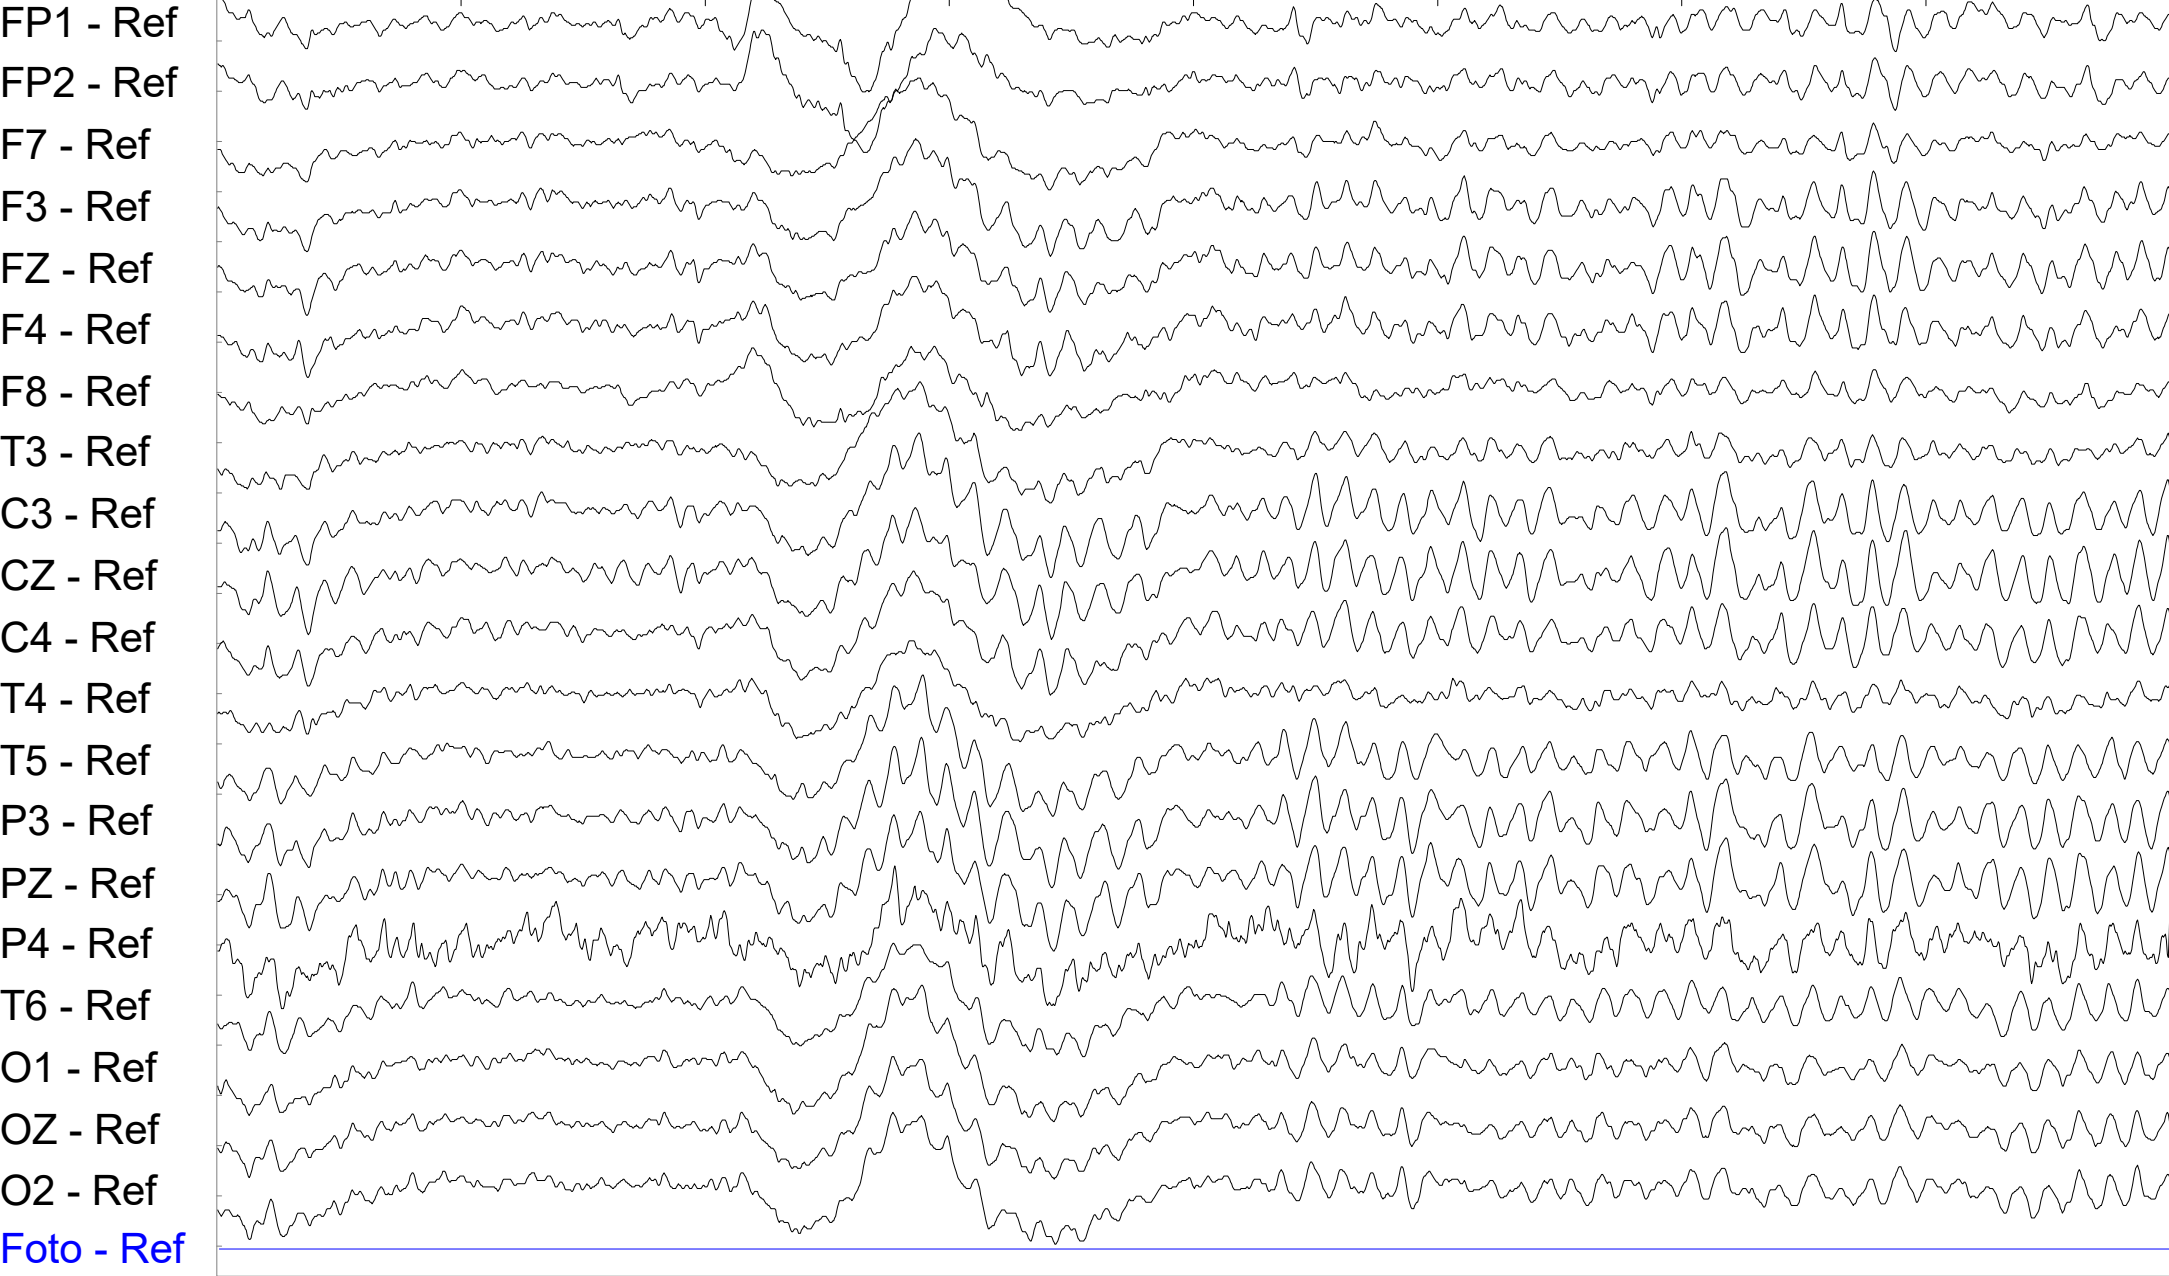

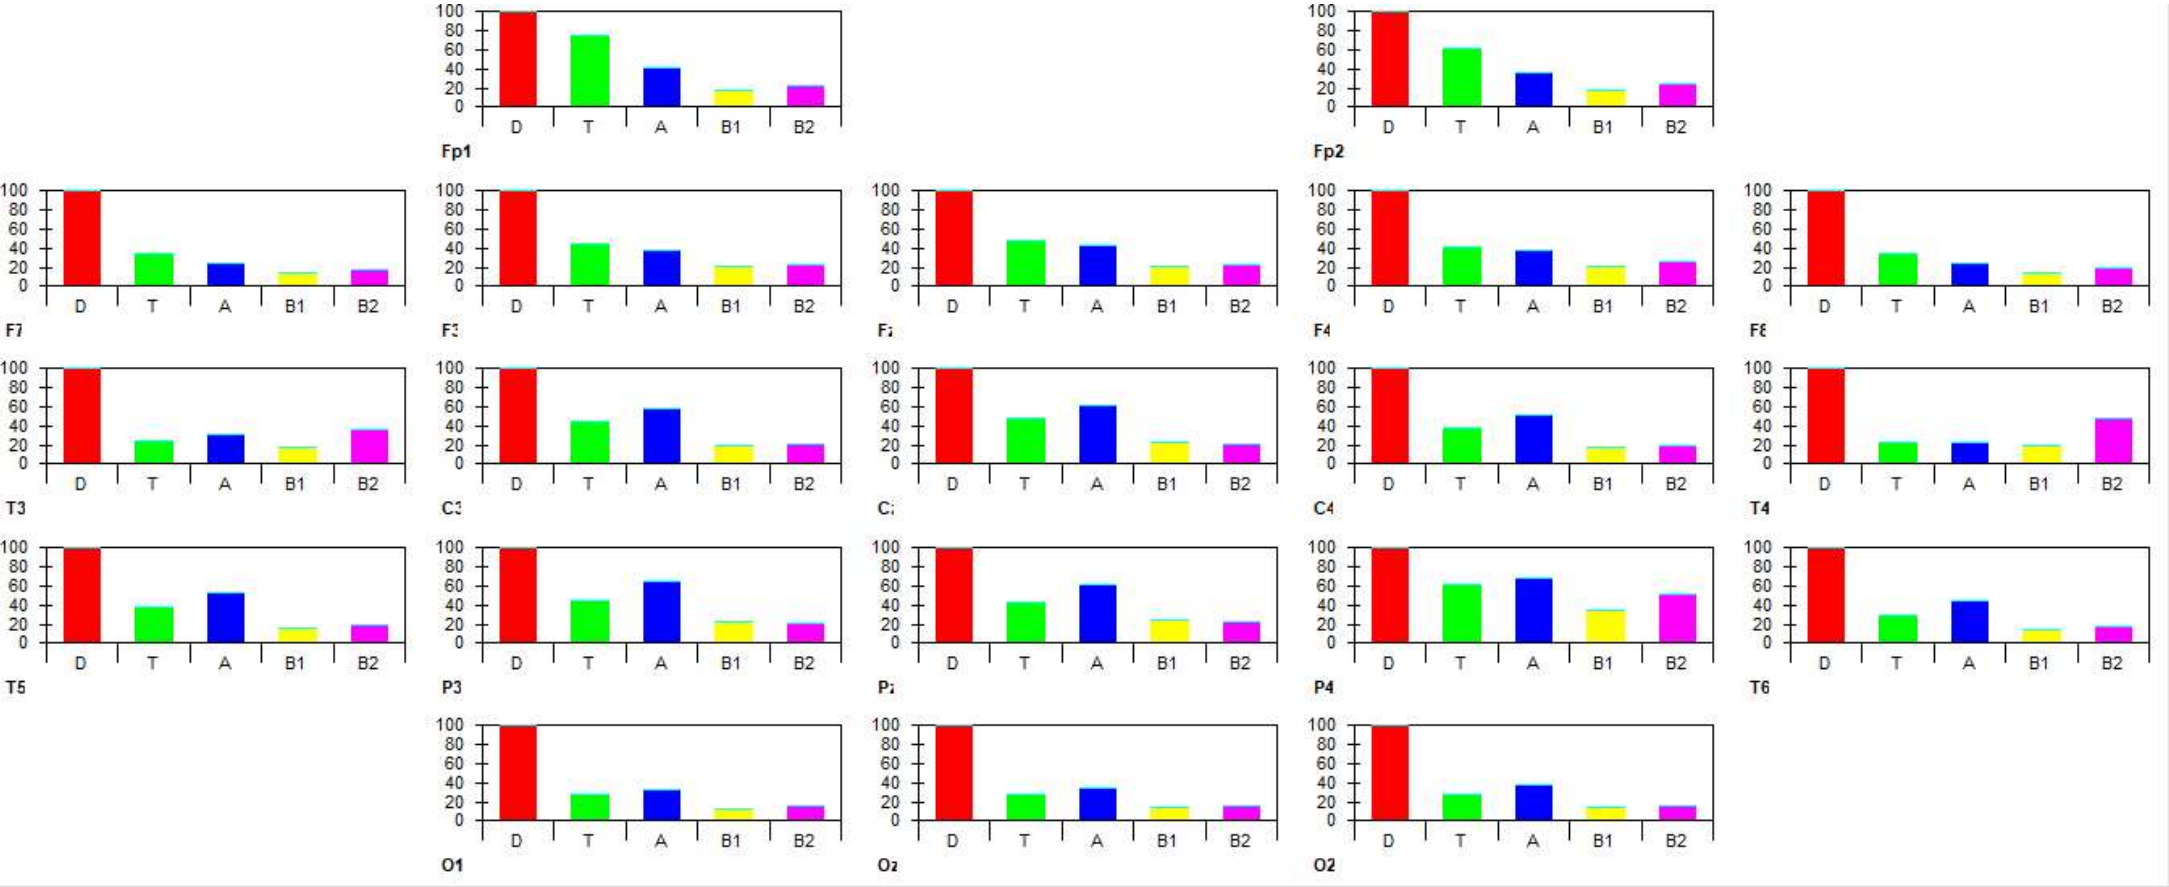

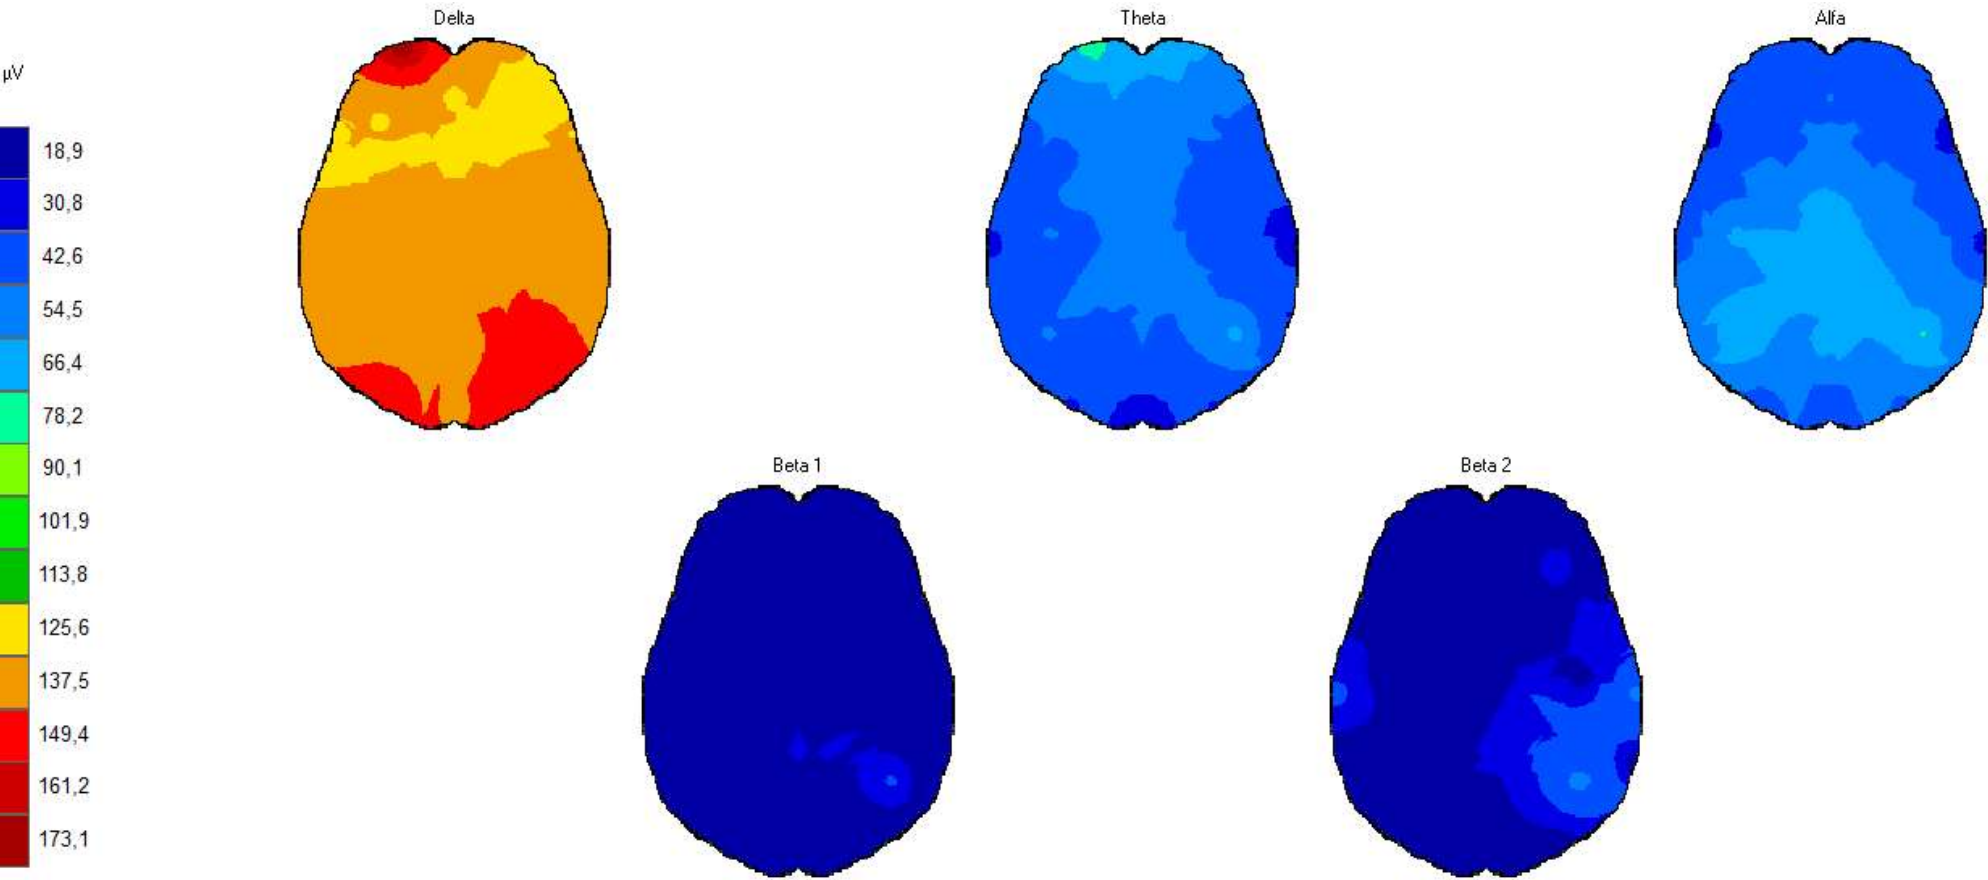

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	178,6	53,1
T	4,5	75,8	22,8
A	8,0	41,0	12,2
B1	13,5	17,8	5,2
B2	18,5	23,3	6,9

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	128,2	47,9
T	4,5	61,6	23,0
A	8,0	36,4	13,6
B1	13,5	17,0	6,3
B2	19,0	24,8	9,3

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	118,8	56,8
T	4,0	34,2	16,3
A	8,5	24,3	11,6
B1	13,5	13,6	6,5
B2	18,5	18,4	8,8

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	121,7	48,7
T	7,5	45,1	18,0
A	8,0	38,7	15,5
B1	16,0	21,0	8,4
B2	18,5	23,5	9,4

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	117,6	46,5
T	7,5	47,7	18,9
A	8,0	43,3	17,1
B1	16,0	21,2	8,4
B2	18,5	23,2	9,2

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	124,3	49,3
T	7,5	41,9	16,6
A	8,0	38,2	15,1
B1	16,5	21,2	8,4
B2	19,0	26,8	10,6

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	125,2	57,5
T	4,5	33,9	15,6
A	8,0	24,3	11,2
B1	16,5	14,0	6,5
B2	19,5	20,2	9,3

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	128,0	53,4
T	4,5	25,2	10,5
A	8,5	31,7	13,2
B1	18,0	17,8	7,4
B2	19,5	36,8	15,4

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	133,4	48,3
T	7,5	44,2	16,0
A	8,5	58,5	21,2
B1	16,5	20,0	7,2
B2	18,5	20,2	7,3

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	131,3	48,2
T	7,5	47,9	16,9
A	8,0	61,1	21,5
B1	16,5	22,0	7,7
B2	18,5	21,8	7,7

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	137,0	51,8
T	7,5	38,2	14,4
A	8,5	52,3	19,7
B1	16,5	18,3	6,9
B2	18,5	19,7	7,4

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	127,8	53,1
T	4,5	22,1	9,2
A	8,0	23,6	9,8
B1	18,0	19,5	8,1
B2	24,5	47,6	19,8

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	136,8	52,2
T	7,5	37,9	14,5
A	8,5	52,7	20,1
B1	16,5	16,0	6,1
B2	21,0	18,6	7,1

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	134,8	48,8
T	7,5	44,4	15,4
A	8,5	65,9	22,9
B1	16,5	22,3	7,7
B2	18,5	20,7	7,2

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	131,7	48,7
T	7,5	42,7	15,1
A	8,0	61,7	21,9
B1	16,5	23,9	8,5
B2	18,5	22,1	7,8

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	145,0	40,1
T	7,5	61,1	16,9
A	8,5	69,3	19,2
B1	16,5	34,0	9,4
B2	18,5	52,4	14,5

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	131,3	55,3
T	7,5	29,2	12,3
A	8,5	44,1	18,6
B1	16,5	14,8	6,2
B2	18,5	18,3	7,7

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	144,7	61,5
T	4,5	28,4	12,1
A	8,5	33,1	14,1
B1	16,5	13,2	5,8
B2	18,5	15,9	6,8

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	135,3	59,5
T	7,5	27,8	12,2
A	8,5	35,4	15,5
B1	16,5	14,0	6,1
B2	18,5	15,1	6,7

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	145,3	60,1
T	7,5	28,4	11,7
A	8,5	37,5	15,5
B1	16,5	14,7	6,1
B2	18,5	16,1	6,6

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	178,6	53,1	4,5	75,8	22,5	8,0	41,0	12,2	13,5	17,6	5,2	18,5	23,3	6,9
FP2	1,0	128,2	47,9	4,5	61,6	23,0	8,0	36,4	13,6	13,5	17,0	6,3	19,0	24,8	9,3
F7	,5	118,8	56,8	4,0	34,2	16,3	8,5	24,3	11,6	13,5	13,6	6,5	18,5	18,4	8,8
F3	,5	121,7	48,7	7,5	45,1	18,0	8,0	38,7	15,5	16,0	21,0	8,4	18,5	23,5	9,4
FZ	,5	117,6	46,5	7,5	47,7	18,9	8,0	43,3	17,1	16,0	21,2	8,4	18,5	23,2	9,2
F4	,5	124,3	49,3	7,5	41,9	16,6	8,0	38,2	15,1	16,5	21,2	8,4	19,0	26,8	10,6
F8	,5	125,2	57,5	4,5	33,9	15,6	8,0	24,3	11,2	16,5	14,0	6,5	19,5	20,2	9,3
T3	,5	128,0	53,4	4,5	25,2	10,5	8,5	31,7	13,2	18,0	17,8	7,4	19,5	36,8	15,4
C3	,5	133,4	48,3	7,5	44,2	16,0	8,5	58,5	21,2	16,5	20,0	7,2	18,5	20,2	7,3
CZ	,5	131,3	46,2	7,5	47,9	16,9	8,0	61,1	21,5	16,5	22,0	7,7	18,5	21,8	7,7
C4	,5	137,0	51,6	7,5	38,2	14,4	8,5	52,3	19,7	16,5	18,3	6,9	18,5	19,7	7,4
T4	,5	127,8	53,1	4,5	22,1	9,2	8,0	23,6	9,8	18,0	19,5	8,1	24,5	47,6	19,8
T5	,5	136,8	52,2	7,5	37,9	14,5	8,5	52,7	20,1	16,5	16,0	6,1	21,0	18,6	7,1
P3	,5	134,8	46,8	7,5	44,4	15,4	8,5	65,9	22,9	16,5	22,3	7,7	18,5	20,7	7,2
PZ	,5	131,7	46,7	7,5	42,7	15,1	8,0	61,7	21,9	16,5	23,9	8,5	18,5	22,1	7,8
P4	,5	145,0	40,1	7,5	61,1	16,9	8,5	69,3	19,2	16,5	34,0	9,4	18,5	52,4	14,5
T6	,5	131,3	55,3	7,5	29,2	12,3	8,5	44,1	18,6	16,5	14,6	6,2	18,5	18,3	7,7
O1	,5	144,7	61,5	4,5	28,4	12,1	8,5	33,1	14,1	16,5	13,2	5,6	18,5	15,9	6,8
OZ	,5	135,3	59,5	7,5	27,8	12,2	8,5	35,4	15,5	16,5	14,0	6,1	18,5	15,1	6,7
O2	,5	145,3	60,1	7,5	28,4	11,7	8,5	37,5	15,5	16,5	14,7	6,1	18,5	16,1	6,6

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	178,6	53,1	4,5	75,8	22,5	8,0	41,0	12,2	13,5	17,6	5,2	18,5	23,3	6,9
FP2	1,0	128,2	47,9	4,5	61,6	23,0	8,0	36,4	13,6	13,5	17,0	6,3	19,0	24,8	9,3
F7	,5	118,8	56,8	4,0	34,2	16,3	8,5	24,3	11,6	13,5	13,6	6,5	18,5	18,4	8,8
F3	,5	121,7	48,7	7,5	45,1	18,0	8,0	38,7	15,5	16,0	21,0	8,4	18,5	23,5	9,4
FZ	,5	117,6	46,5	7,5	47,7	18,9	8,0	43,3	17,1	16,0	21,2	8,4	18,5	23,2	9,2
F4	,5	124,3	49,3	7,5	41,9	16,6	8,0	38,2	15,1	16,5	21,2	8,4	19,0	26,8	10,6
F8	,5	125,2	57,5	4,5	33,9	15,6	8,0	24,3	11,2	16,5	14,0	6,5	19,5	20,2	9,3
T3	,5	128,0	53,4	4,5	25,2	10,5	8,5	31,7	13,2	18,0	17,8	7,4	19,5	36,8	15,4
C3	,5	133,4	48,3	7,5	44,2	16,0	8,5	58,5	21,2	16,5	20,0	7,2	18,5	20,2	7,3
CZ	,5	131,3	46,2	7,5	47,9	16,9	8,0	61,1	21,5	16,5	22,0	7,7	18,5	21,8	7,7
C4	,5	137,0	51,6	7,5	38,2	14,4	8,5	52,3	19,7	16,5	18,3	6,9	18,5	19,7	7,4
T4	,5	127,8	53,1	4,5	22,1	9,2	8,0	23,6	9,8	18,0	19,5	8,1	24,5	47,6	19,8
T5	,5	136,8	52,2	7,5	37,9	14,5	8,5	52,7	20,1	16,5	16,0	6,1	21,0	18,6	7,1
P3	,5	134,8	46,8	7,5	44,4	15,4	8,5	65,9	22,9	16,5	22,3	7,7	18,5	20,7	7,2
PZ	,5	131,7	46,7	7,5	42,7	15,1	8,0	61,7	21,9	16,5	23,9	8,5	18,5	22,1	7,8
P4	,5	145,0	40,1	7,5	61,1	16,9	8,5	69,3	19,2	16,5	34,0	9,4	18,5	52,4	14,5
T6	,5	131,3	55,3	7,5	29,2	12,3	8,5	44,1	18,6	16,5	14,6	6,2	18,5	18,3	7,7
O1	,5	144,7	61,5	4,5	28,4	12,1	8,5	33,1	14,1	16,5	13,2	5,6	18,5	15,9	6,8
OZ	,5	135,3	59,5	7,5	27,8	12,2	8,5	35,4	15,5	16,5	14,0	6,1	18,5	15,1	6,7
O2	,5	145,3	60,1	7,5	28,4	11,7	8,5	37,5	15,5	16,5	14,7	6,1	18,5	16,1	6,6

Relação de modos de gravação e eventos

Pág. 1

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	11:05:10	02:37	Olhos abertos
6	11:07:46	04:12	Olhos fechados
14	11:11:58	01:16	Vigília
17	11:13:14	01:16	Foto Estimulação
17	11:13:19	00:00	Foto 1 hz
17	11:13:24	00:00	Foto 3 hz
17	11:13:29	00:00	Foto 6 hz
17	11:13:34	00:00	Foto Desativado
17	11:13:34	00:00	Foto 1 hz
17	11:13:36	00:00	Foto 1 hz
18	11:13:41	00:00	Foto 3 hz
18	11:13:46	00:00	Foto 6 hz
18	11:13:51	00:00	Foto Desativado
18	11:13:53	00:00	Foto 1 hz
18	11:13:58	00:00	Foto 3 hz
18	11:14:03	00:00	Foto 6 hz
18	11:14:08	00:00	Foto Desativado
18	11:14:08	00:00	Foto 1 hz
19	11:14:30	01:08	Vigília
19	11:14:13	00:00	Foto 3 hz
19	11:14:18	00:00	Foto 6 hz
19	11:14:23	00:00	Foto Desativado
21	11:15:38	01:19	Hiperpneia
24	11:16:57	01:27	Pós hiperpneia
27	11:18:24	00:41	Vigília