


15:57:20	15:57:20	15:57:21	15:57:22	15:57:23	15:57:24	15:57:25	15:57:26
Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos	Olhos abertos
Época: 1 - Horário: 15:57:20 - Estágio: 0 (8 seg.)							

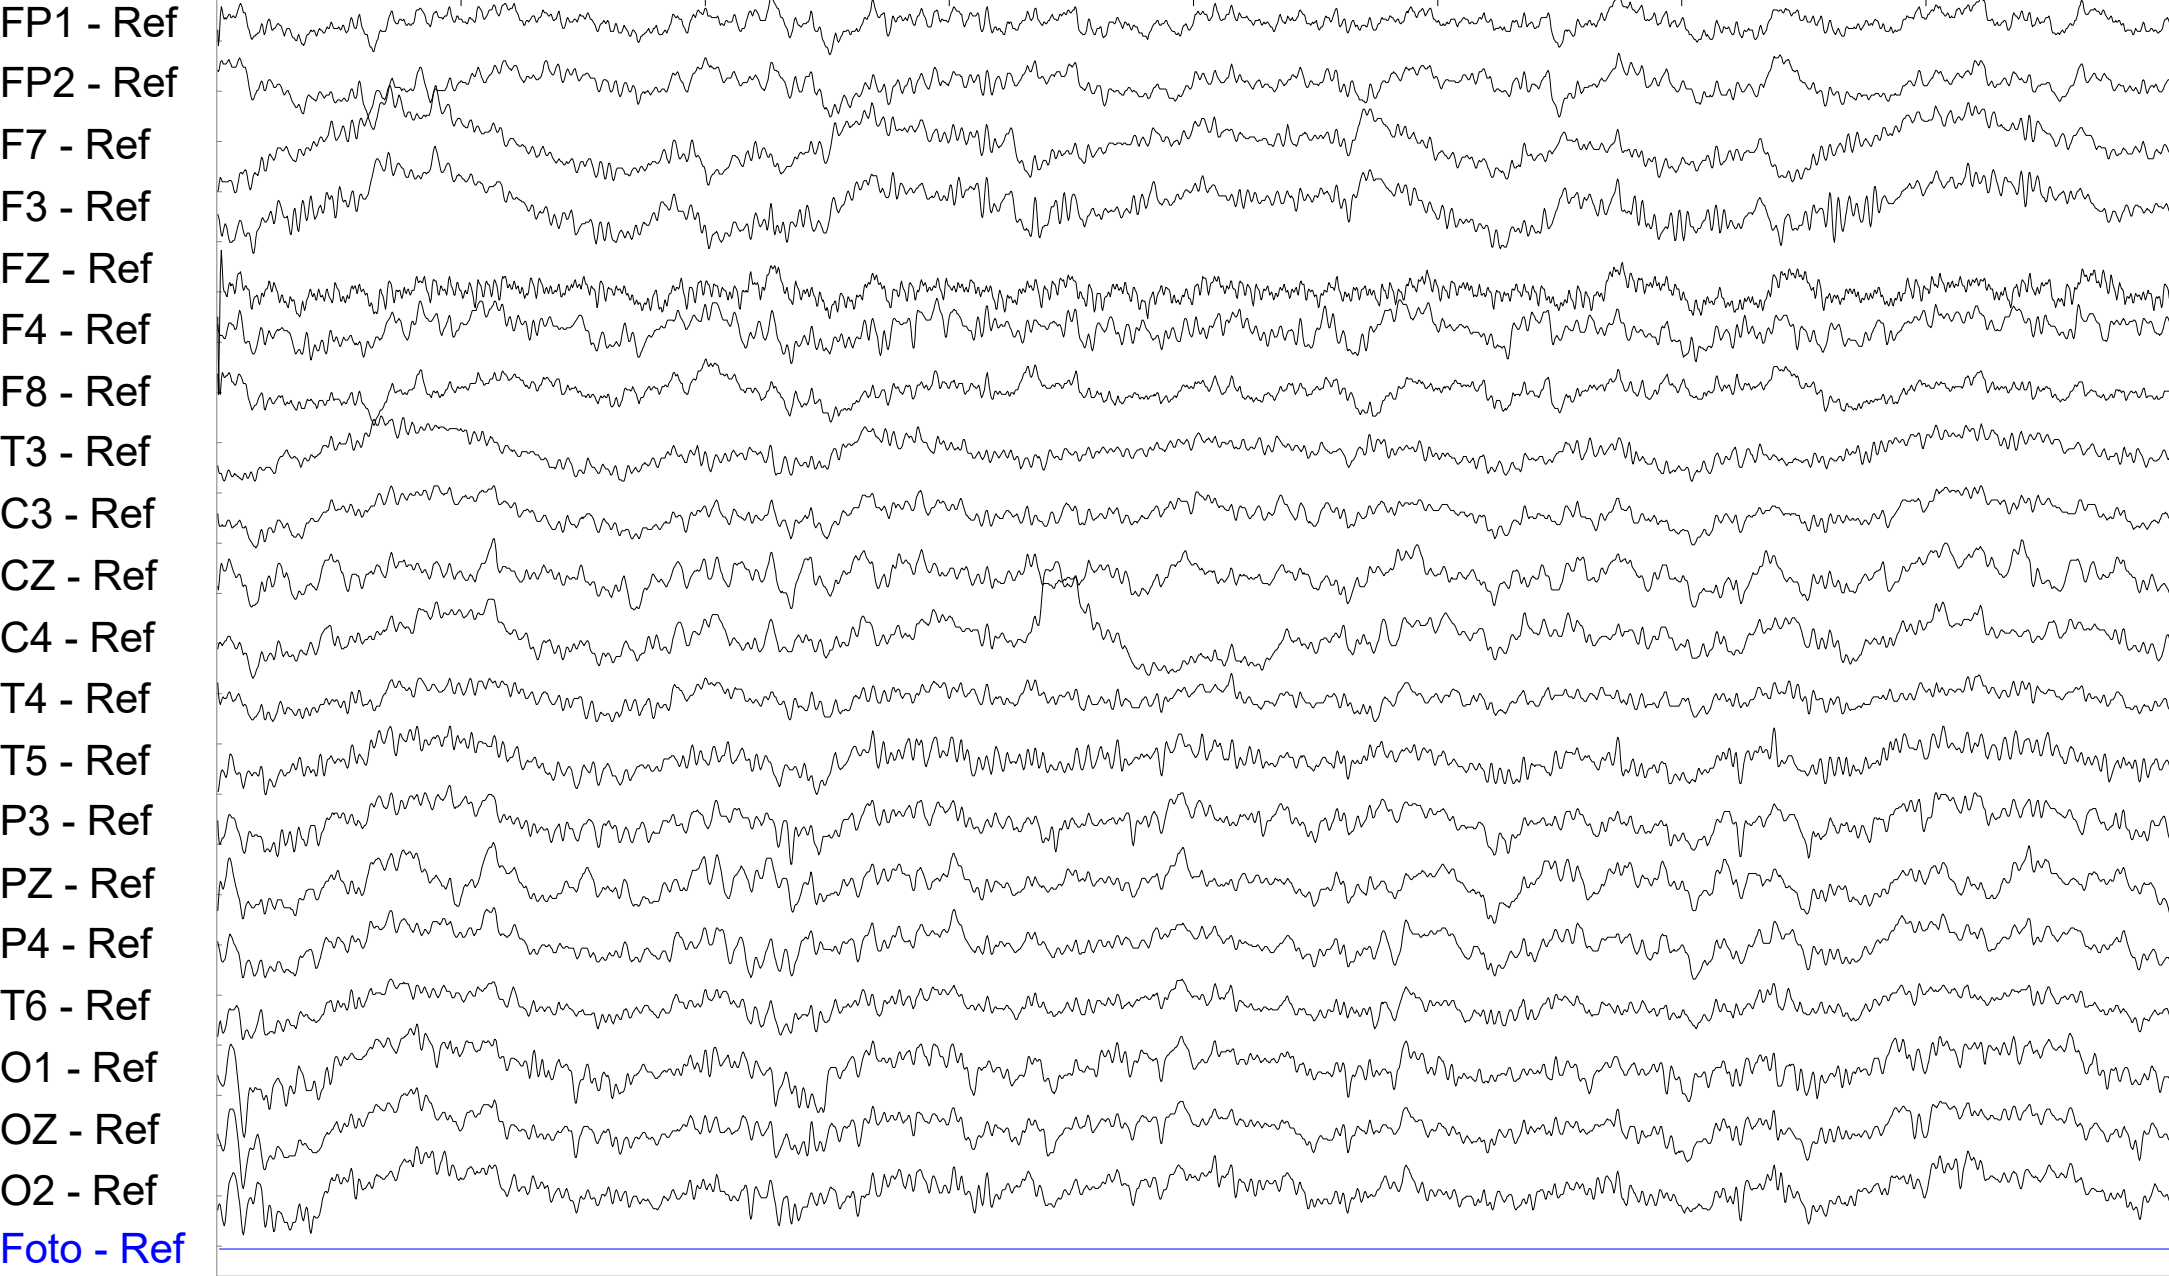



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 6/20


15:59:49 Olhos fechados 15:59:50 Olhos fechados 15:59:51 Olhos fechados 15:59:52 Olhos fechados 15:59:53 Olhos fechados 15:59:54 Olhos fechados 15:59:55 Olhos fechados 15:59:56 Olhos fechados
Época: 6 - Horário: 15:59:50 - Estágio: 0 (8 seg.)

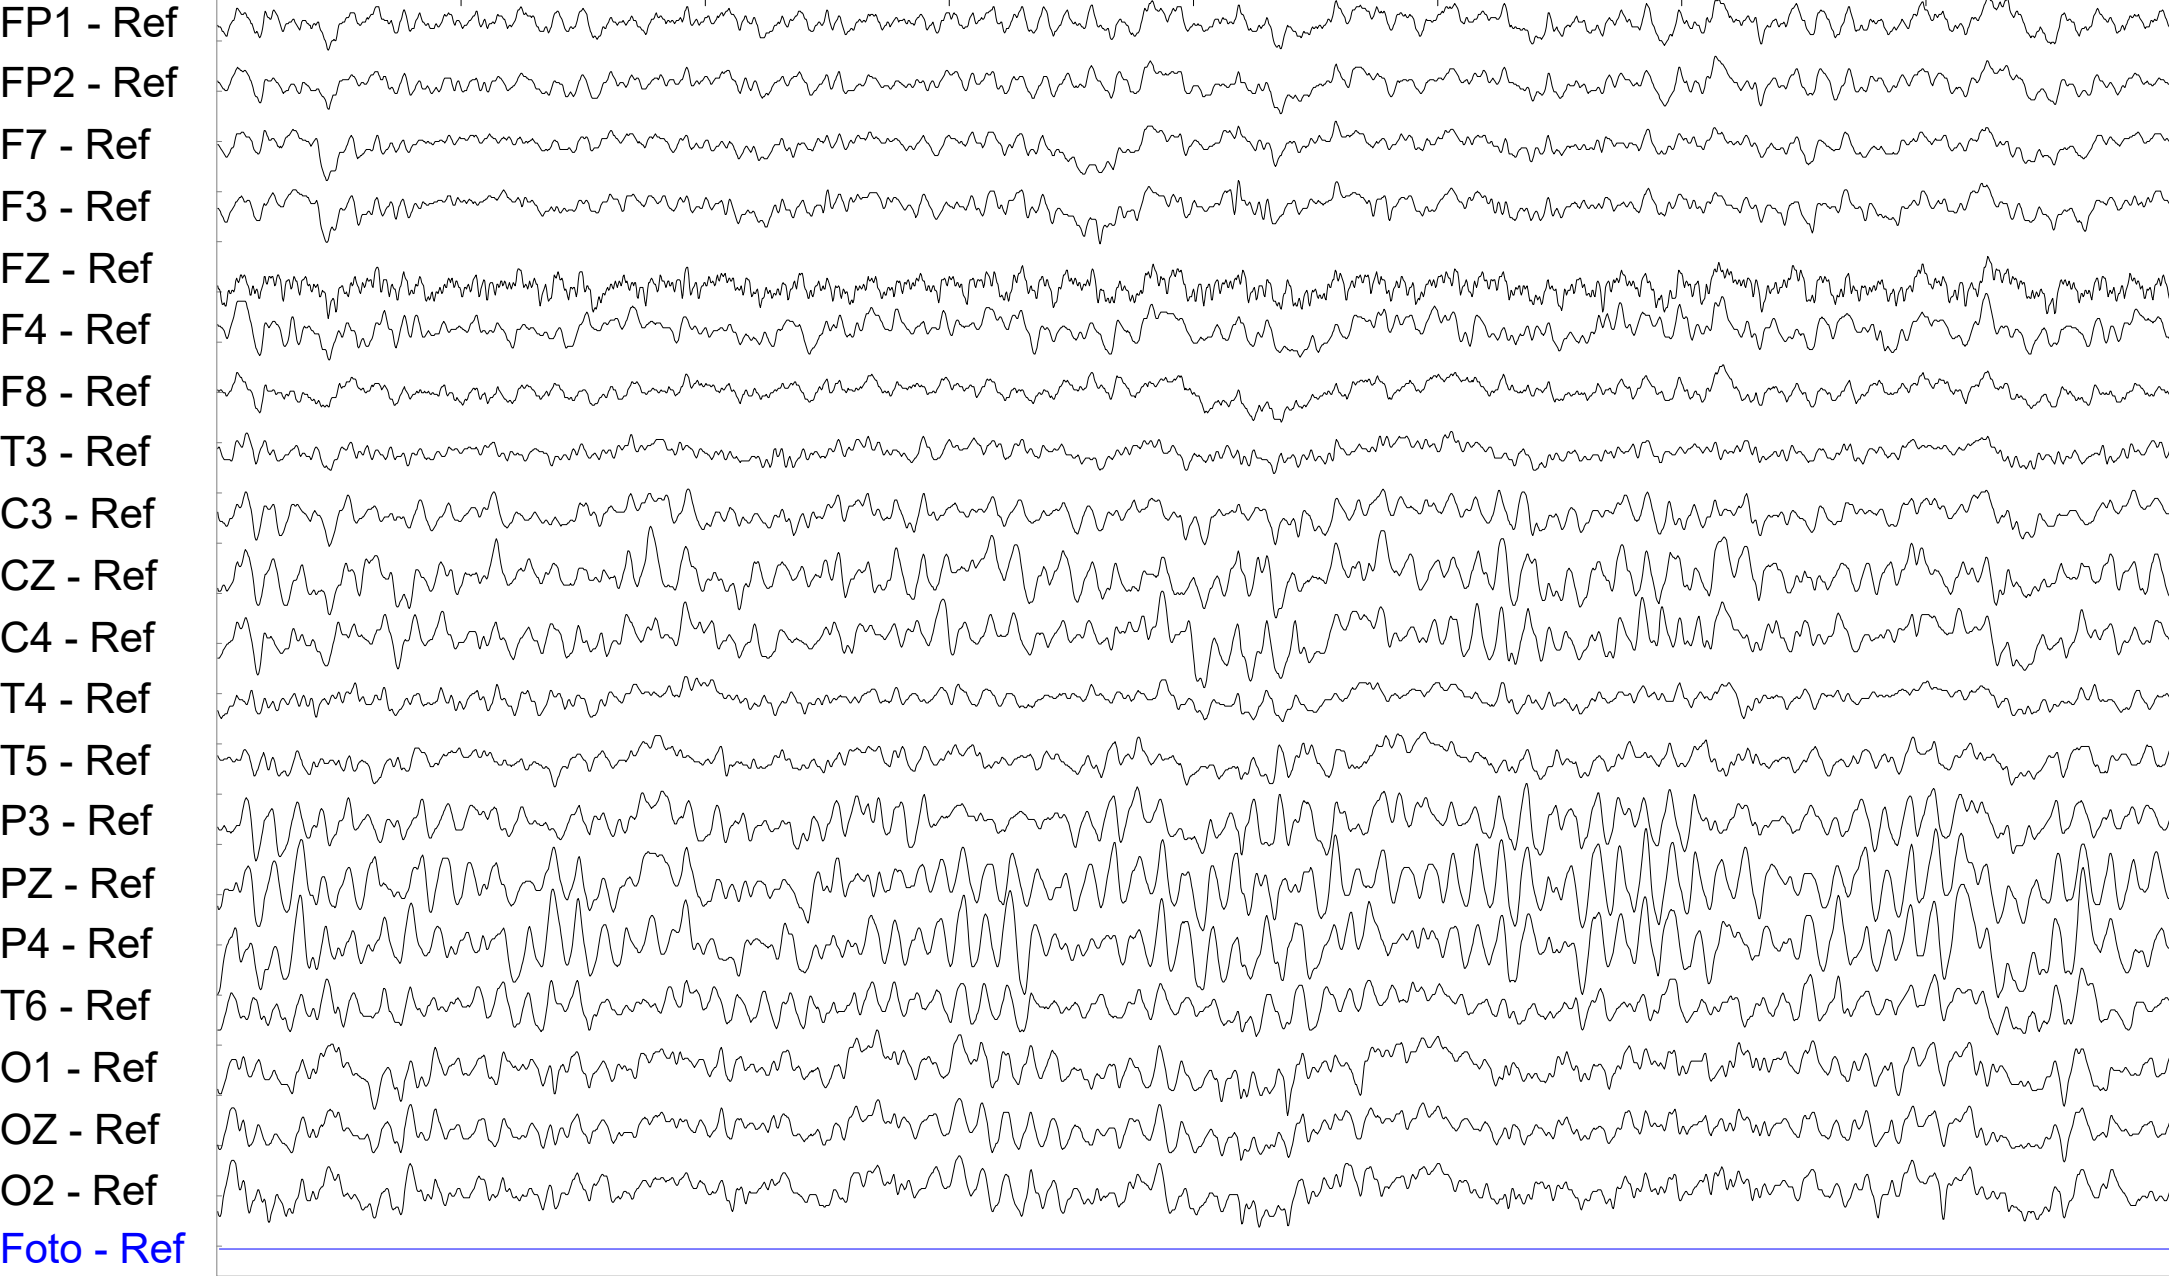




16:01:19	16:01:20	16:01:21	16:01:22	16:01:23	16:01:24	16:01:25	16:01:26
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados


Época: 9 - Horário: 16:01:20 - Estágio: 0 (8 seg.)

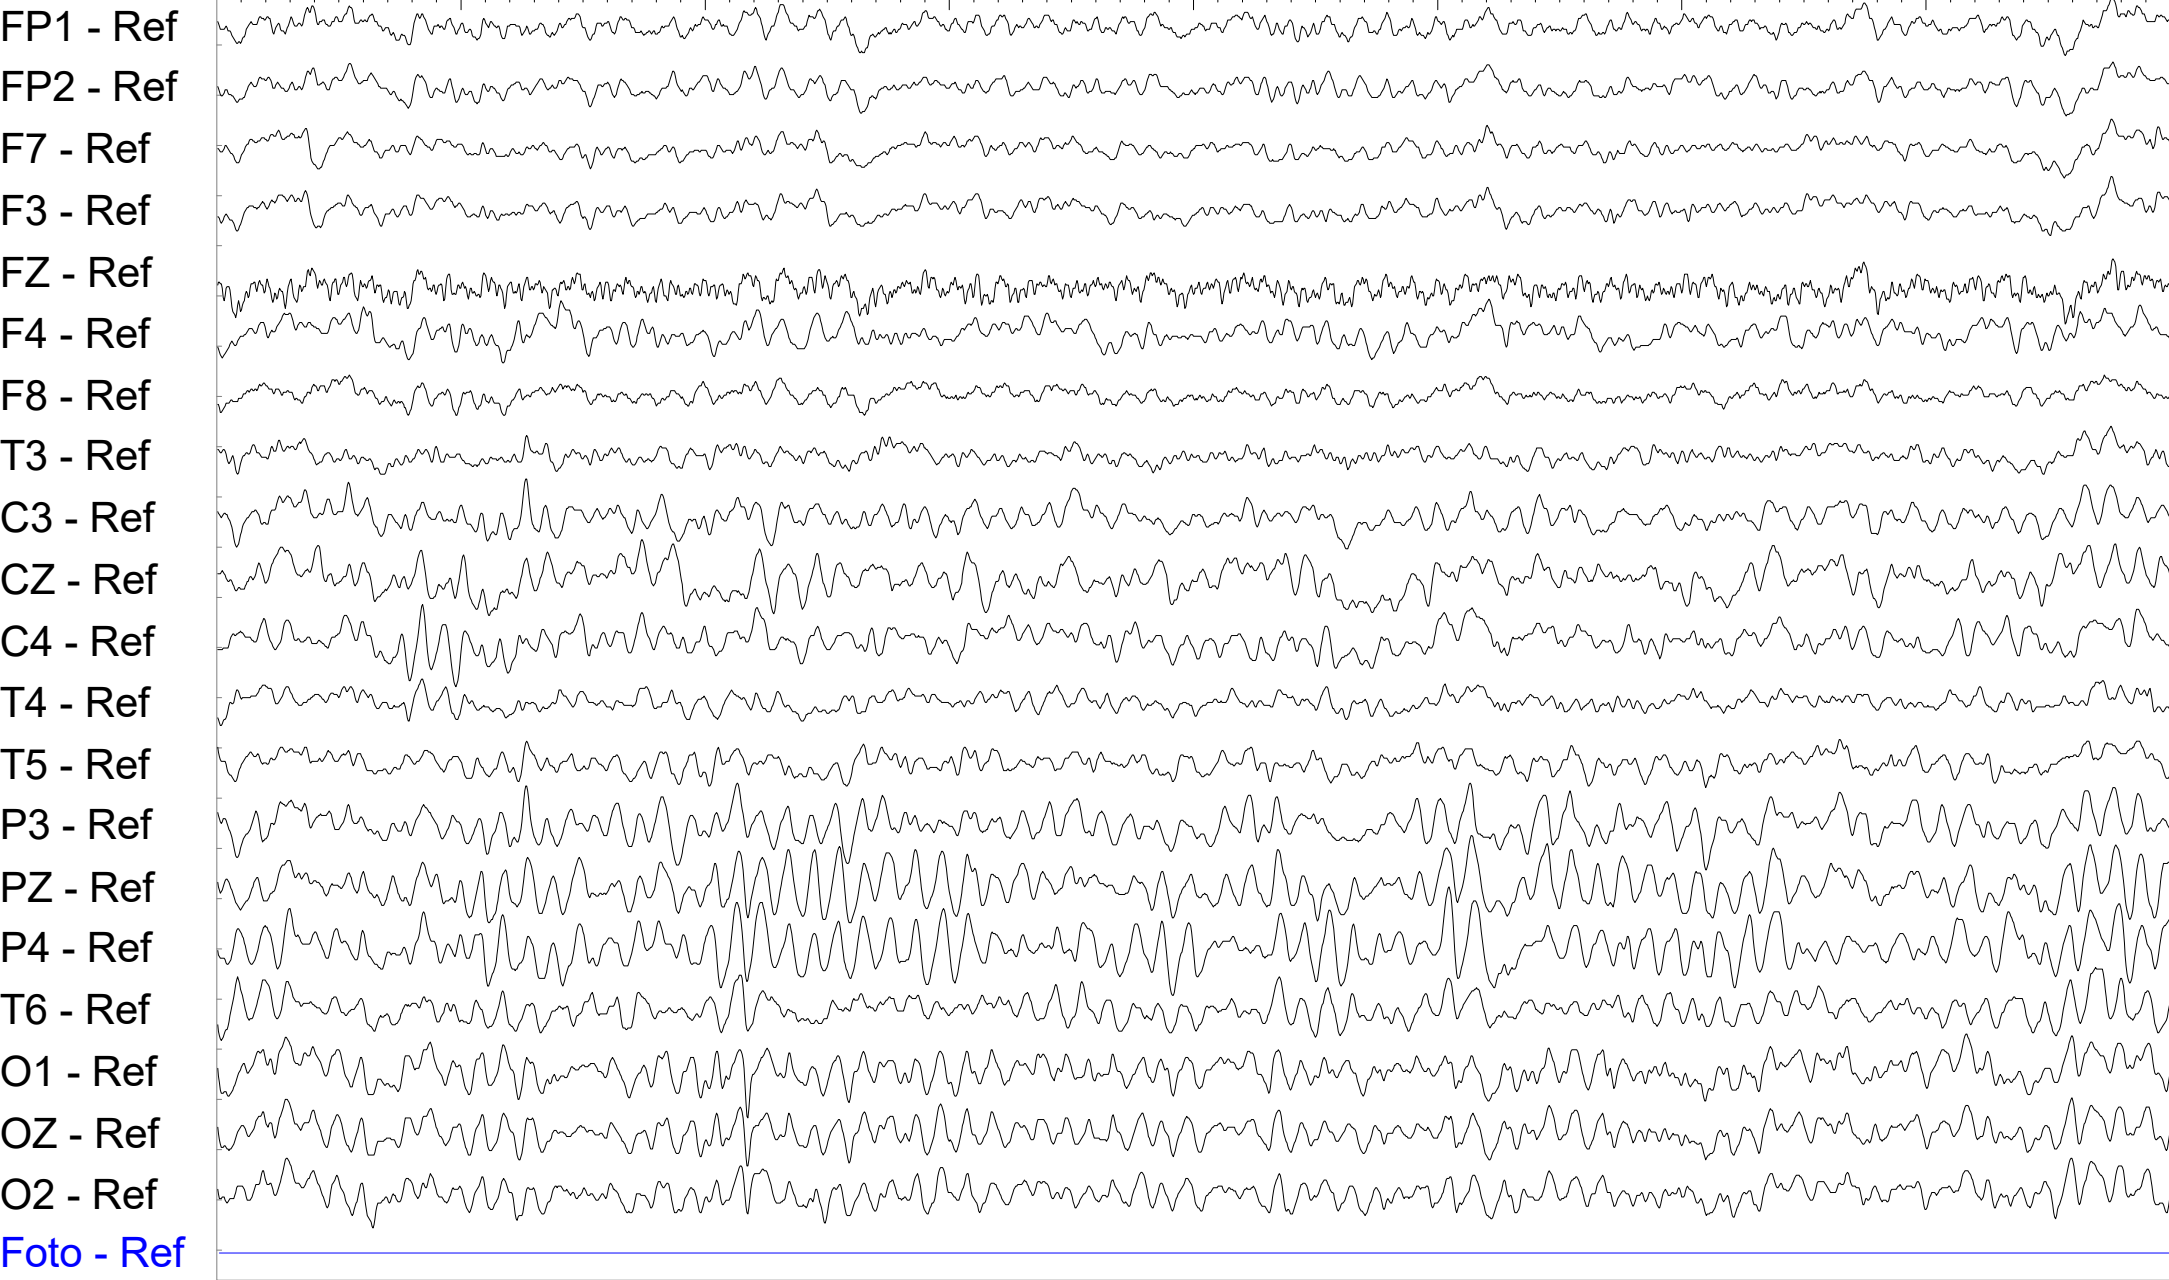



16:02:49 Vigília 16:02:50 Vigília 16:02:51 Vigília 16:02:52 Vigília 16:02:53 Vigília 16:02:54 Vigília 16:02:55 Vigília 16:02:56 Vigília

Época: 12 - Horário: 16:02:50 - Estágio: 0 (8 seg.)

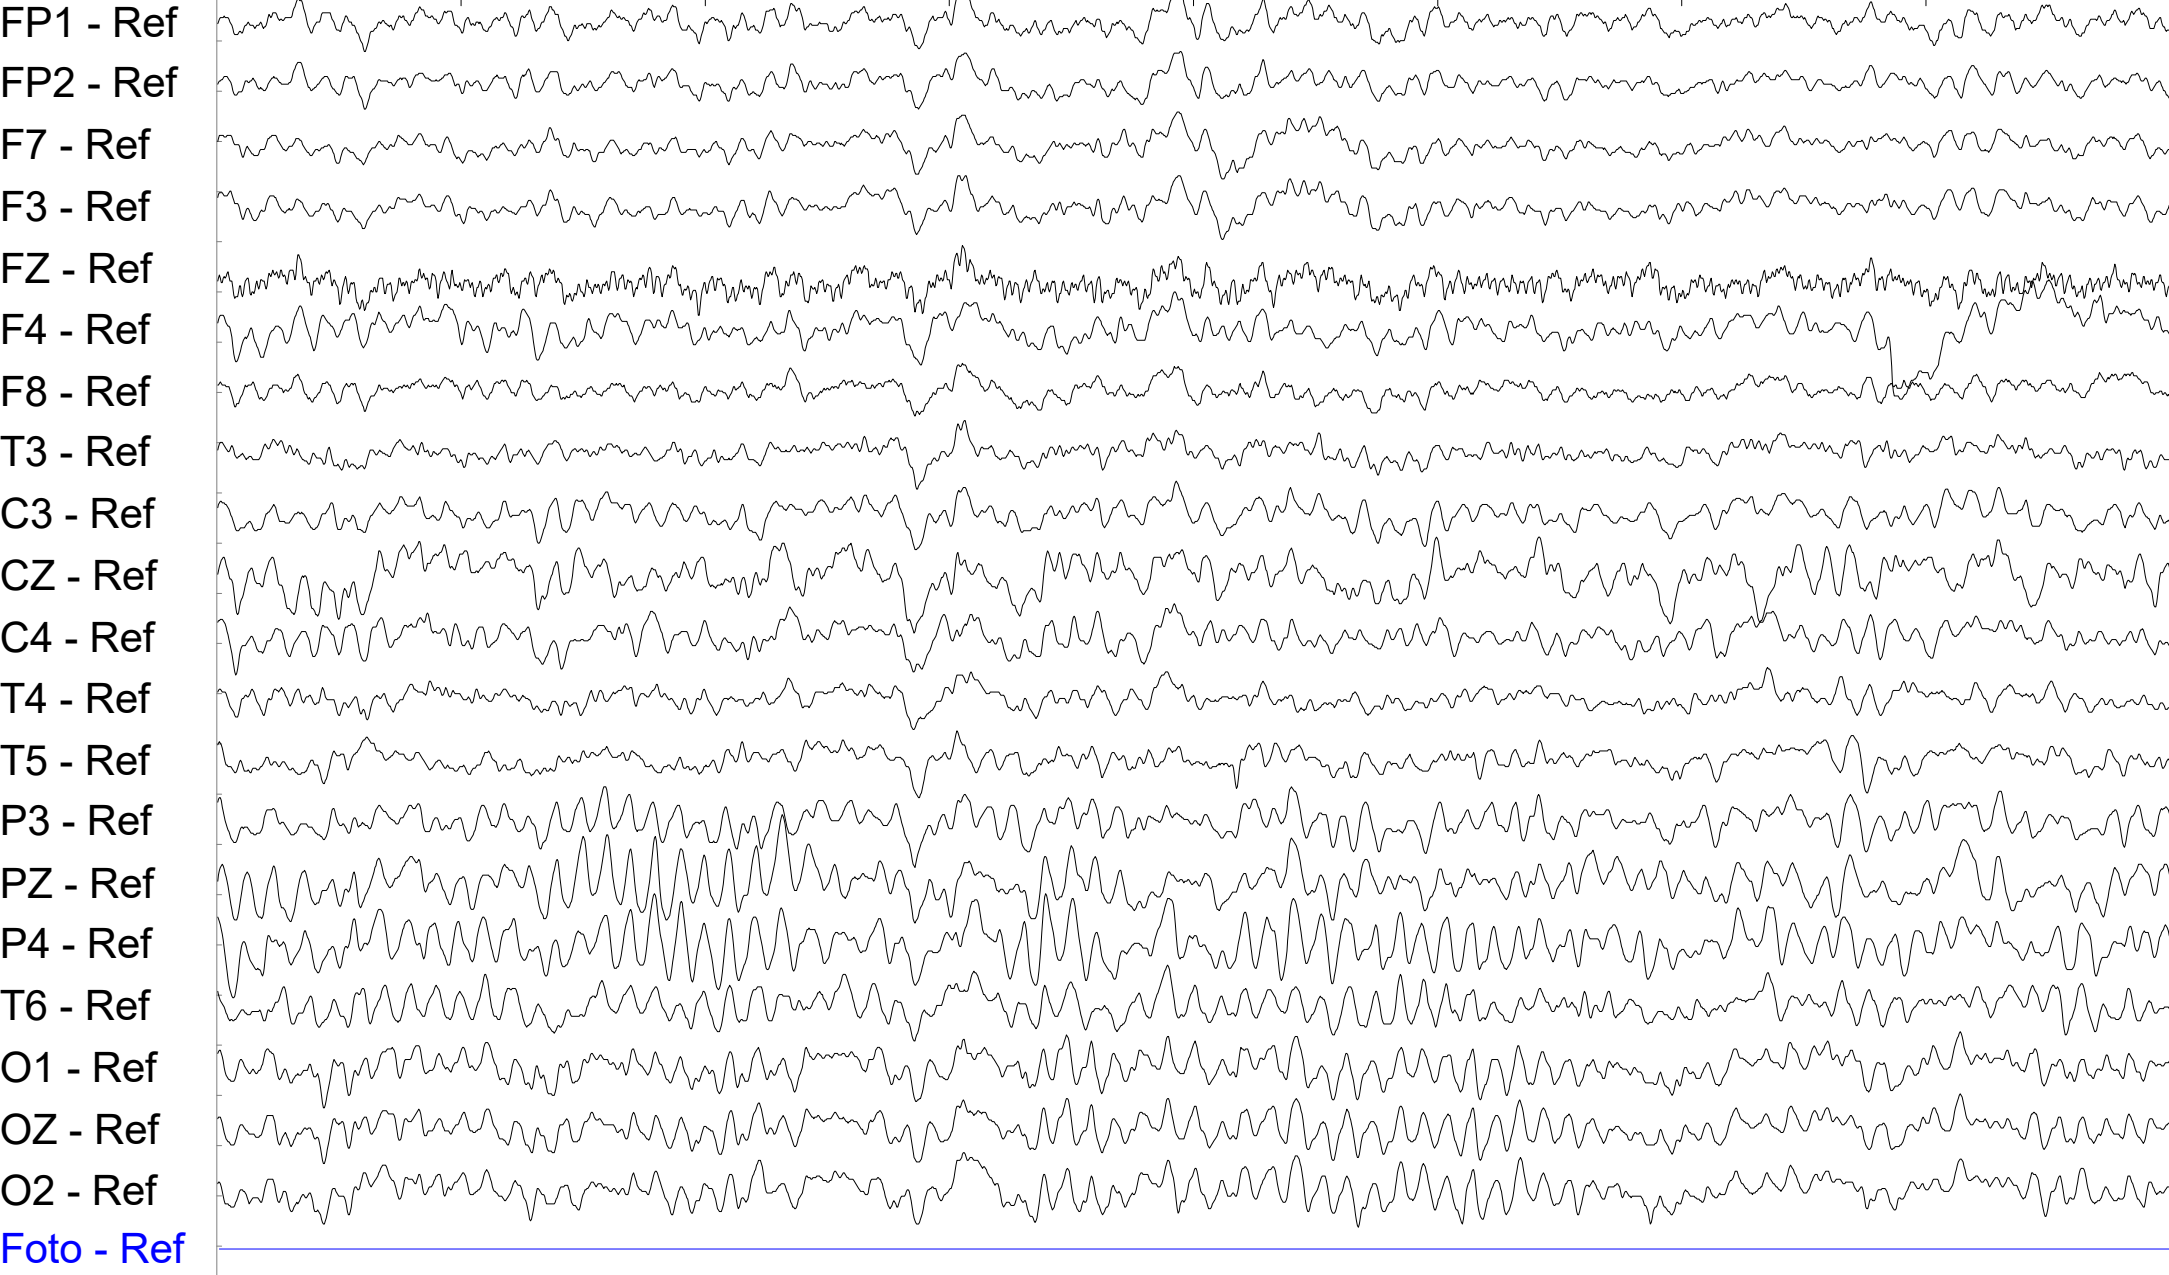

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 13/20

16:03:19

Vigília

16:03:20

Vigília

16:03:21

Vigília

16:03:22

Vigília

16:03:23

Vigília

16:03:24

Vigília


16:03:25

Vigília

16:03:26

Vigília


Época: 13 - Horário: 16:03:20 - Estágio: 0 (8 seg.)

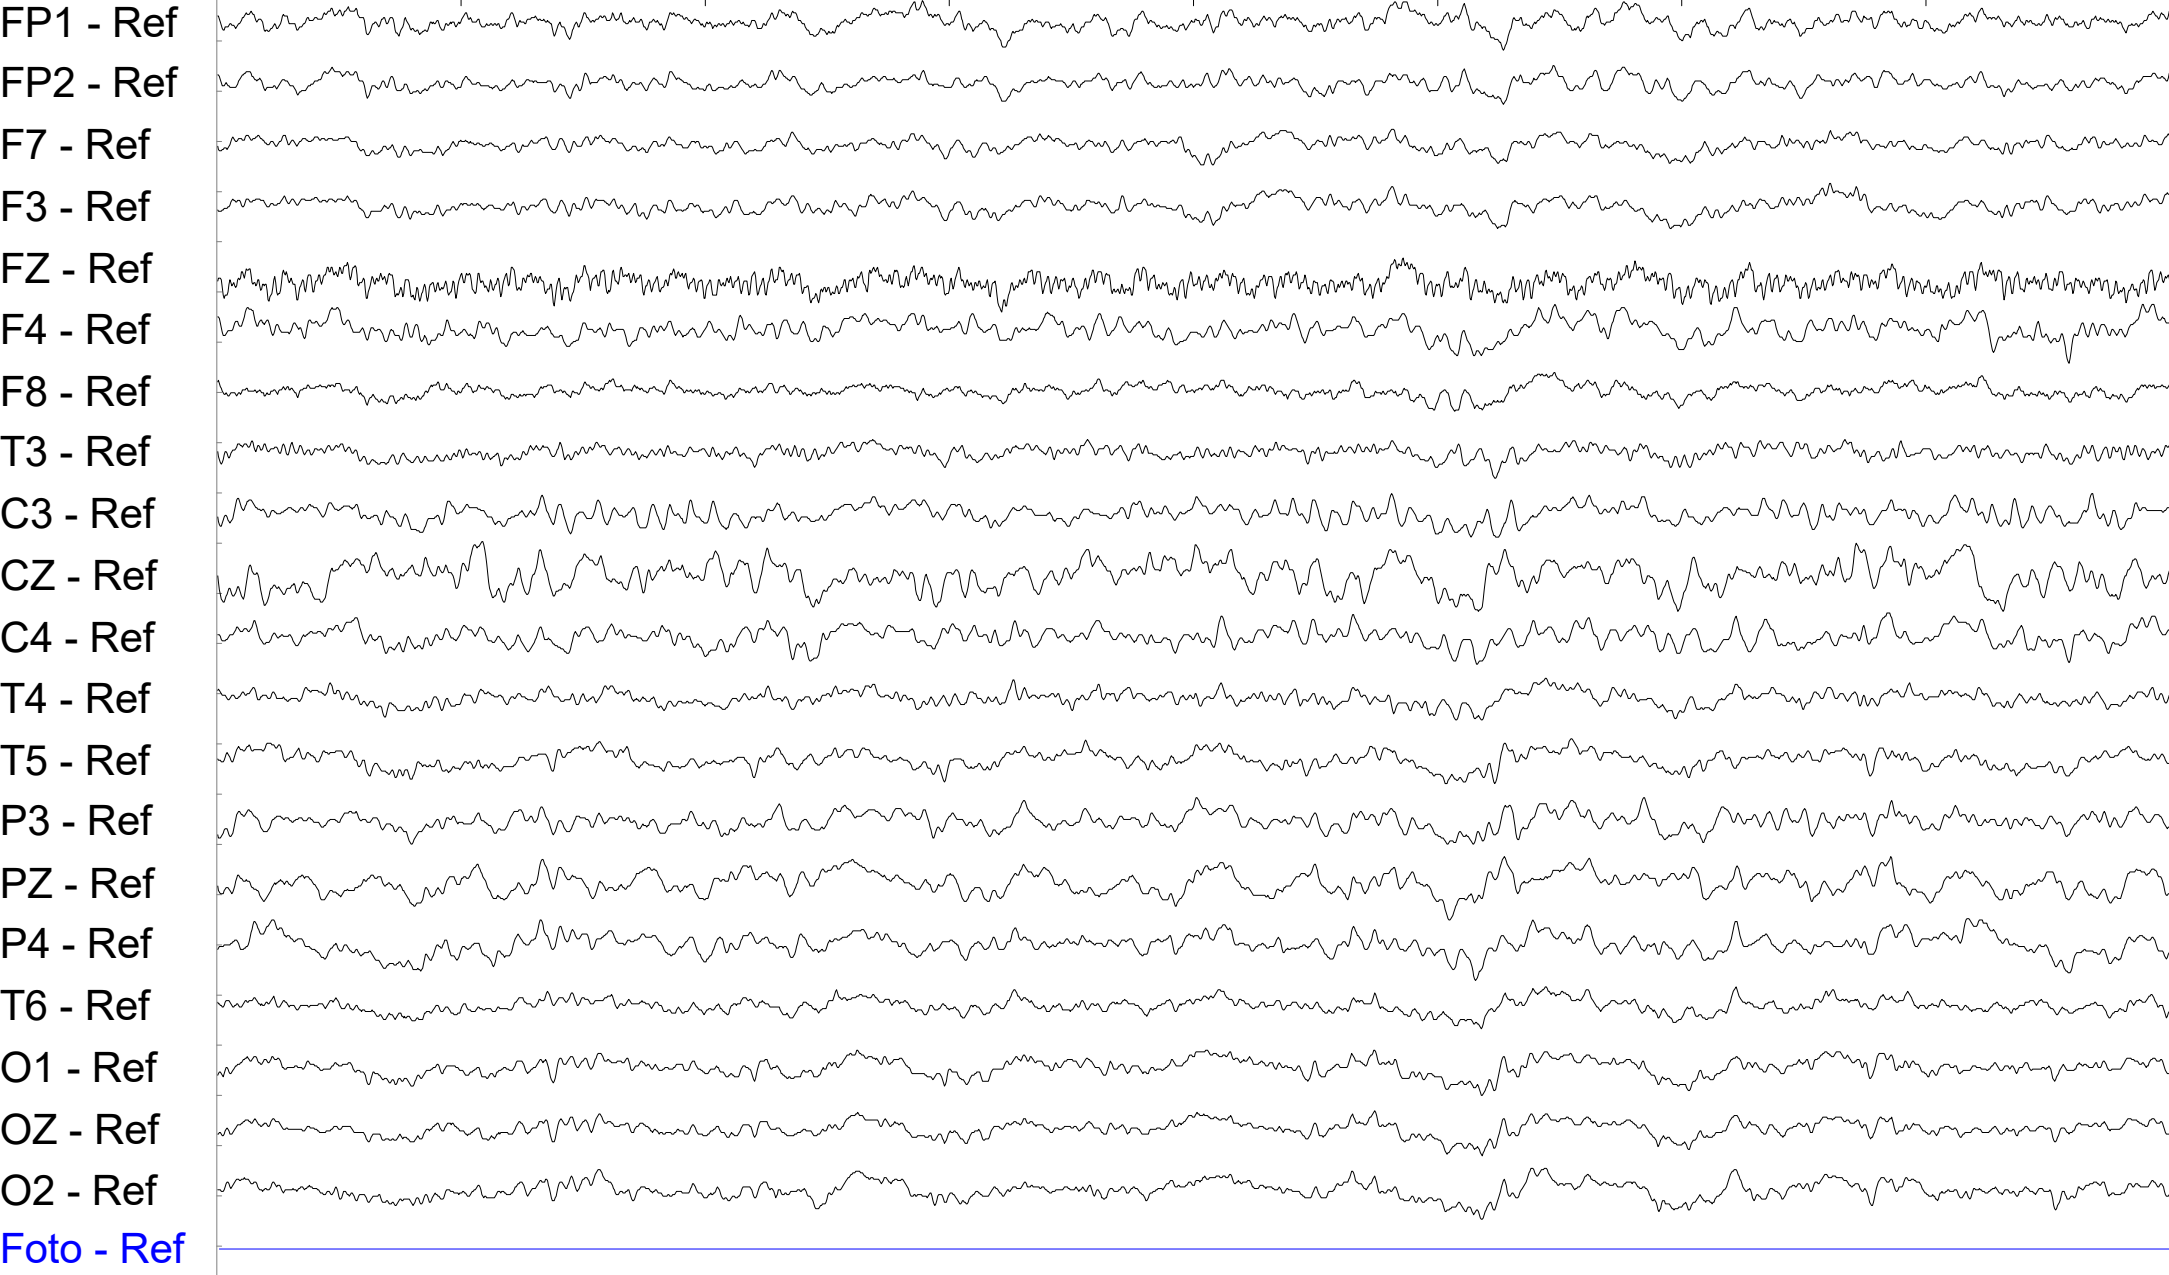

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

16:04:19 Foto Estimulação 16:04:20 Foto Estimulação 16:04:21 Foto Estimulação 16:04:22 Foto Estimulação 16:04:23 Foto Estimulação 16:04:24 Foto Estimulação 16:04:25 Foto Estimulação 16:04:26 Foto Estimulação
Época: 15 - Horário: 16:04:20 - Estágio: 0 (8 seg.)

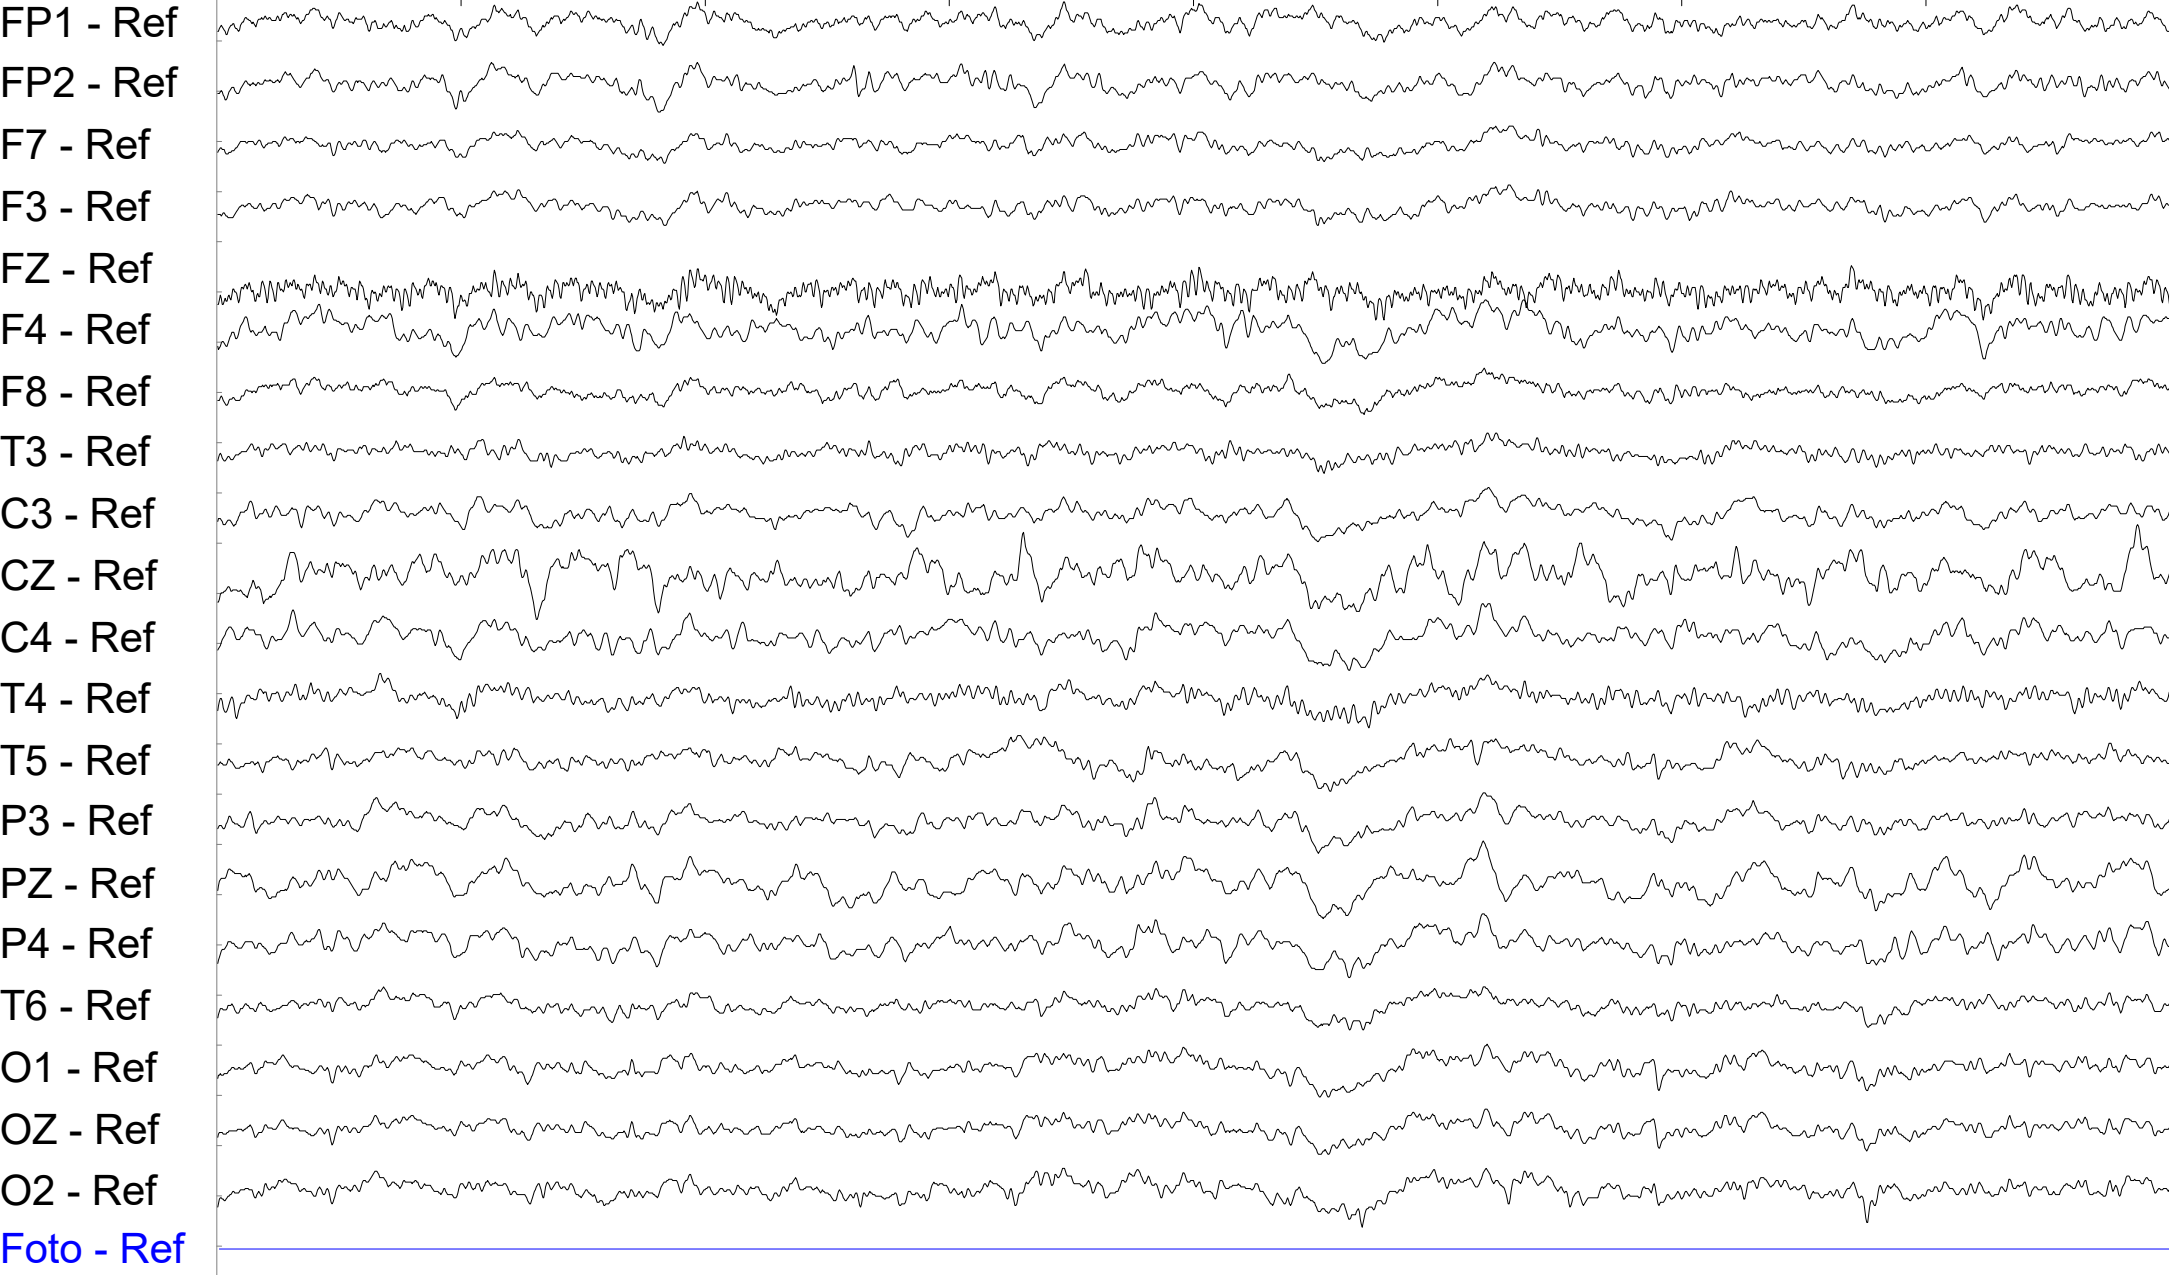


NEUROCLINIC


Informe o nome do médico

Pág. 17/20

16:05:19 Olhos fechados 16:05:20 Olhos fechados 16:05:21 Olhos fechados 16:05:22 Olhos fechados 16:05:23 Olhos fechados 16:05:24 Olhos fechados 16:05:25 Olhos fechados 16:05:26 Olhos fechados

Época: 17 - Horário: 16:05:20 - Estágio: 0 (8 seg.)

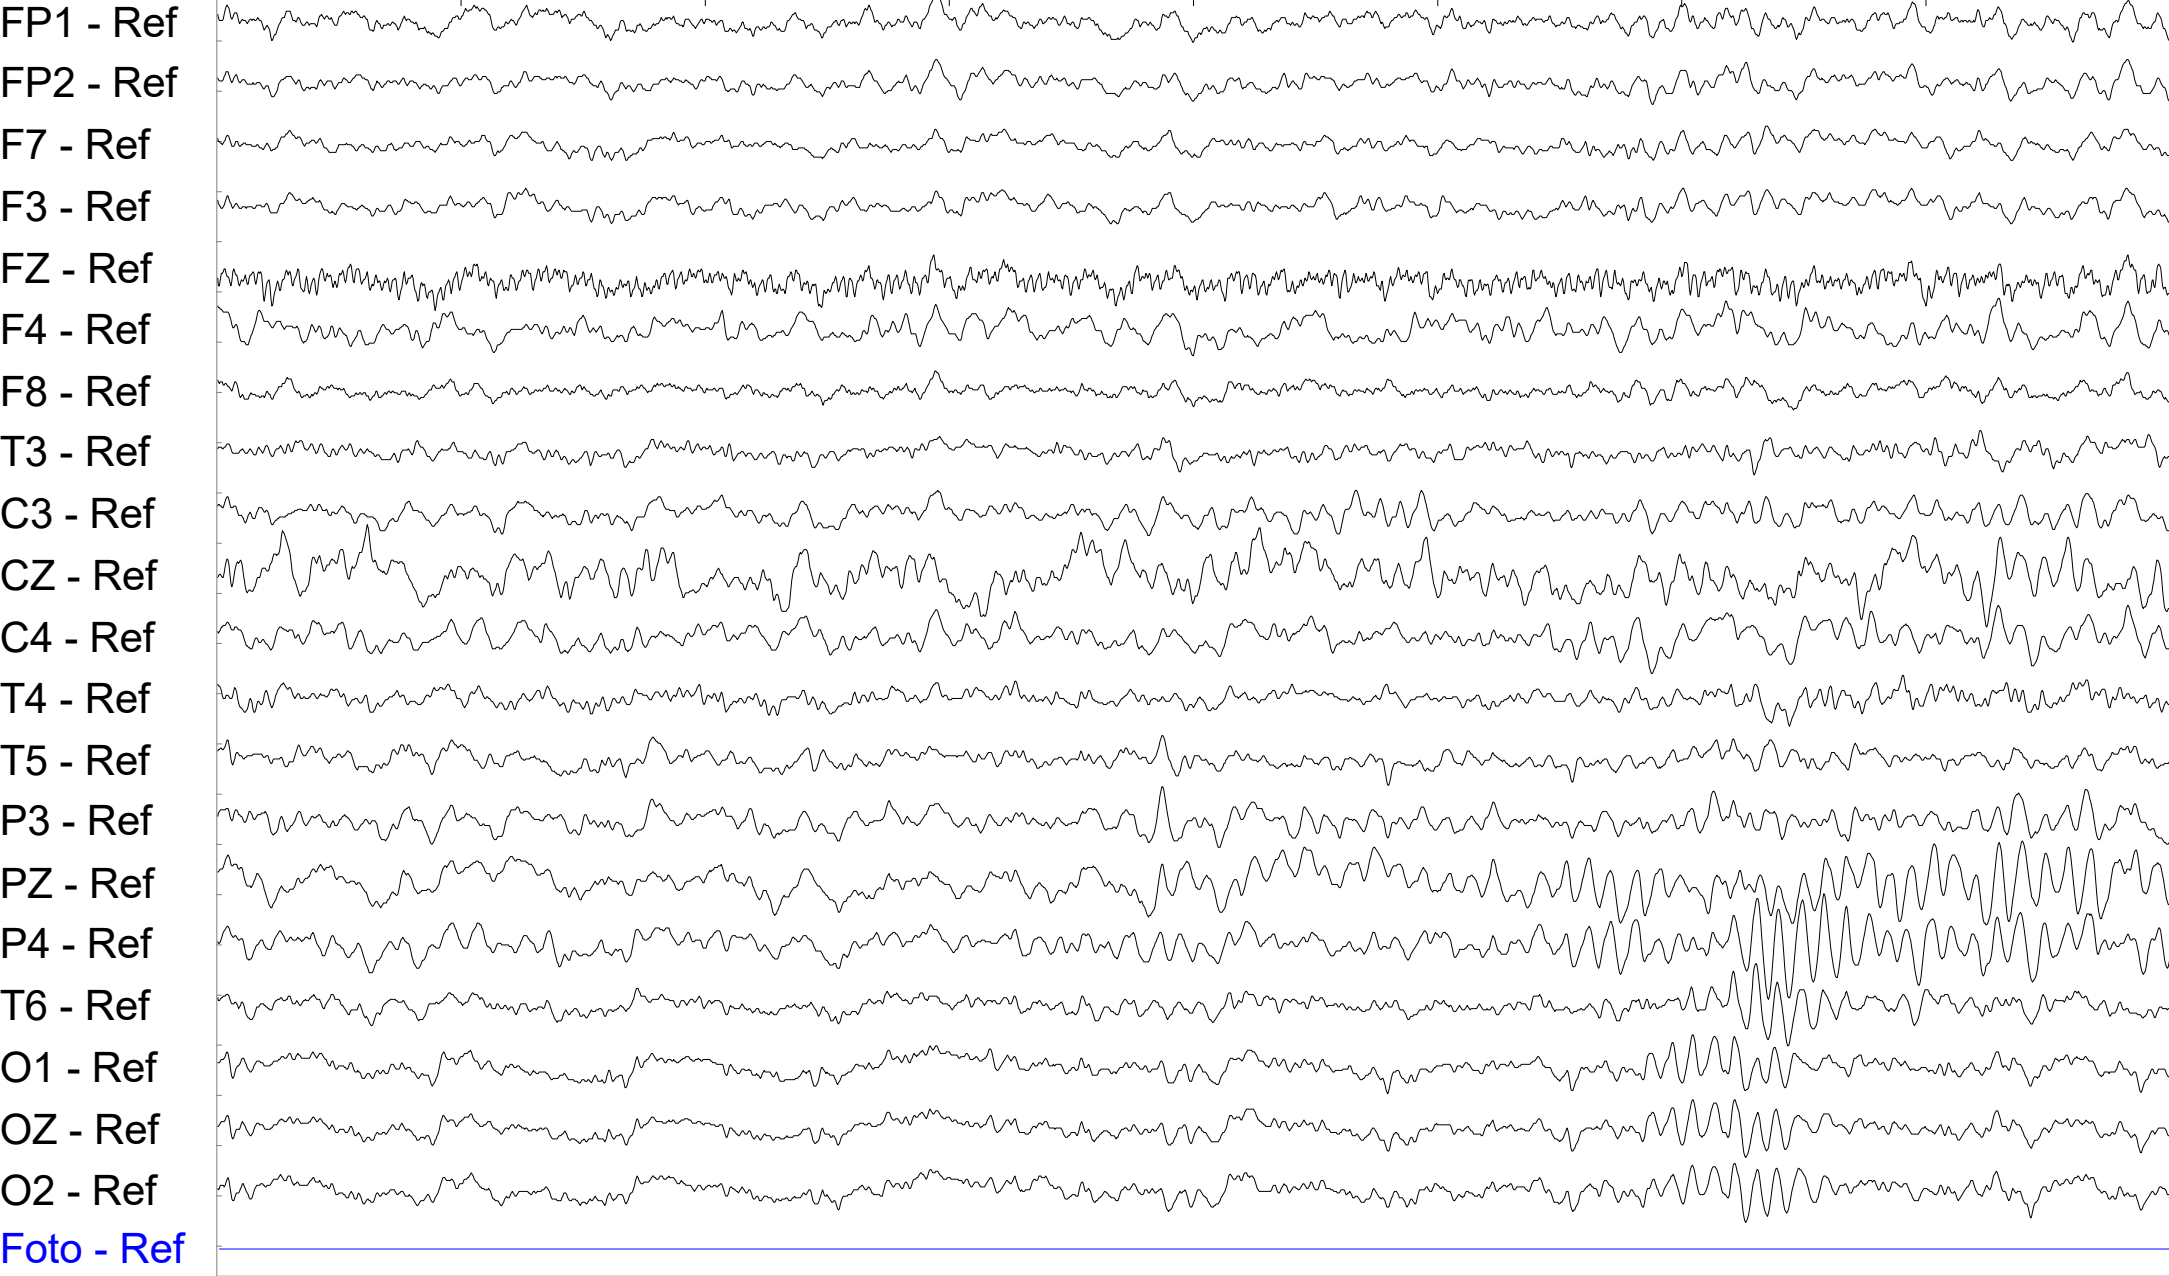



16:05:49

Vigília

16:05:50

Vigília

16:05:51

Vigília

16:05:52

Vigília

16:05:53

Vigília

16:05:54

Vigília


16:05:55


Vigília

16:05:56

Vigília


Época: 18 - Horário: 16:05:50 - Estágio: 0 (8 seg.)

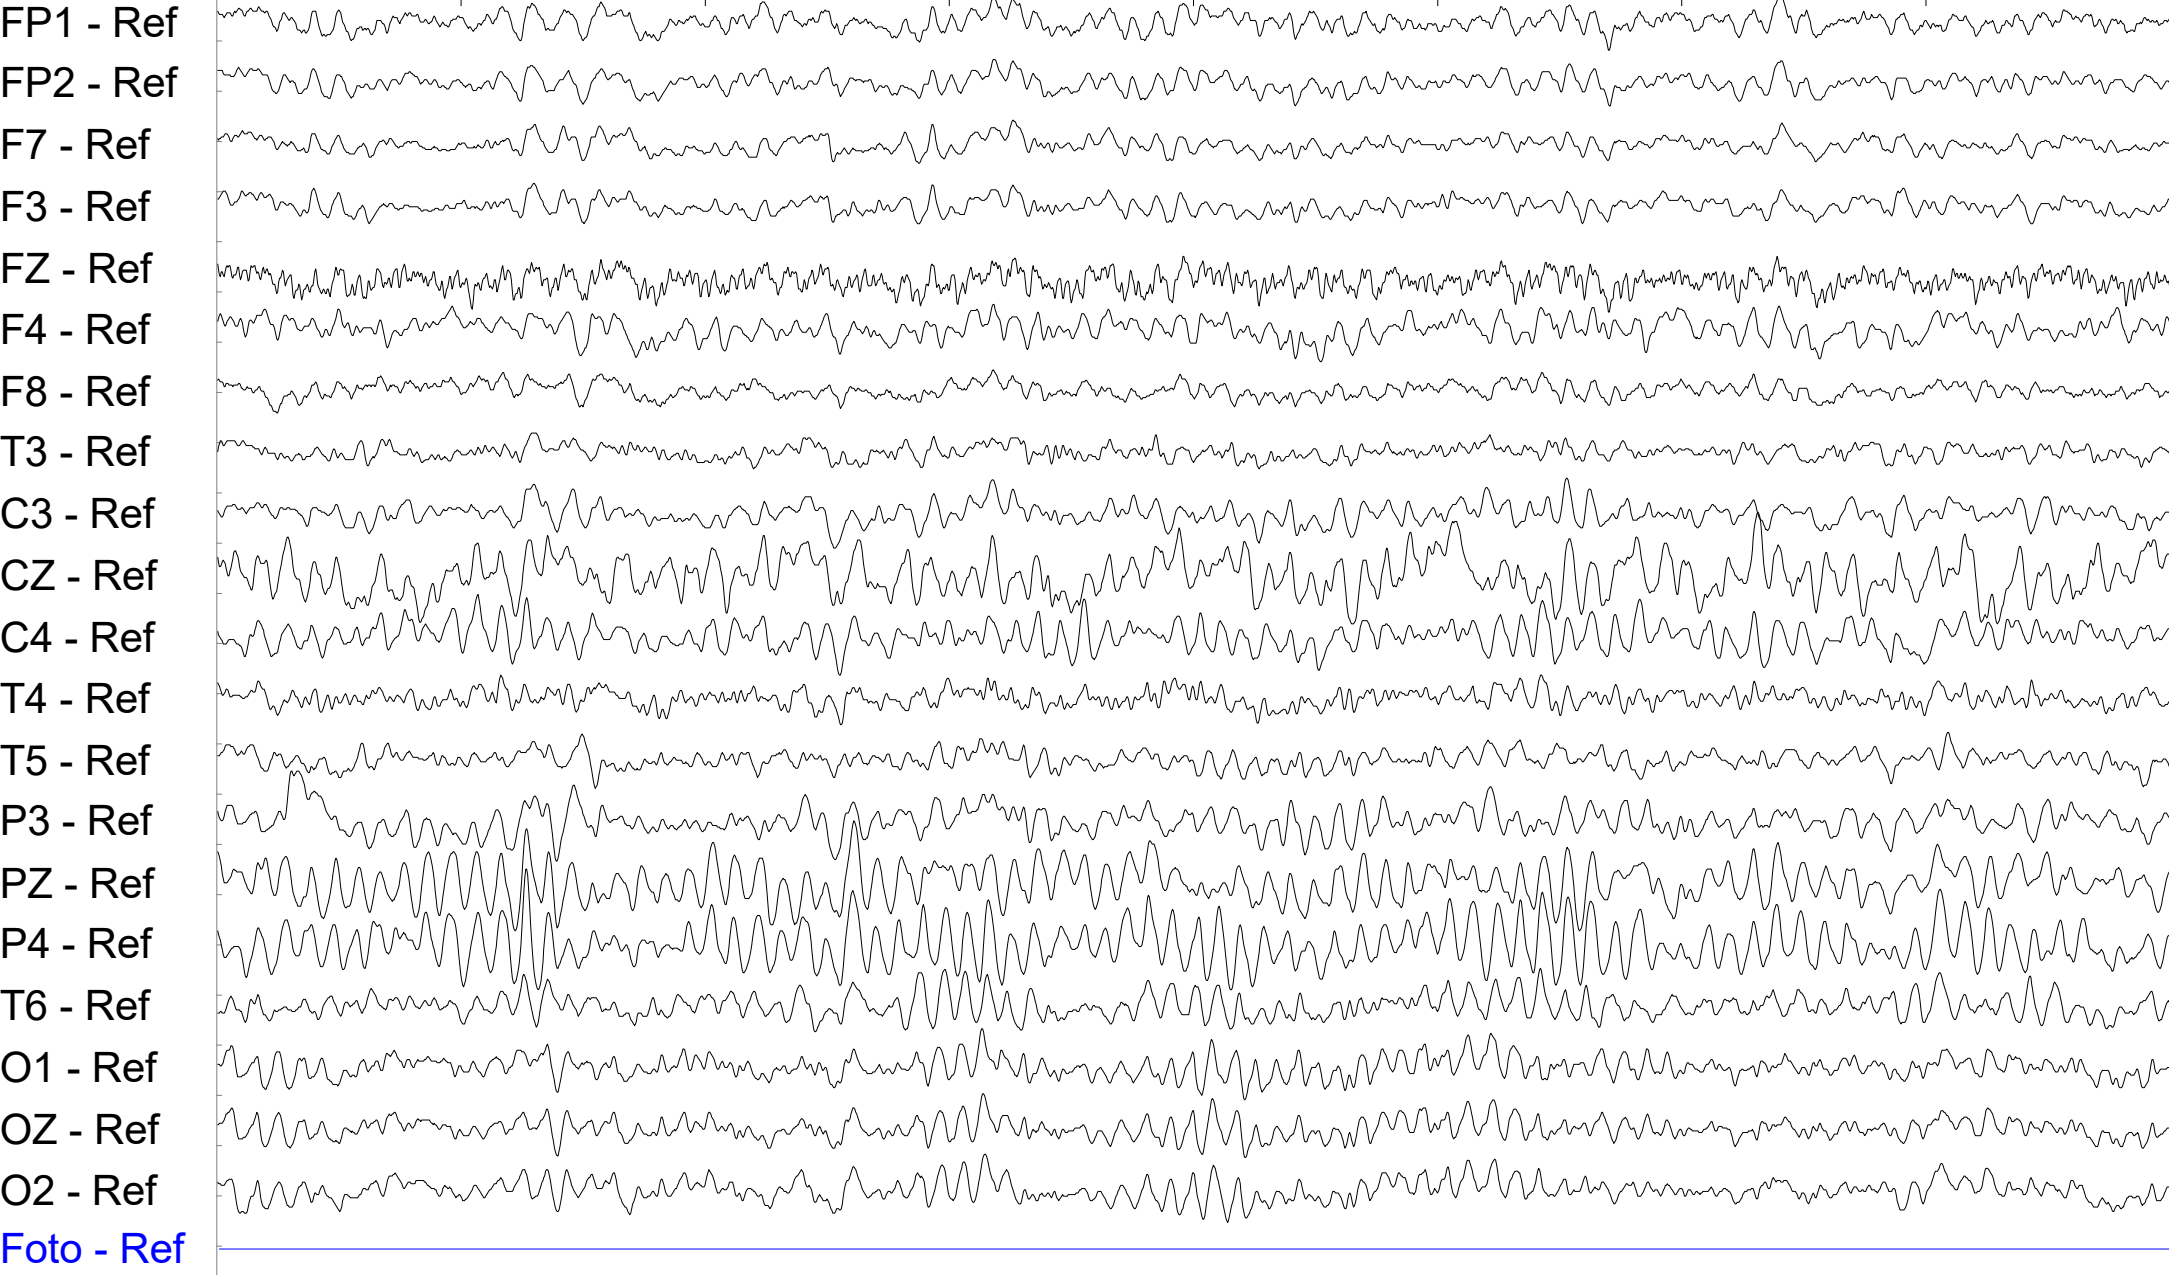





16:06:49 Vigília 16:06:50 Vigília 16:06:51 Vigília 16:06:52 Vigília 16:06:53 Vigília 16:06:54 Vigília 16:06:55 Vigília 16:06:56 Vigília

Época: 20 - Horário: 16:06:50 - Estágio: 0 (8 seg.)

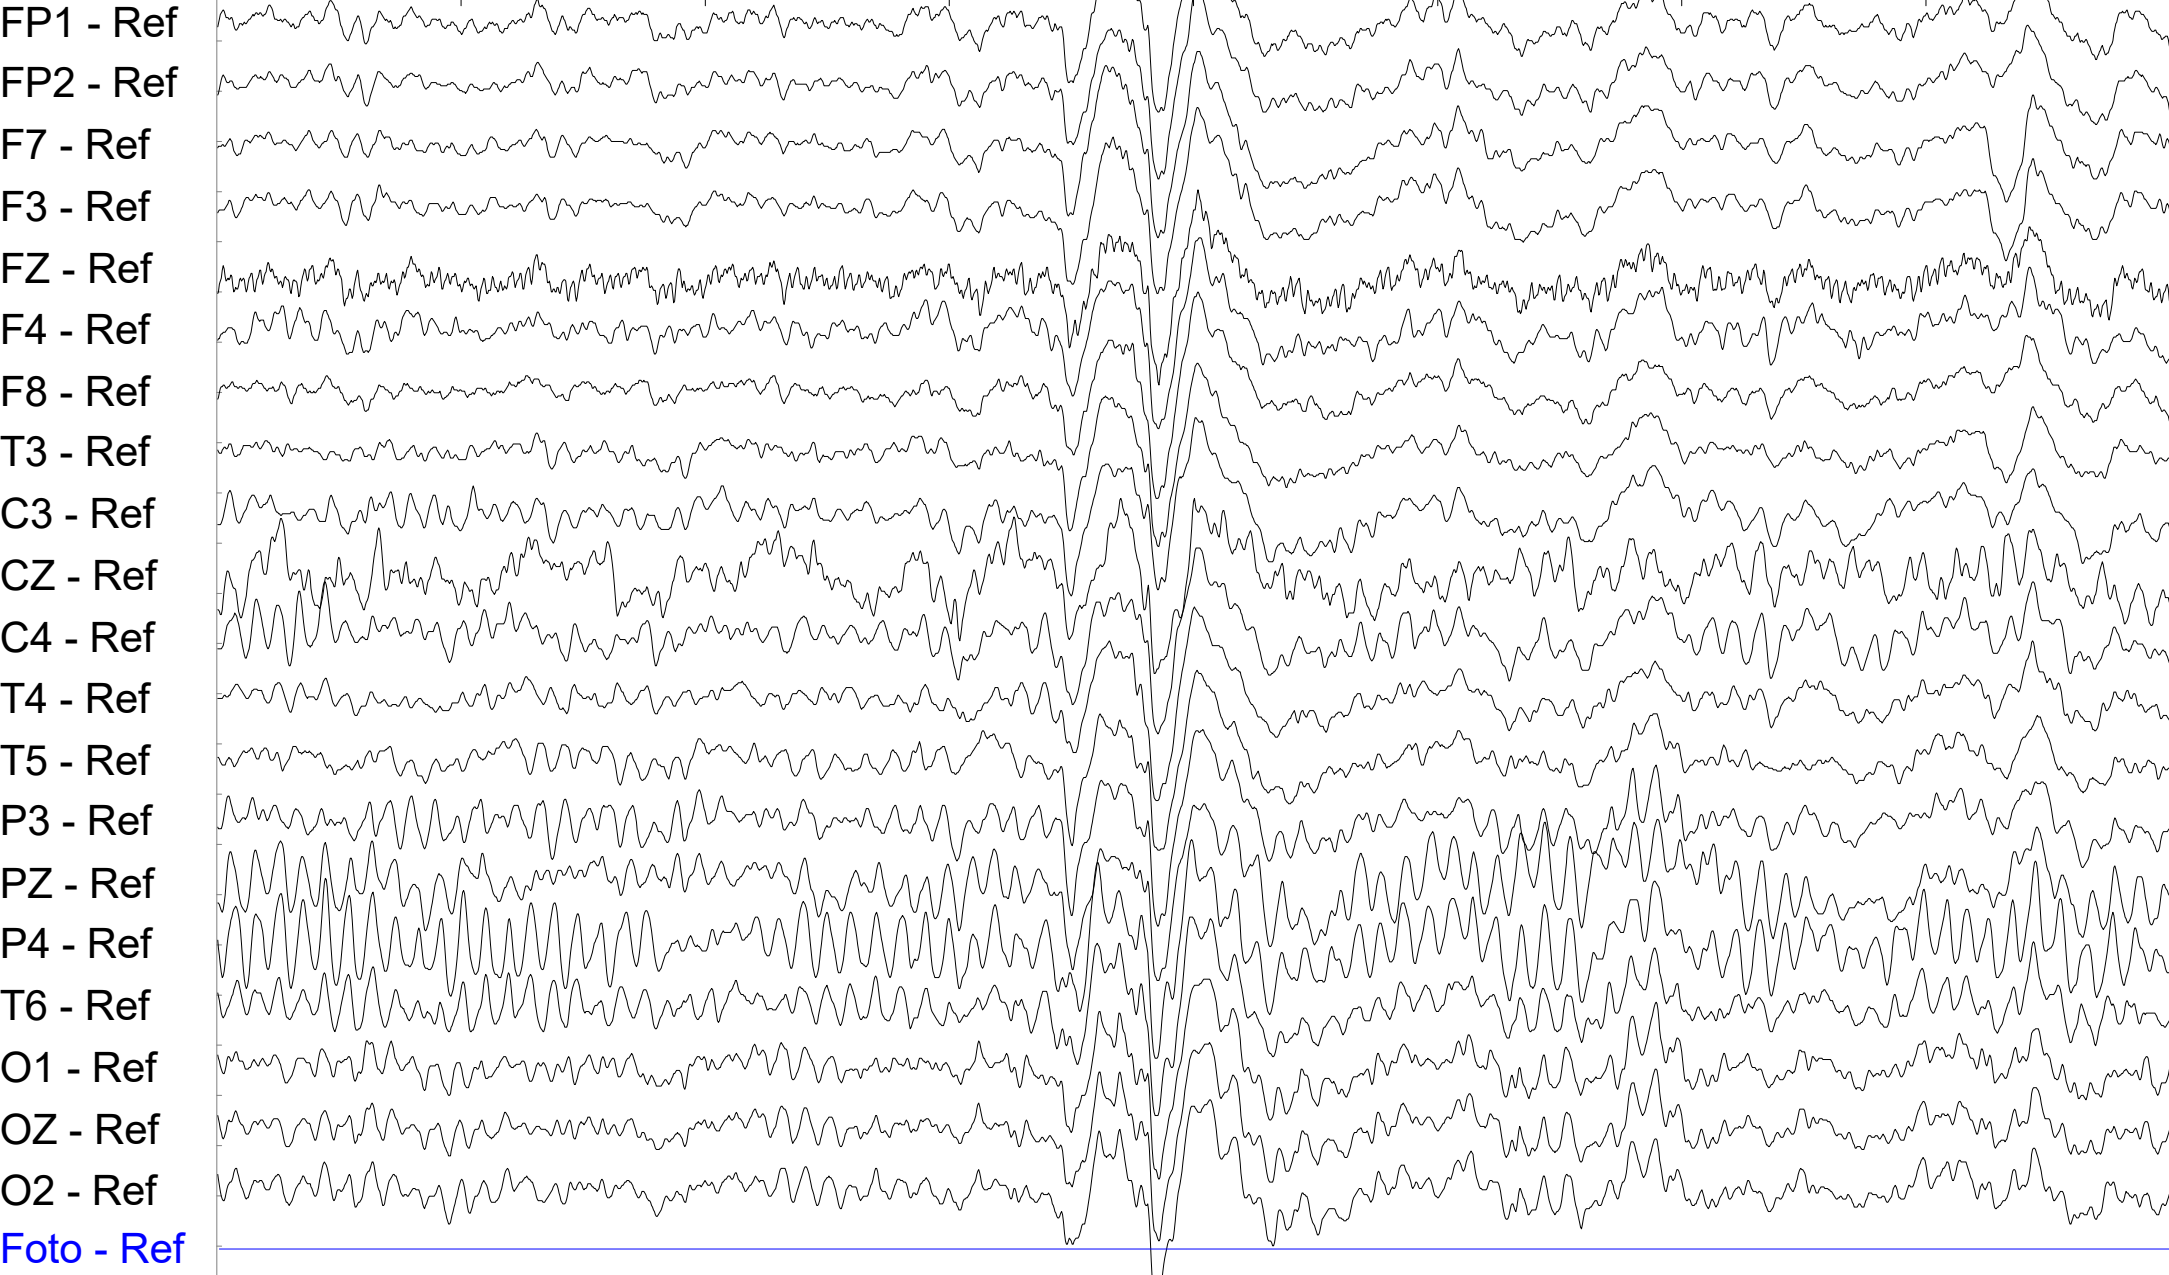




16:07:16 16:07:17 16:07:18 16:07:19 16:07:20 16:07:21 16:07:22 16:07:23
Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília Vigília
Época: 20 - Horário: 16:07:17 - Estágio: 0 (8 seg.)

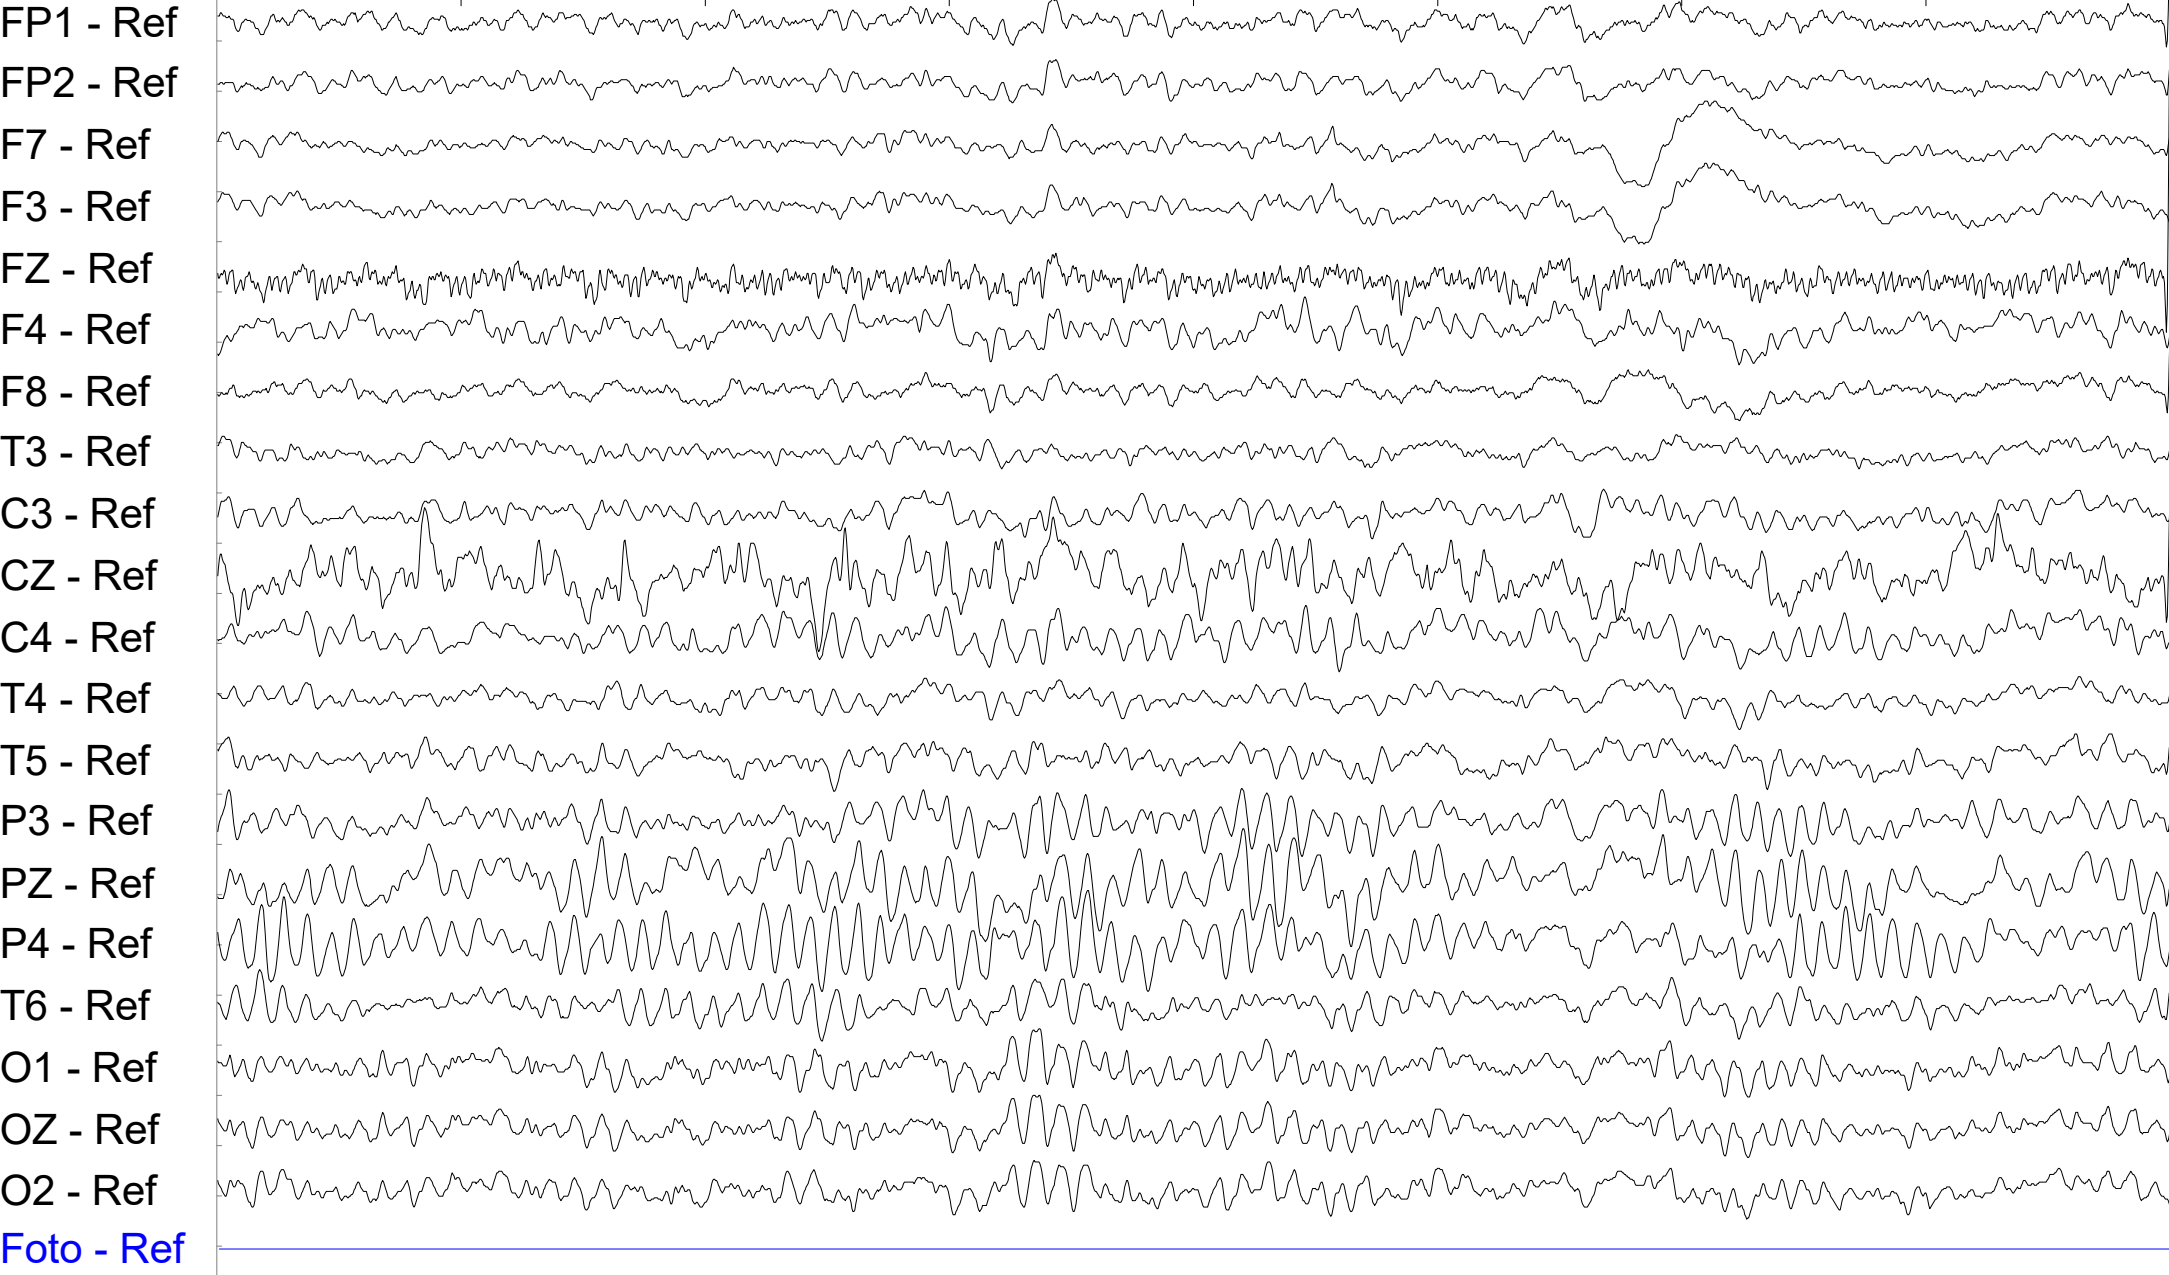

NEUROCLINIC


Informe o nome do médico


16:04:16 Foto Estimulação 16:04:17 Foto Estimulação 16:04:18 Foto Estimulação 16:04:19 Foto Estimulação 16:04:20 Foto Estimulação 16:04:21 Foto Estimulação 16:04:22 Foto Estimulação 16:04:23 Foto Estimulação
Época: 14 - Horário: 16:04:17 - Estágio: 0 (8 seg.)

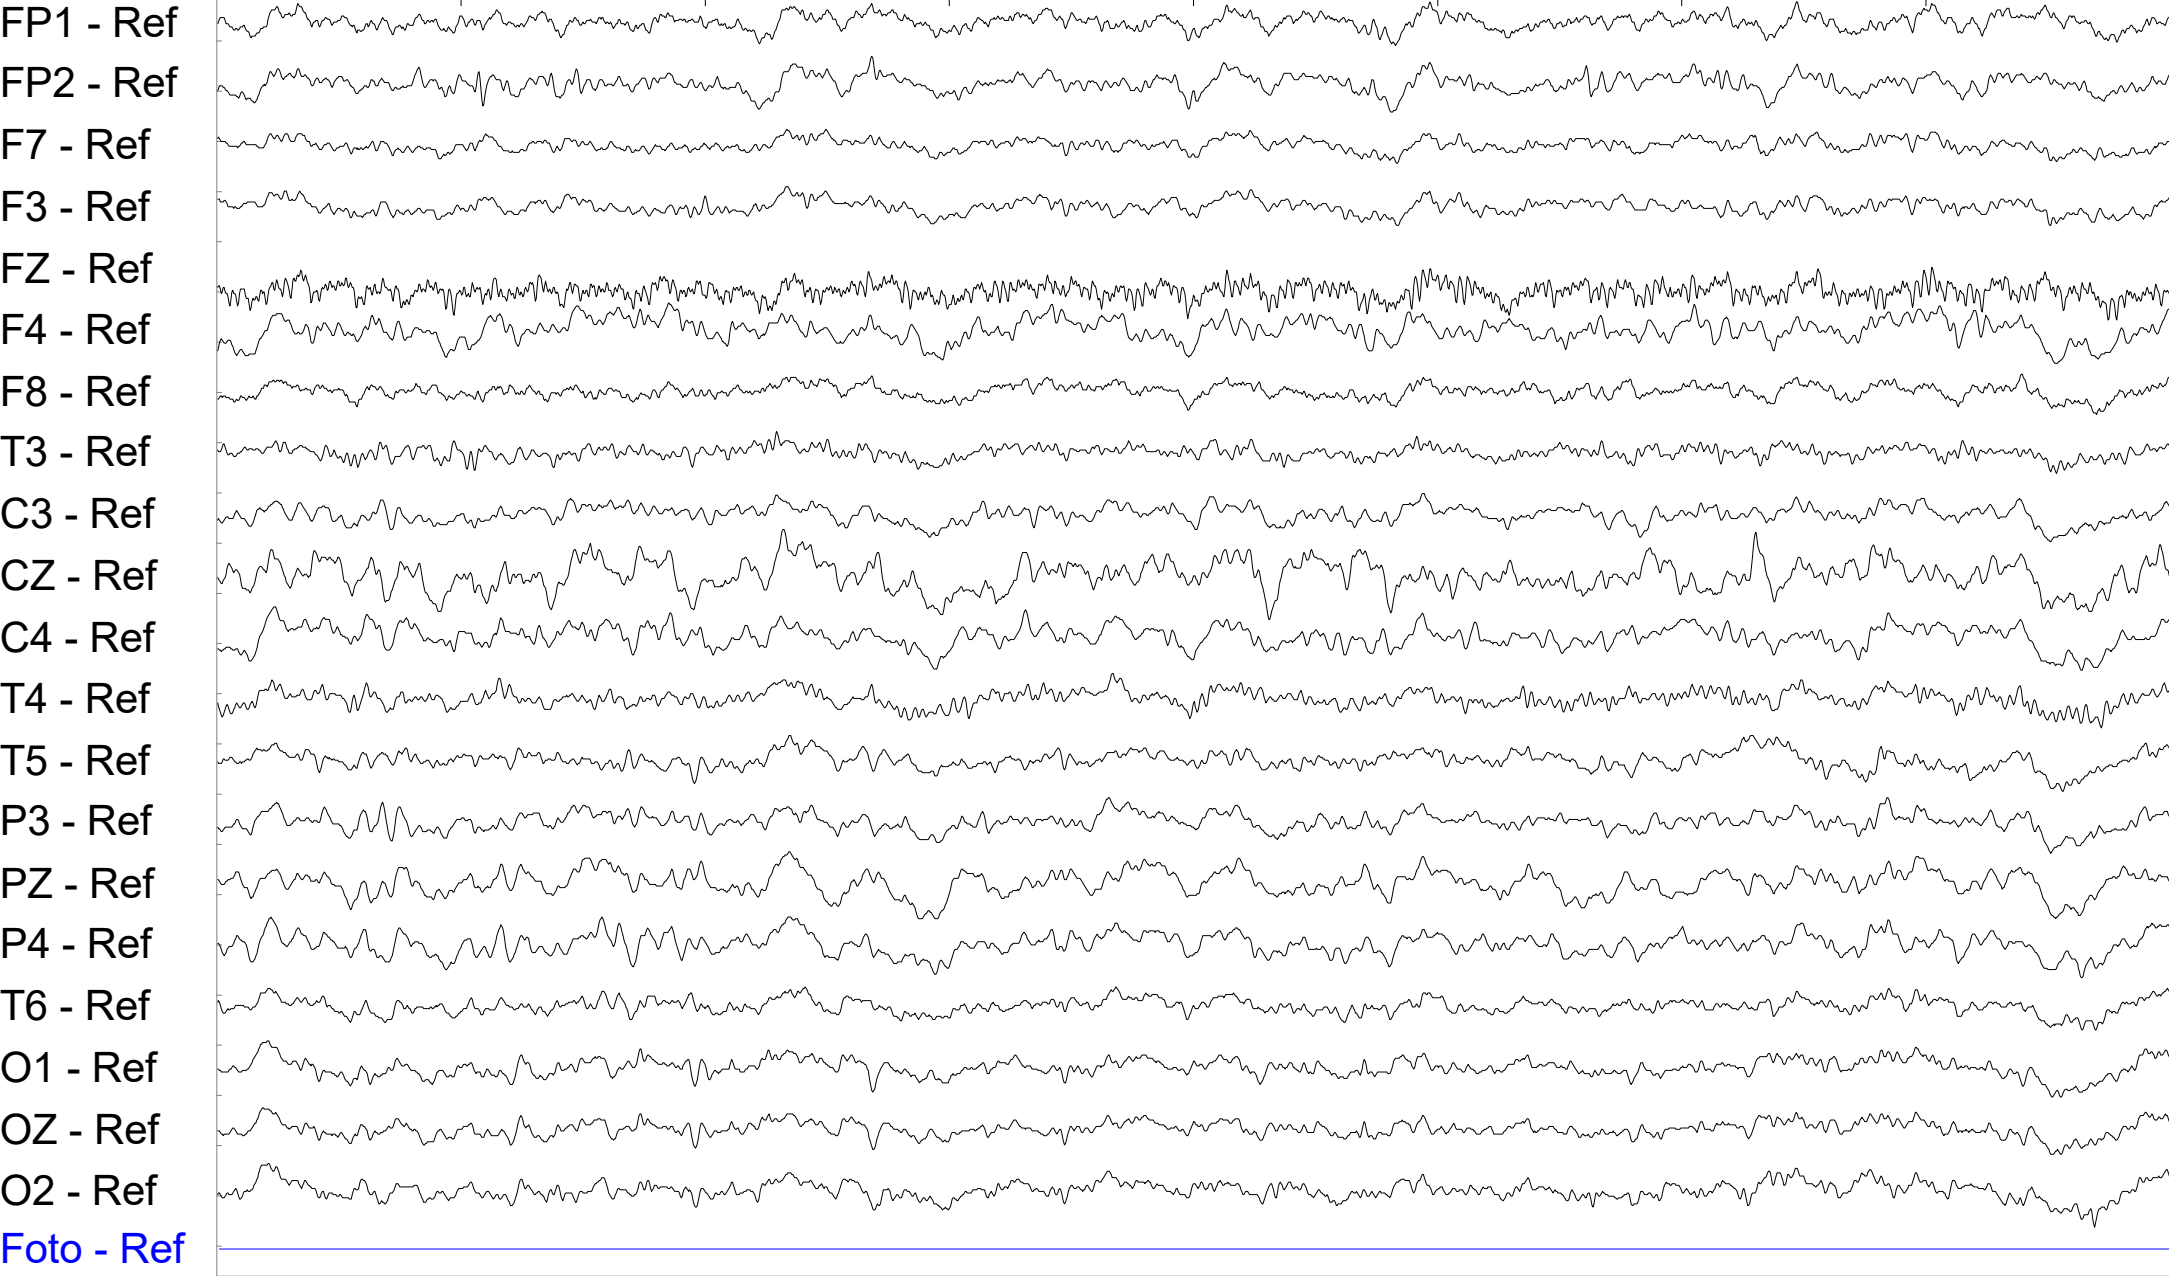

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

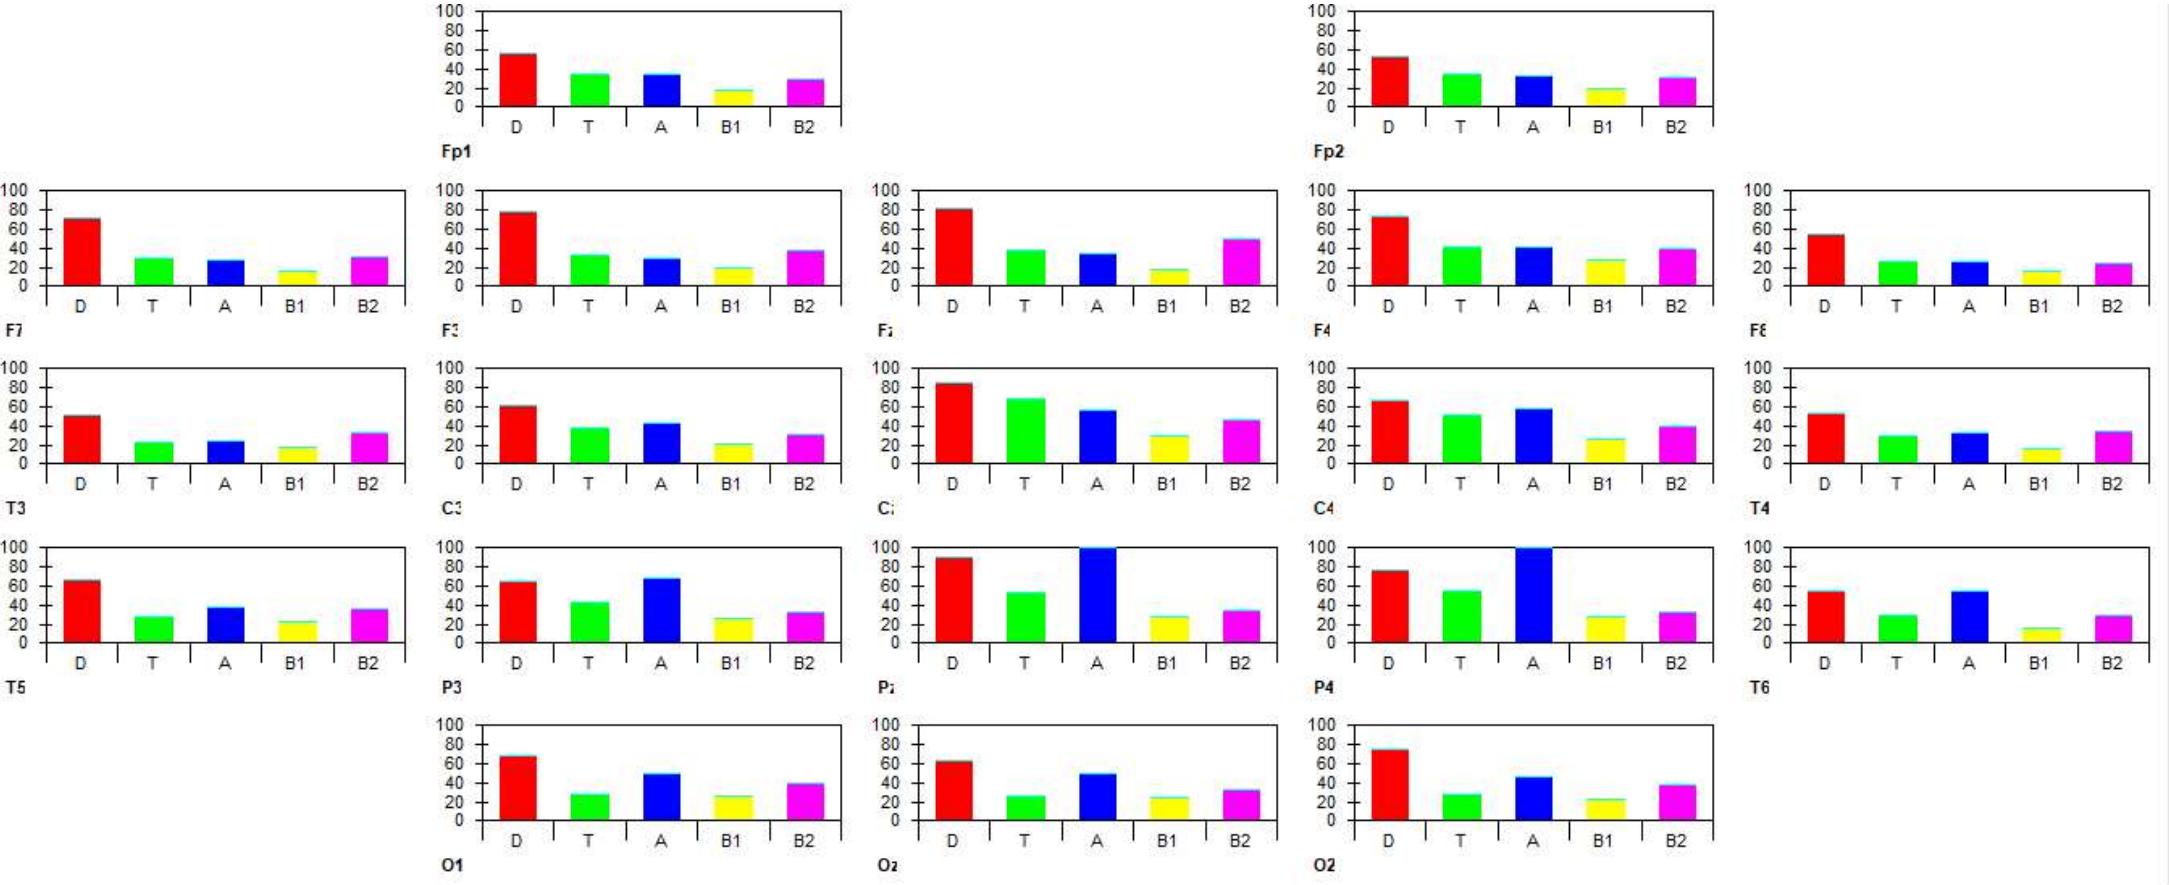

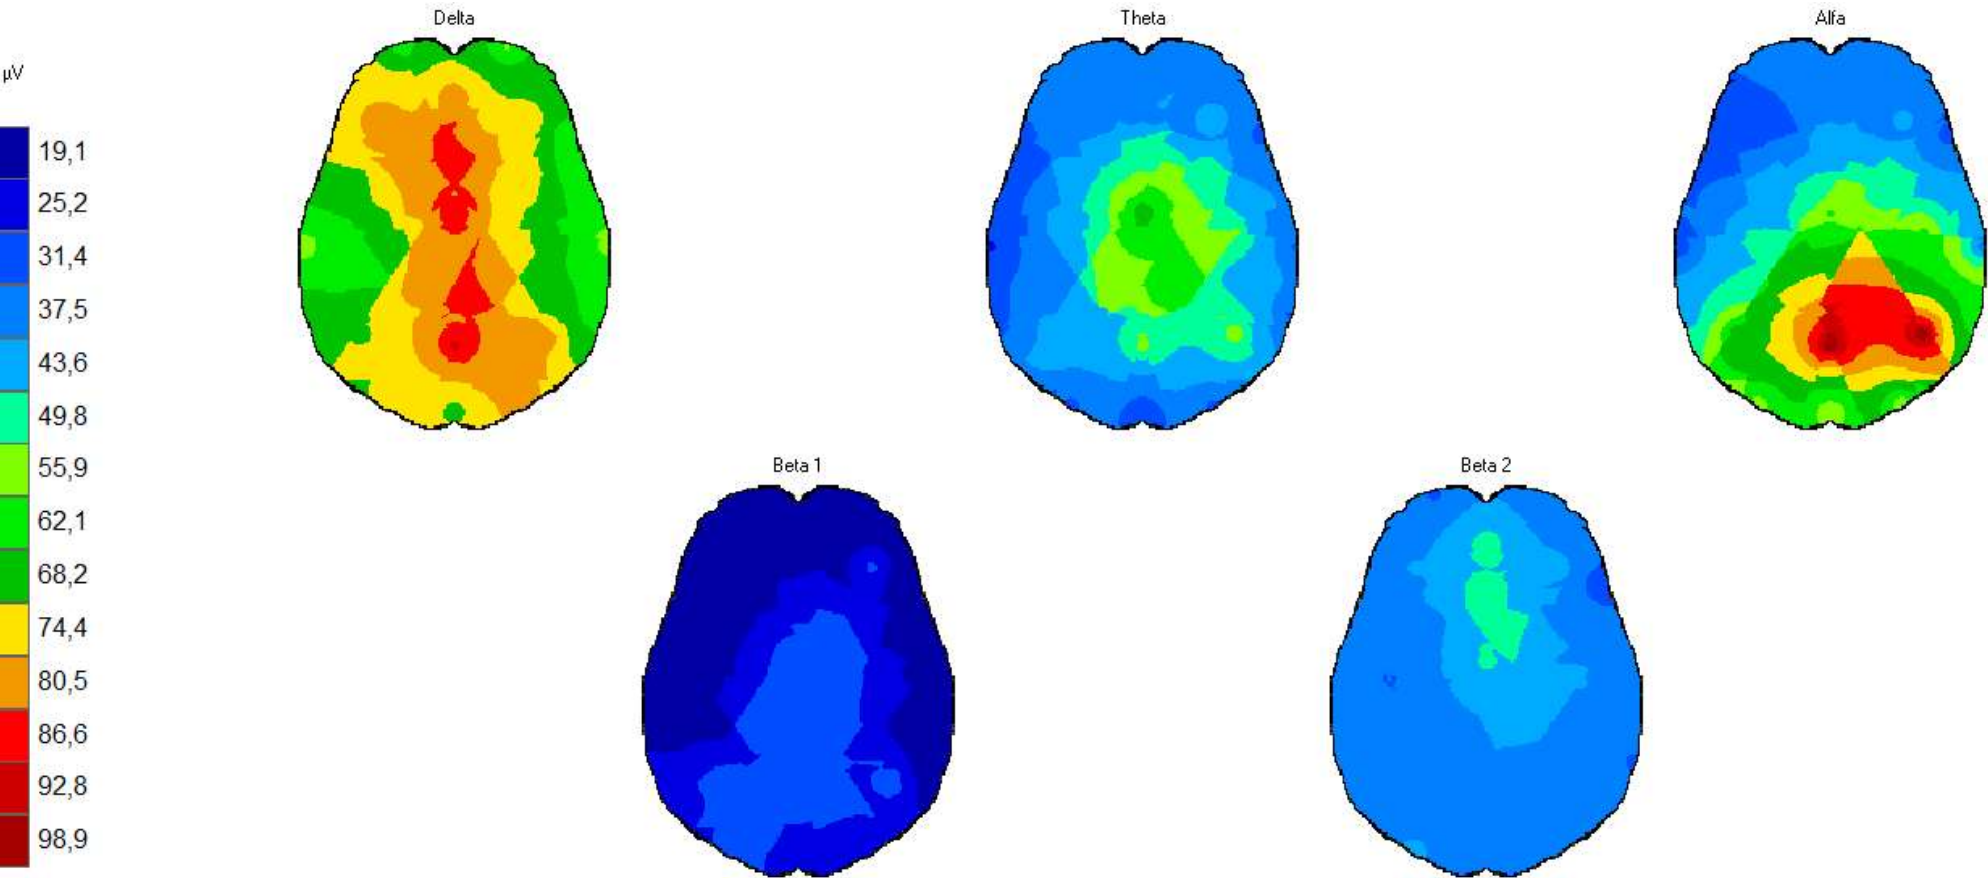

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	56,9	32,7
T	4,0	35,3	20,3
A	10,0	34,5	19,9
B1	14,5	18,1	10,4
B2	20,5	29,1	16,7

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	54,0	31,6
T	4,0	34,4	20,1
A	9,5	33,1	19,3
B1	14,5	18,7	10,9
B2	22,0	30,8	16,0

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	71,7	40,7
T	4,5	29,5	16,7
A	9,5	27,9	15,6
B1	17,5	15,7	8,9
B2	21,0	31,2	17,6

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	78,9	39,8
T	4,0	33,3	16,8
A	9,5	29,1	14,7
B1	13,0	19,0	9,6
B2	21,0	38,0	19,2

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	81,7	36,9
T	4,0	37,5	16,9
A	10,0	33,9	15,3
B1	17,0	18,2	8,2
B2	27,5	50,1	22,6

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	74,4	33,1
T	4,0	41,7	18,6
A	8,0	41,0	18,2
B1	17,0	27,3	12,1
B2	23,0	40,3	17,9

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	55,1	37,2
T	4,0	26,7	18,1
A	8,0	25,9	17,5
B1	15,0	15,7	10,7
B2	22,0	24,4	16,5

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	50,9	34,3
T	4,5	23,2	15,7
A	9,0	24,4	16,4
B1	13,5	17,0	11,4
B2	18,5	32,8	22,2

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	61,5	31,9
T	5,0	37,6	19,5
A	10,0	42,5	22,0
B1	13,0	20,9	10,8
B2	19,0	30,6	15,8

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	86,2	30,0
T	5,0	68,0	23,7
A	8,5	56,9	19,8
B1	13,0	30,3	10,5
B2	19,5	45,7	15,9

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	66,3	27,4
T	5,0	51,5	21,3
A	9,0	59,0	24,4
B1	13,0	25,5	10,6
B2	18,5	39,1	16,2

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	53,0	32,0
T	4,0	29,9	18,1
A	9,0	32,3	19,5
B1	13,0	15,7	9,5
B2	22,0	34,8	20,9

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	67,0	34,9
T	5,0	27,8	14,5
A	9,5	38,2	19,9
B1	13,0	22,7	11,8
B2	19,5	36,1	18,8

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	65,8	27,7
T	8,5	43,8	18,5
A	10,0	68,6	28,9
B1	13,0	25,4	10,7
B2	19,5	33,5	14,1

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,5	89,7	29,2
T	7,0	53,6	17,5
A	10,0	101,6	33,1
B1	13,0	27,4	8,9
B2	20,5	34,7	11,3

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	76,7	26,1
T	7,0	54,8	18,7
A	10,0	100,8	34,4
B1	13,0	27,7	9,4
B2	19,0	33,3	11,4

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	55,5	29,8
T	7,5	29,2	15,7
A	10,0	55,1	29,6
B1	13,0	16,5	8,9
B2	20,0	30,0	16,1

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	69,2	32,4
T	6,5	28,4	13,3
A	10,0	50,7	23,7
B1	13,0	25,5	12,0
B2	19,5	39,6	18,6

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	83,7	32,4
T	4,0	26,4	13,5
A	10,0	49,6	25,2
B1	13,0	23,9	12,2
B2	19,5	32,9	16,7

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	75,0	35,6
T	4,5	28,4	13,5
A	10,0	46,9	22,3
B1	15,5	22,6	10,7
B2	22,5	37,7	17,9

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	56,9	32,7	4,0	35,3	20,3	10,0	34,5	19,9	14,5	18,1	10,4	20,5	29,1	16,7
FP2	1,0	54,0	31,6	4,0	34,4	20,1	9,5	33,1	19,3	14,5	18,7	10,9	22,0	30,8	18,0
F7	1,0	71,7	40,7	4,5	29,5	16,7	9,5	27,9	15,8	17,5	15,7	8,9	21,0	31,2	17,8
F3	1,0	78,9	39,8	4,0	33,3	16,8	9,5	29,1	14,7	13,0	19,0	9,6	21,0	38,0	19,2
FZ	,5	81,7	36,9	4,0	37,5	16,9	10,0	33,9	15,3	17,0	18,2	8,2	27,5	50,1	22,6
F4	1,0	74,4	33,1	4,0	41,7	18,6	8,0	41,0	18,2	17,0	27,3	12,1	23,0	40,3	17,9
F8	1,0	55,1	37,2	4,0	26,7	18,1	8,0	25,9	17,5	15,0	15,7	10,7	22,0	24,4	16,5
T3	1,0	50,9	34,3	4,5	23,2	15,7	9,0	24,4	16,4	13,5	17,0	11,4	18,5	32,8	22,2
C3	1,0	61,5	31,9	5,0	37,6	19,5	10,0	42,5	22,0	13,0	20,9	10,8	19,0	30,6	15,8
CZ	,5	86,2	30,0	5,0	68,0	23,7	8,5	56,9	19,8	13,0	30,3	10,5	19,5	45,7	15,9
C4	1,0	66,3	27,4	5,0	51,5	21,3	9,0	59,0	24,4	13,0	25,5	10,6	18,5	39,1	16,2
T4	1,0	53,0	32,0	4,0	29,9	18,1	9,0	32,3	19,5	13,0	15,7	9,5	22,0	34,6	20,9
T5	1,0	67,0	34,9	5,0	27,8	14,5	9,5	38,2	19,9	13,0	22,7	11,8	19,5	36,1	18,8
P3	1,0	65,8	27,7	6,5	43,8	18,5	10,0	68,6	28,9	13,0	25,4	10,7	19,5	33,5	14,1
PZ	2,5	89,7	29,2	7,0	53,6	17,5	10,0	101,6	33,1	13,0	27,4	8,9	20,5	34,7	11,3
P4	1,0	76,7	26,1	7,0	54,8	18,7	10,0	100,8	34,4	13,0	27,7	9,4	19,0	33,3	11,4
T6	1,0	55,5	29,8	7,5	29,2	15,7	10,0	55,1	29,6	13,0	16,5	8,9	20,0	30,0	16,1
O1	1,0	69,2	32,4	6,5	28,4	13,3	10,0	50,7	23,7	13,0	25,5	12,0	19,5	39,6	18,6
OZ	1,0	63,7	32,4	4,0	26,4	13,5	10,0	49,6	25,2	13,0	23,9	12,2	19,5	32,9	16,7
O2	1,0	75,0	35,6	4,5	28,4	13,5	10,0	46,9	22,3	15,5	22,6	10,7	22,5	37,7	17,9

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	56,9	32,7	4,0	35,3	20,3	10,0	34,5	19,9	14,5	18,1	10,4	20,5	29,1	16,7
FP2	1,0	54,0	31,6	4,0	34,4	20,1	9,5	33,1	19,3	14,5	18,7	10,9	22,0	30,8	18,0
F7	1,0	71,7	40,7	4,5	29,5	16,7	9,5	27,9	15,8	17,5	15,7	8,9	21,0	31,2	17,8
F3	1,0	78,9	39,8	4,0	33,3	16,8	9,5	29,1	14,7	13,0	19,0	9,6	21,0	38,0	19,2
FZ	,5	81,7	36,9	4,0	37,5	16,9	10,0	33,9	15,3	17,0	18,2	8,2	27,5	50,1	22,6
F4	1,0	74,4	33,1	4,0	41,7	18,6	8,0	41,0	18,2	17,0	27,3	12,1	23,0	40,3	17,9
F8	1,0	55,1	37,2	4,0	26,7	18,1	8,0	25,9	17,5	15,0	15,7	10,7	22,0	24,4	16,5
T3	1,0	50,9	34,3	4,5	23,2	15,7	9,0	24,4	16,4	13,5	17,0	11,4	18,5	32,8	22,2
C3	1,0	61,5	31,9	5,0	37,6	19,5	10,0	42,5	22,0	13,0	20,9	10,8	19,0	30,6	15,8
CZ	,5	86,2	30,0	5,0	68,0	23,7	8,5	56,9	19,8	13,0	30,3	10,5	19,5	45,7	15,9
C4	1,0	66,3	27,4	5,0	51,5	21,3	9,0	59,0	24,4	13,0	25,5	10,6	18,5	39,1	16,2
T4	1,0	53,0	32,0	4,0	29,9	18,1	9,0	32,3	19,5	13,0	15,7	9,5	22,0	34,6	20,9
T5	1,0	67,0	34,9	5,0	27,8	14,5	9,5	38,2	19,9	13,0	22,7	11,8	19,5	36,1	18,8
P3	1,0	65,8	27,7	6,5	43,8	18,5	10,0	68,6	28,9	13,0	25,4	10,7	19,5	33,5	14,1
PZ	2,5	89,7	29,2	7,0	53,6	17,5	10,0	101,6	33,1	13,0	27,4	8,9	20,5	34,7	11,3
P4	1,0	76,7	26,1	7,0	54,8	18,7	10,0	100,8	34,4	13,0	27,7	9,4	19,0	33,3	11,4
T6	1,0	55,5	29,8	7,5	29,2	15,7	10,0	55,1	29,6	13,0	16,5	8,9	20,0	30,0	16,1
O1	1,0	69,2	32,4	6,5	28,4	13,3	10,0	50,7	23,7	13,0	25,5	12,0	19,5	39,6	18,6
OZ	1,0	63,7	32,4	4,0	26,4	13,5	10,0	49,6	25,2	13,0	23,9	12,2	19,5	32,9	16,7
O2	1,0	75,0	35,6	4,5	28,4	13,5	10,0	46,9	22,3	15,5	22,6	10,7	22,5	37,7	17,9

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	15:57:20	02:12	Olhos abertos
5	15:59:31	02:13	Olhos fechados
9	16:01:44	01:49	Vigília
13	16:03:33	01:17	Foto Estimulação
13	16:03:40	00:00	Foto 1 hz
13	16:03:45	00:00	Foto 3 hz
14	16:03:50	00:00	Foto 6 hz
14	16:03:55	00:00	Foto Desativado
14	16:04:14	00:00	Foto 1 hz
15	16:04:19	00:00	Foto 3 hz
15	16:04:24	00:00	Foto 6 hz
15	16:04:29	00:00	Foto Desativado
15	16:04:30	00:00	Foto 1 hz
15	16:04:35	00:00	Foto 3 hz
15	16:04:40	00:00	Foto 6 hz
15	16:04:45	00:00	Foto Desativado
16	16:04:50	00:57	Olhos fechados
17	16:05:47	01:37	Vigília