


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

14:43:41 Olhos fechados 14:43:41 Olhos fechados 14:43:43 Olhos fechados 14:43:43 Olhos fechados 14:43:44 Olhos fechados 14:43:45 Olhos fechados 14:43:46 Olhos fechados 14:43:47 Olhos fechados

Época: 1 - Horário: 14:43:41 - Estágio: 0 (8 seg.)

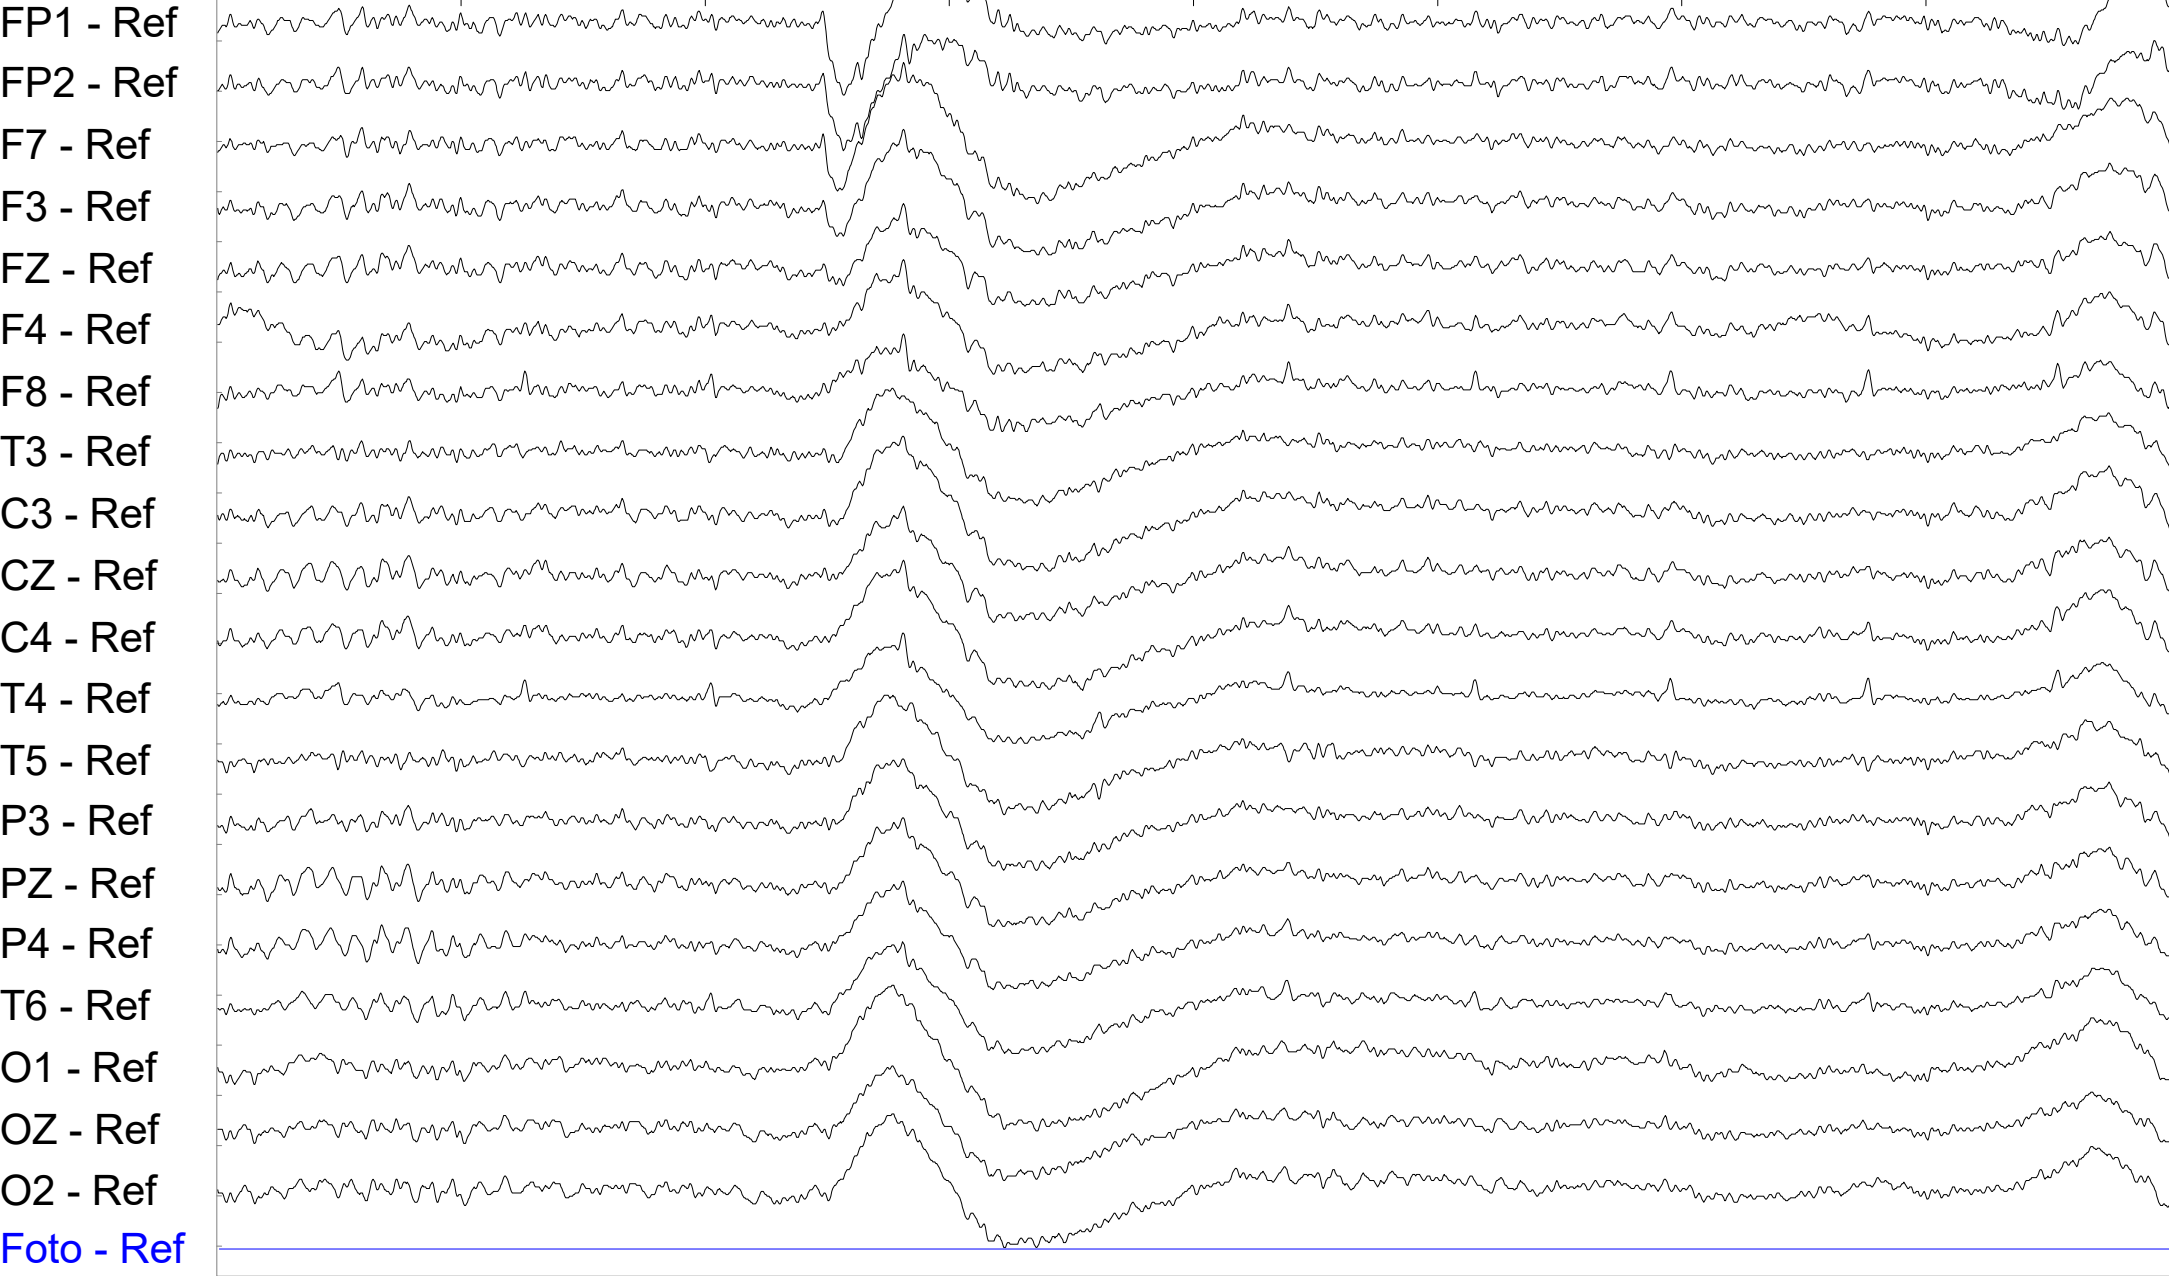


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 4/21

14:45:10 Olhos fechados 14:45:11 Olhos fechados 14:45:12 Olhos fechados 14:45:13 Olhos fechados 14:45:14 Olhos fechados 14:45:15 Olhos fechados 14:45:16 Olhos fechados 14:45:17 Olhos fechados

Época: 4 - Horário: 14:45:11 - Estágio: 0 (8 seg.)

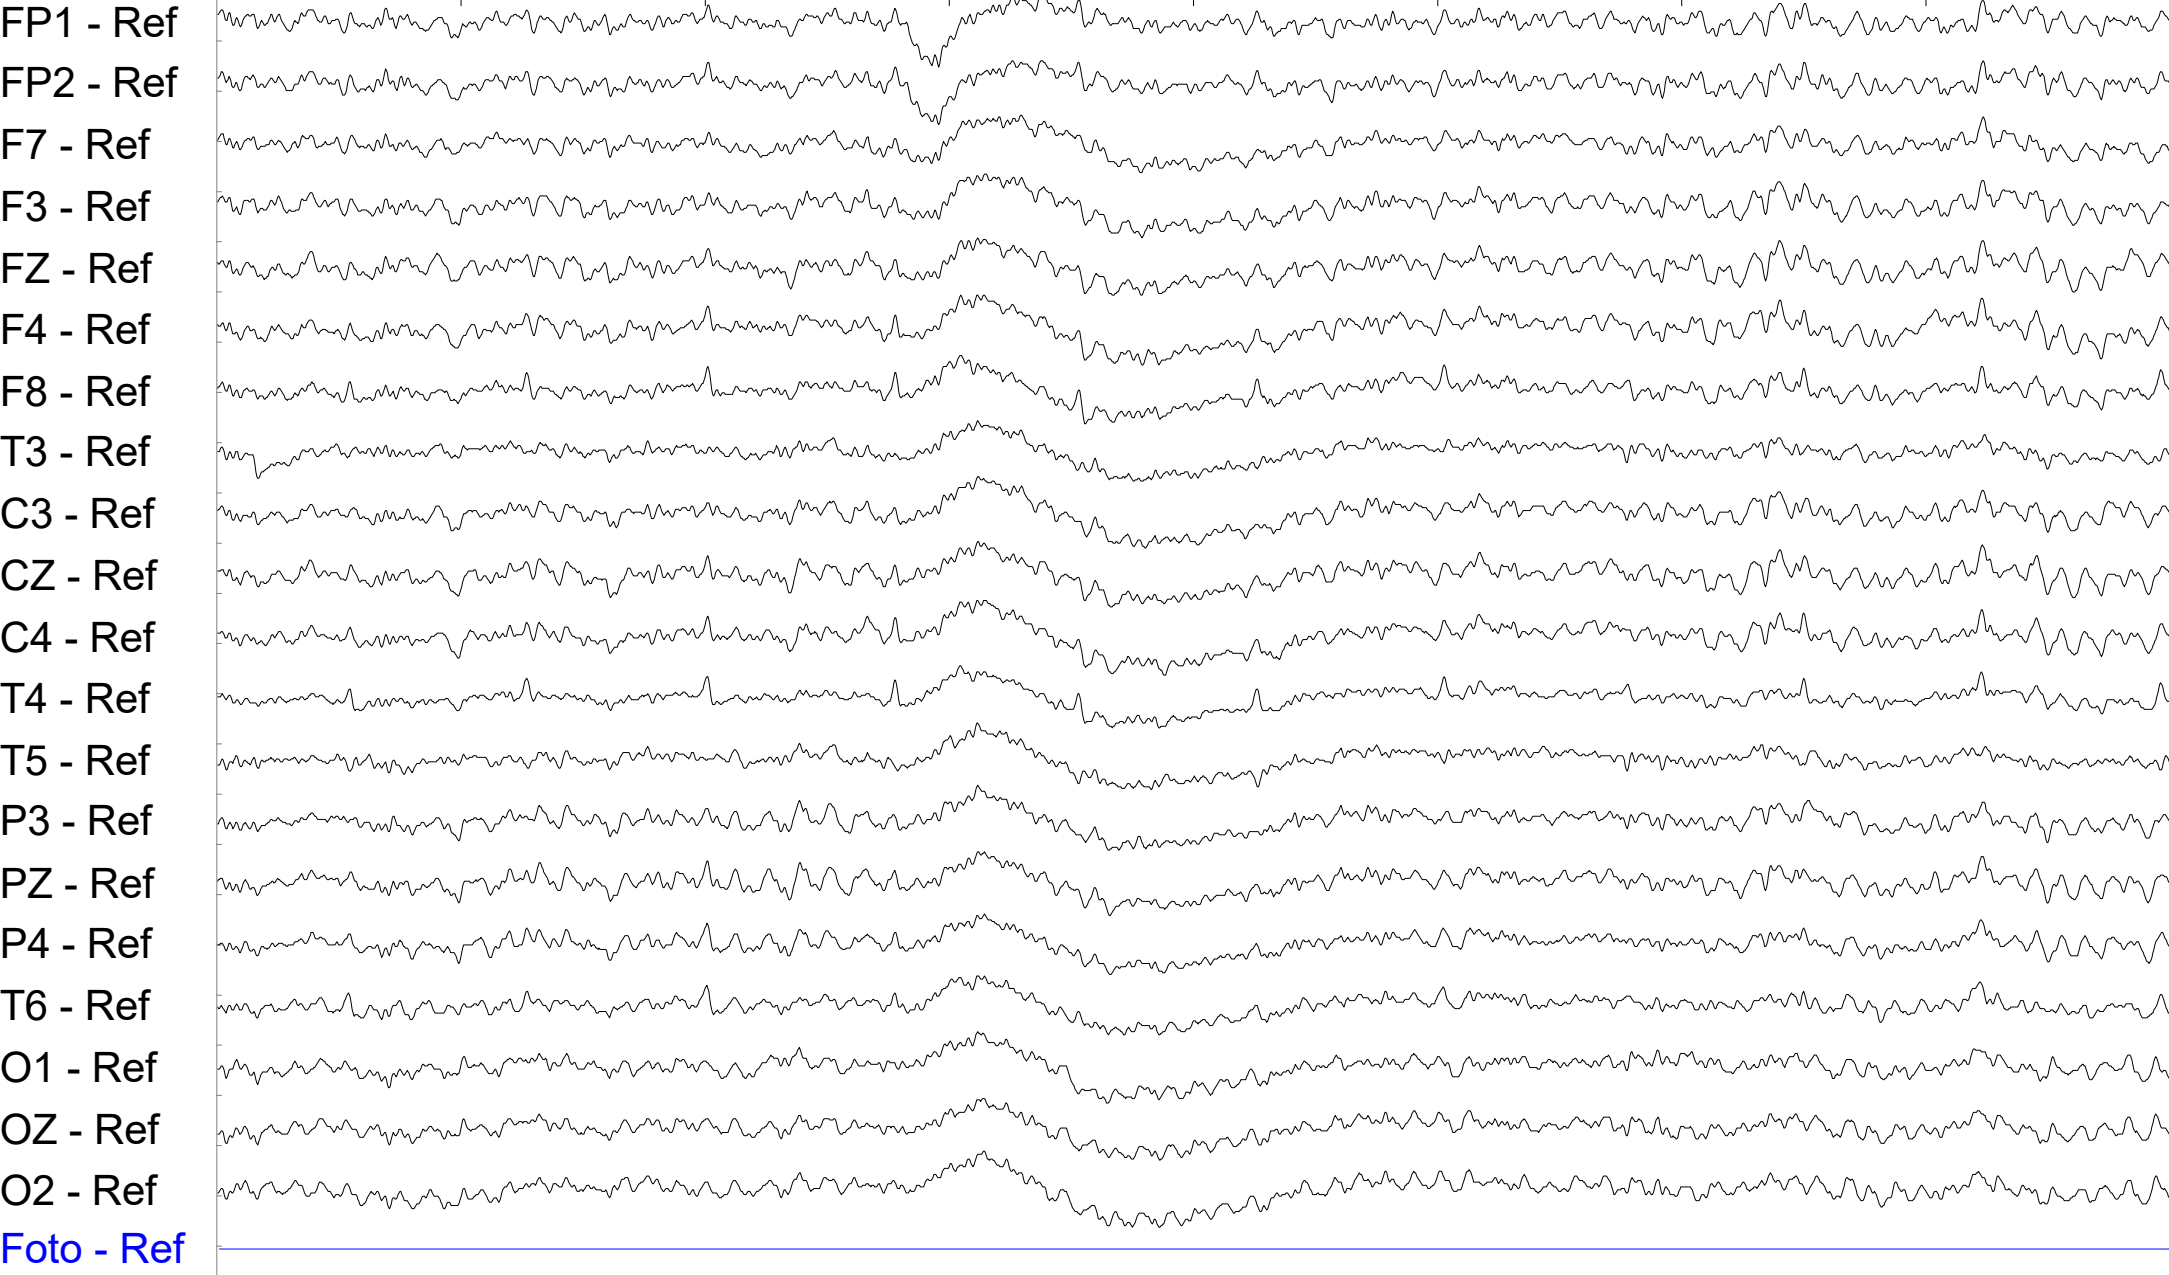

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 6/21

14:46:10

Vigília

14:46:11

Vigília

14:46:12

Vigília

14:46:13

Vigília

14:46:14

Vigília

14:46:15

Vigília


14:46:16

Vigília

14:46:17

Vigília

Época: 6 - Horário: 14:46:11 - Estágio: 0 (8 seg.)

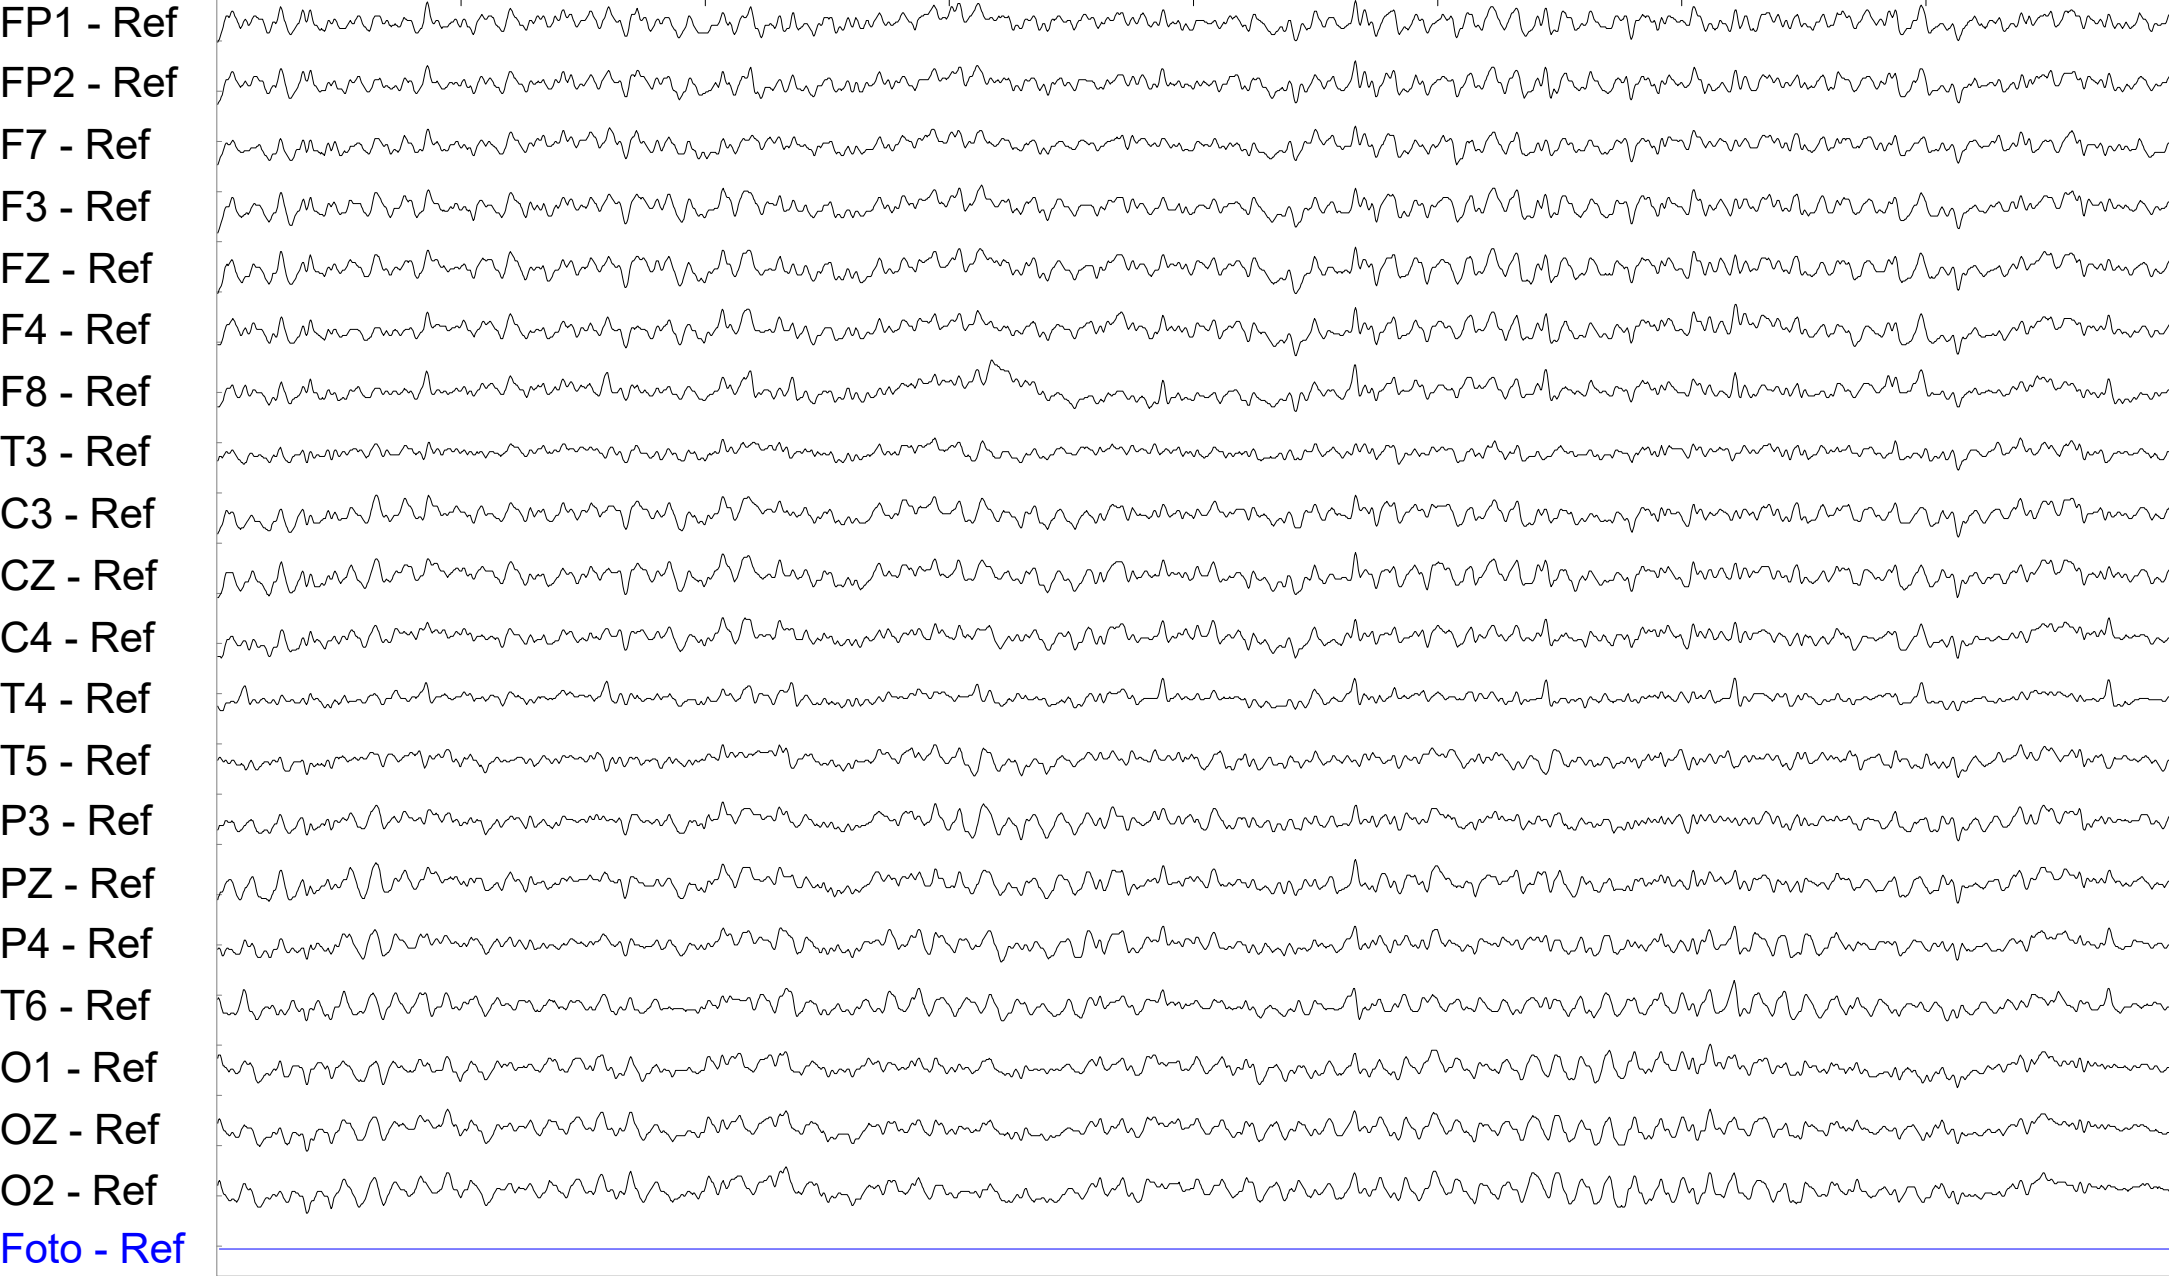

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 9/21

14:47:40

Vigília

14:47:41

Vigília

14:47:42

Vigília

14:47:43

Vigília

14:47:44

Vigília

14:47:45

Vigília


14:47:46

Vigília

14:47:47

Vigília

Época: 9 - Horário: 14:47:41 - Estágio: 0 (8 seg.)

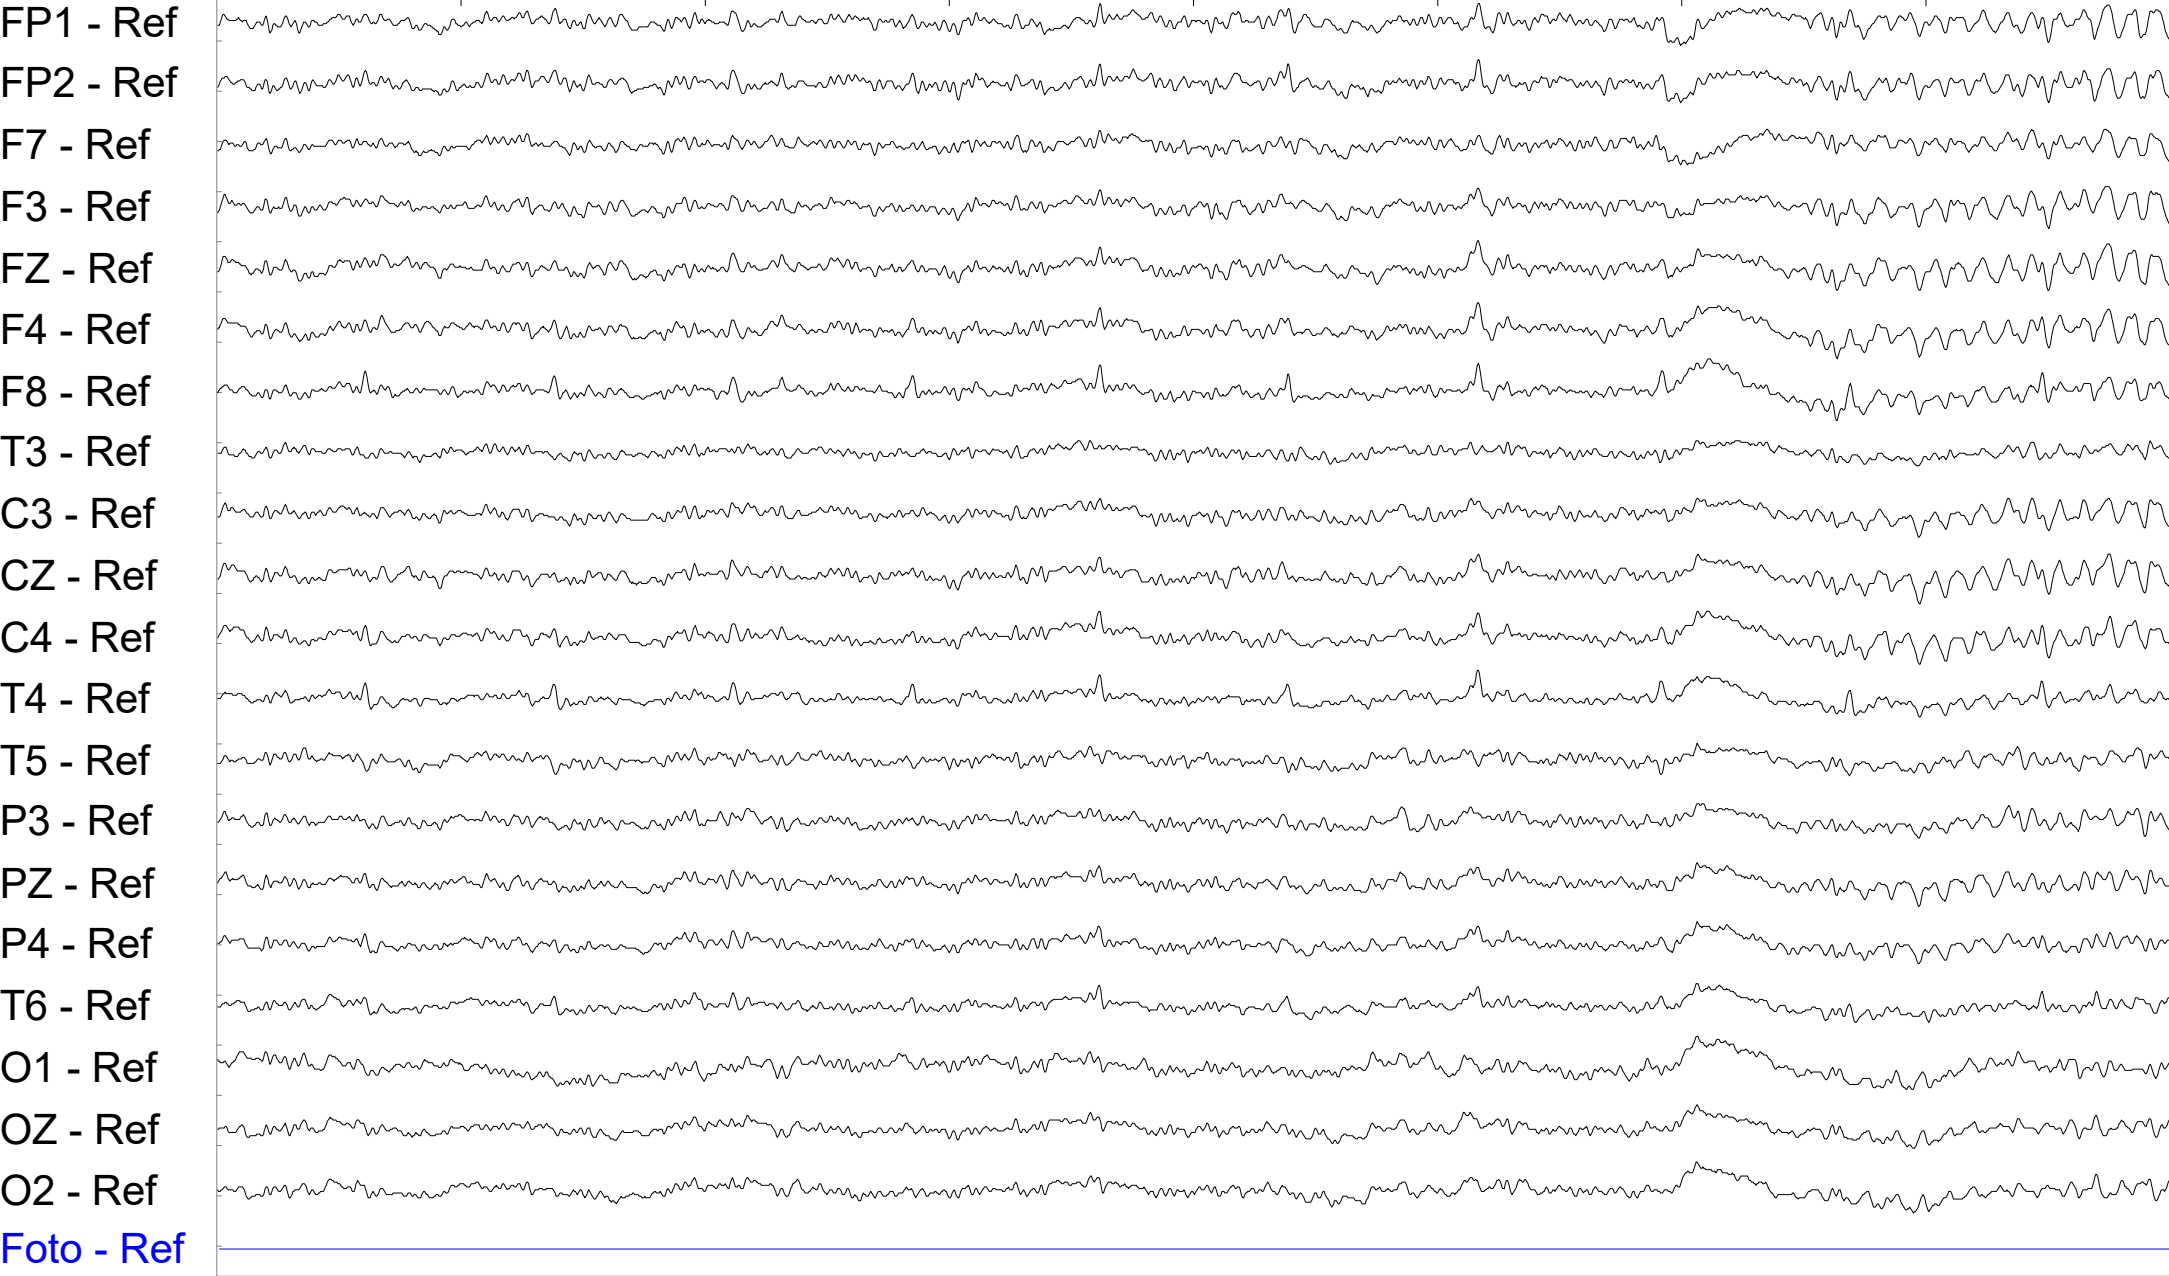

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 10/21

14:48:10

Olhos abertos

14:48:11

Olhos abertos

14:48:12

Olhos abertos

14:48:13

Olhos abertos

14:48:14

Olhos abertos

14:48:15

Olhos abertos


14:48:16

Olhos abertos

14:48:17

Olhos abertos

Época: 10 - Horário: 14:48:11 - Estágio: 0 (8 seg.)

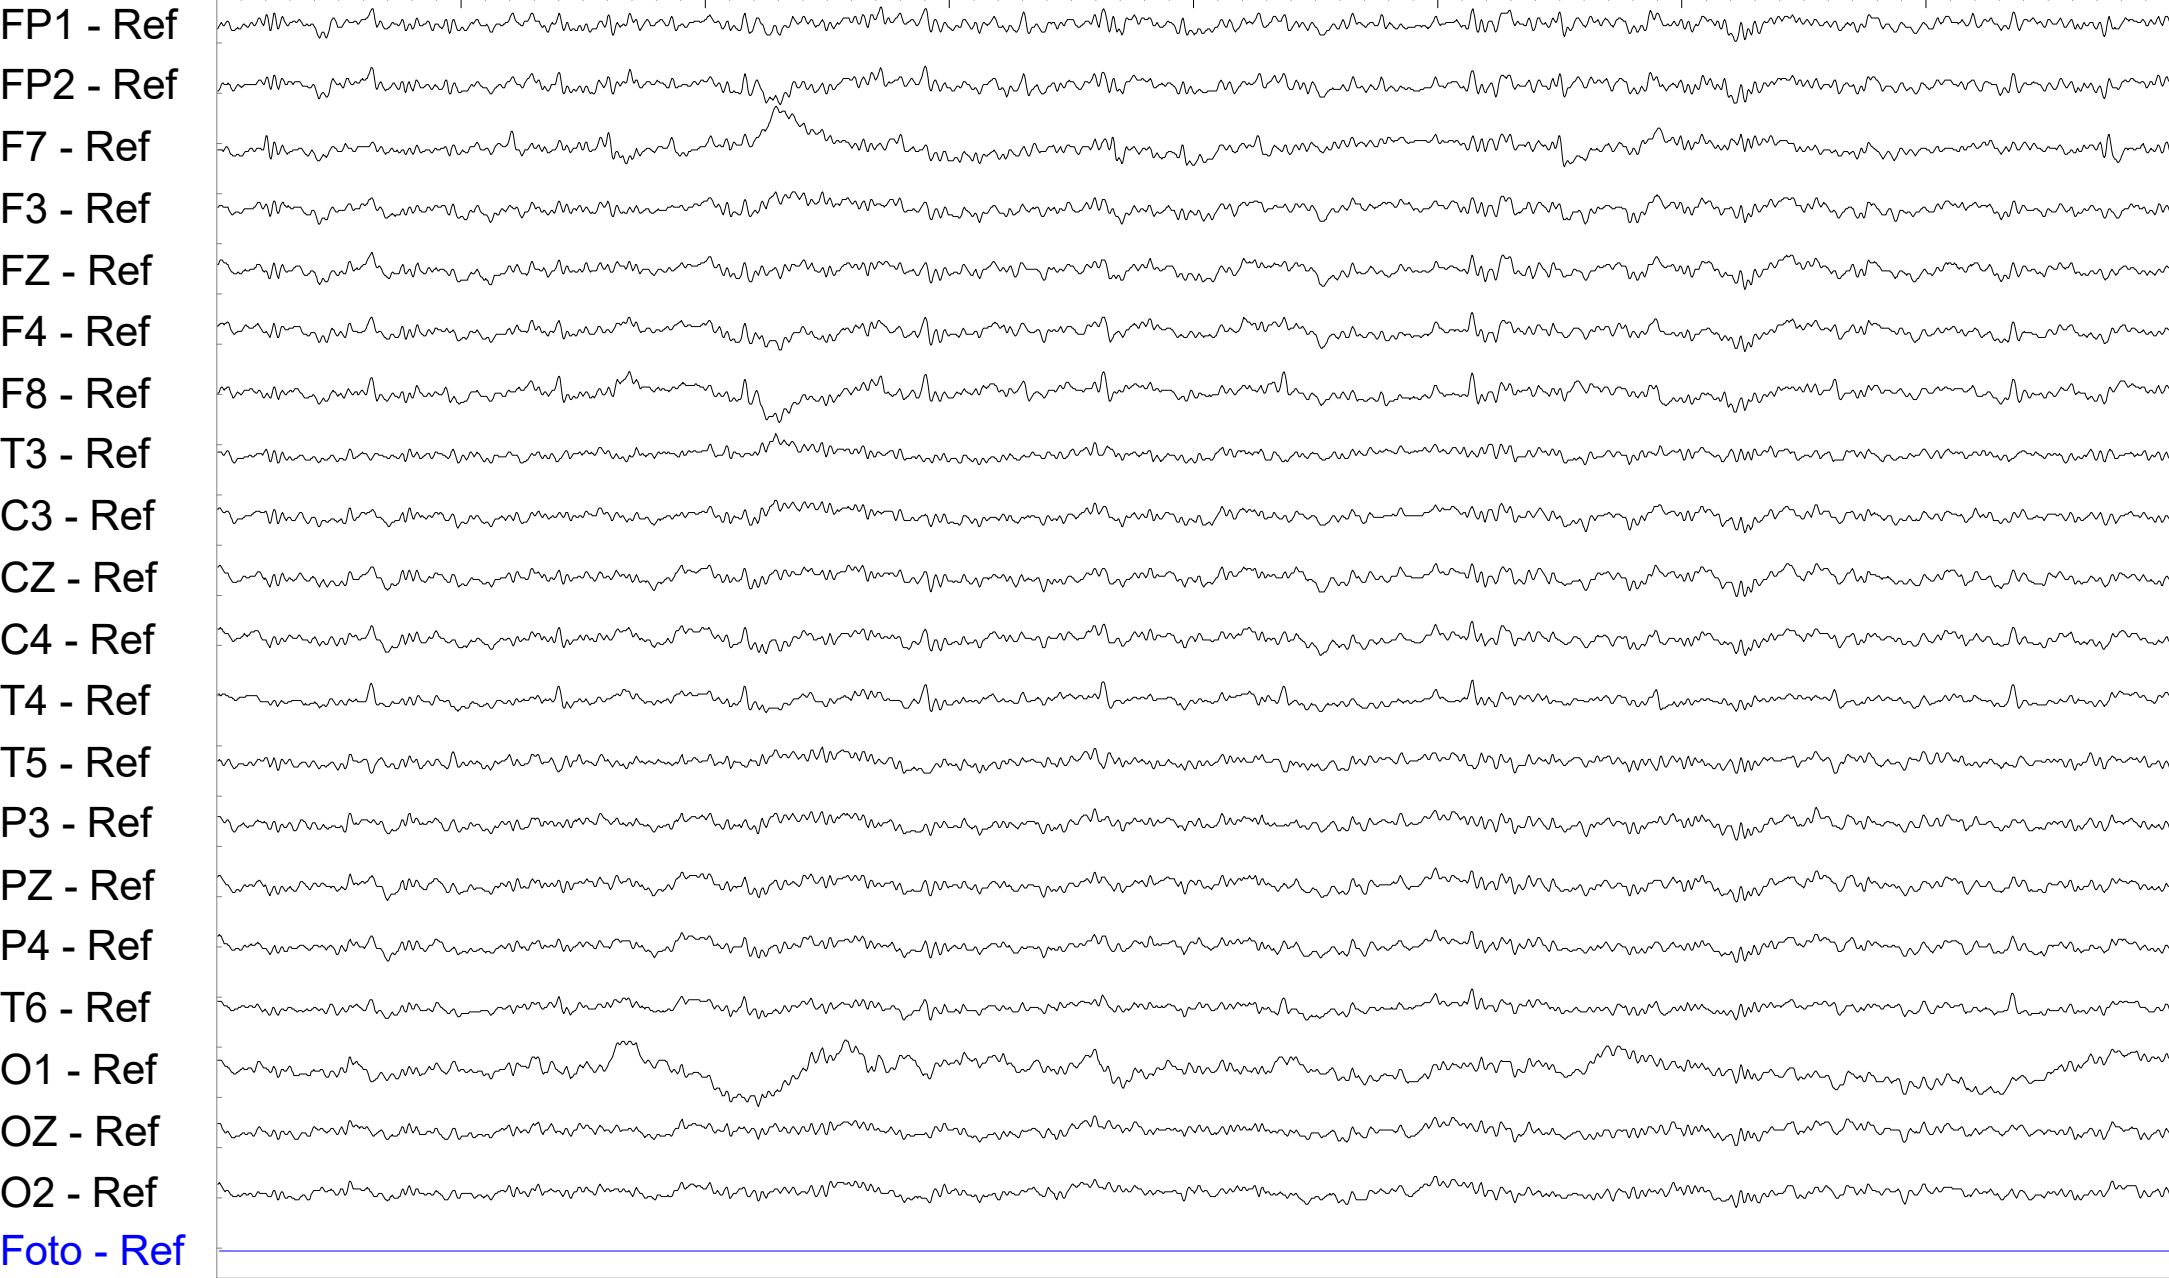


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 13/21

14:49:40 Olhos abertos 14:49:41 Olhos abertos 14:49:42 Olhos abertos 14:49:43 Olhos abertos 14:49:44 Olhos abertos 14:49:45 Olhos abertos 14:49:46 Olhos abertos 14:49:47 Olhos abertos
Época: 13 - Horário: 14:49:41 - Estágio: 0 (8 seg.)

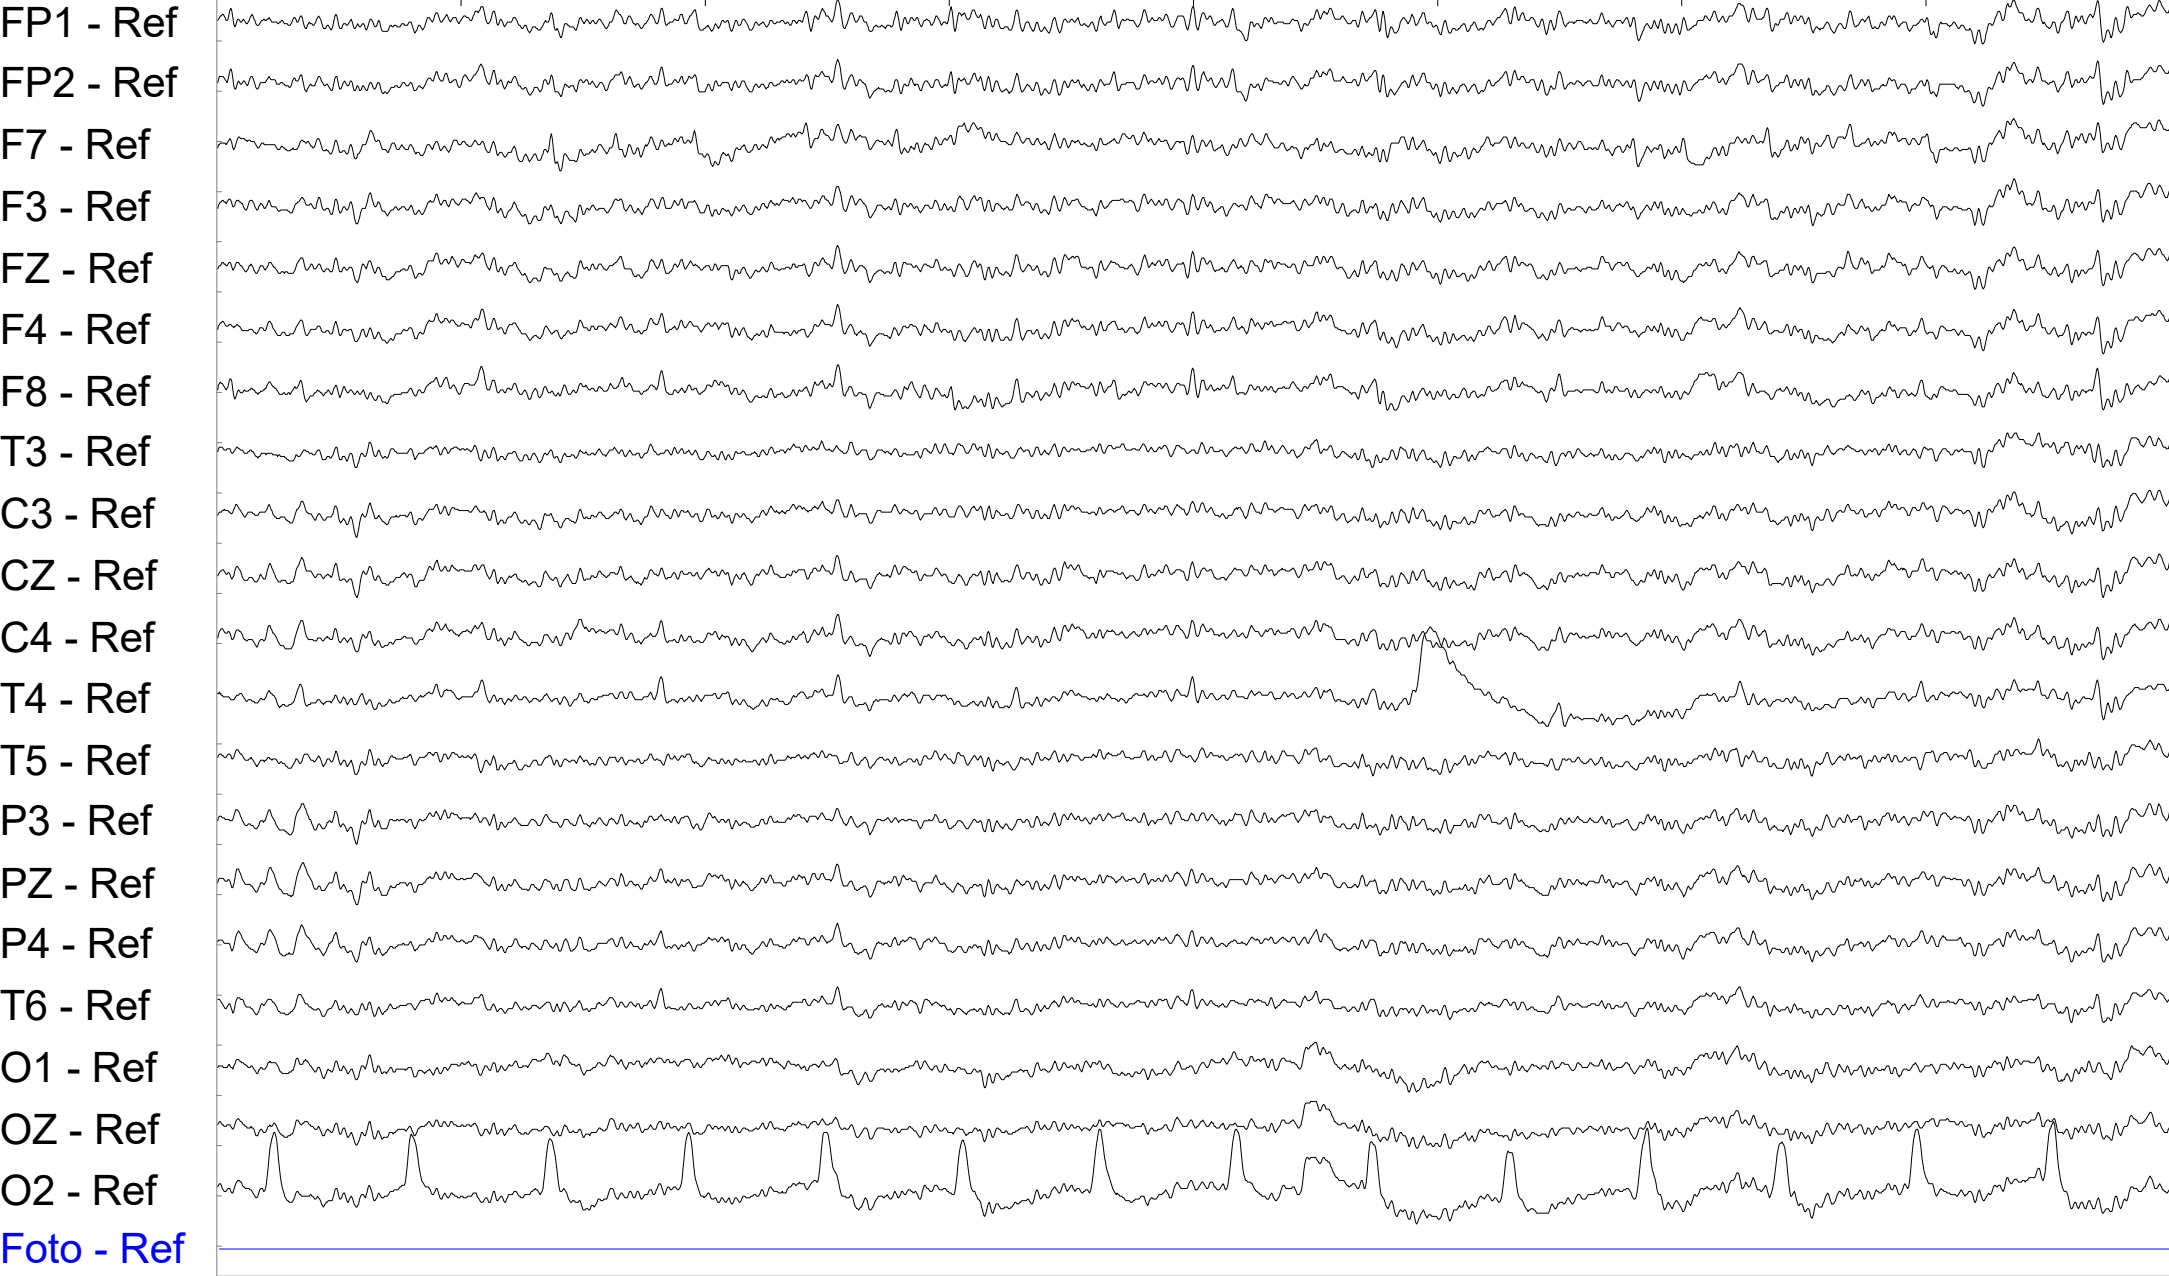


NEUROCLINIC


Informe o nome do médico

Pág. 16/21


14:51:10 Olhos fechados 14:51:11 Olhos fechados 14:51:12 Olhos fechados 14:51:13 Olhos fechados 14:51:14 Olhos fechados 14:51:15 Olhos fechados 14:51:16 Olhos fechados 14:51:17 Olhos fechados

Época: 16 - Horário: 14:51:11 - Estágio: 0 (8 seg.)

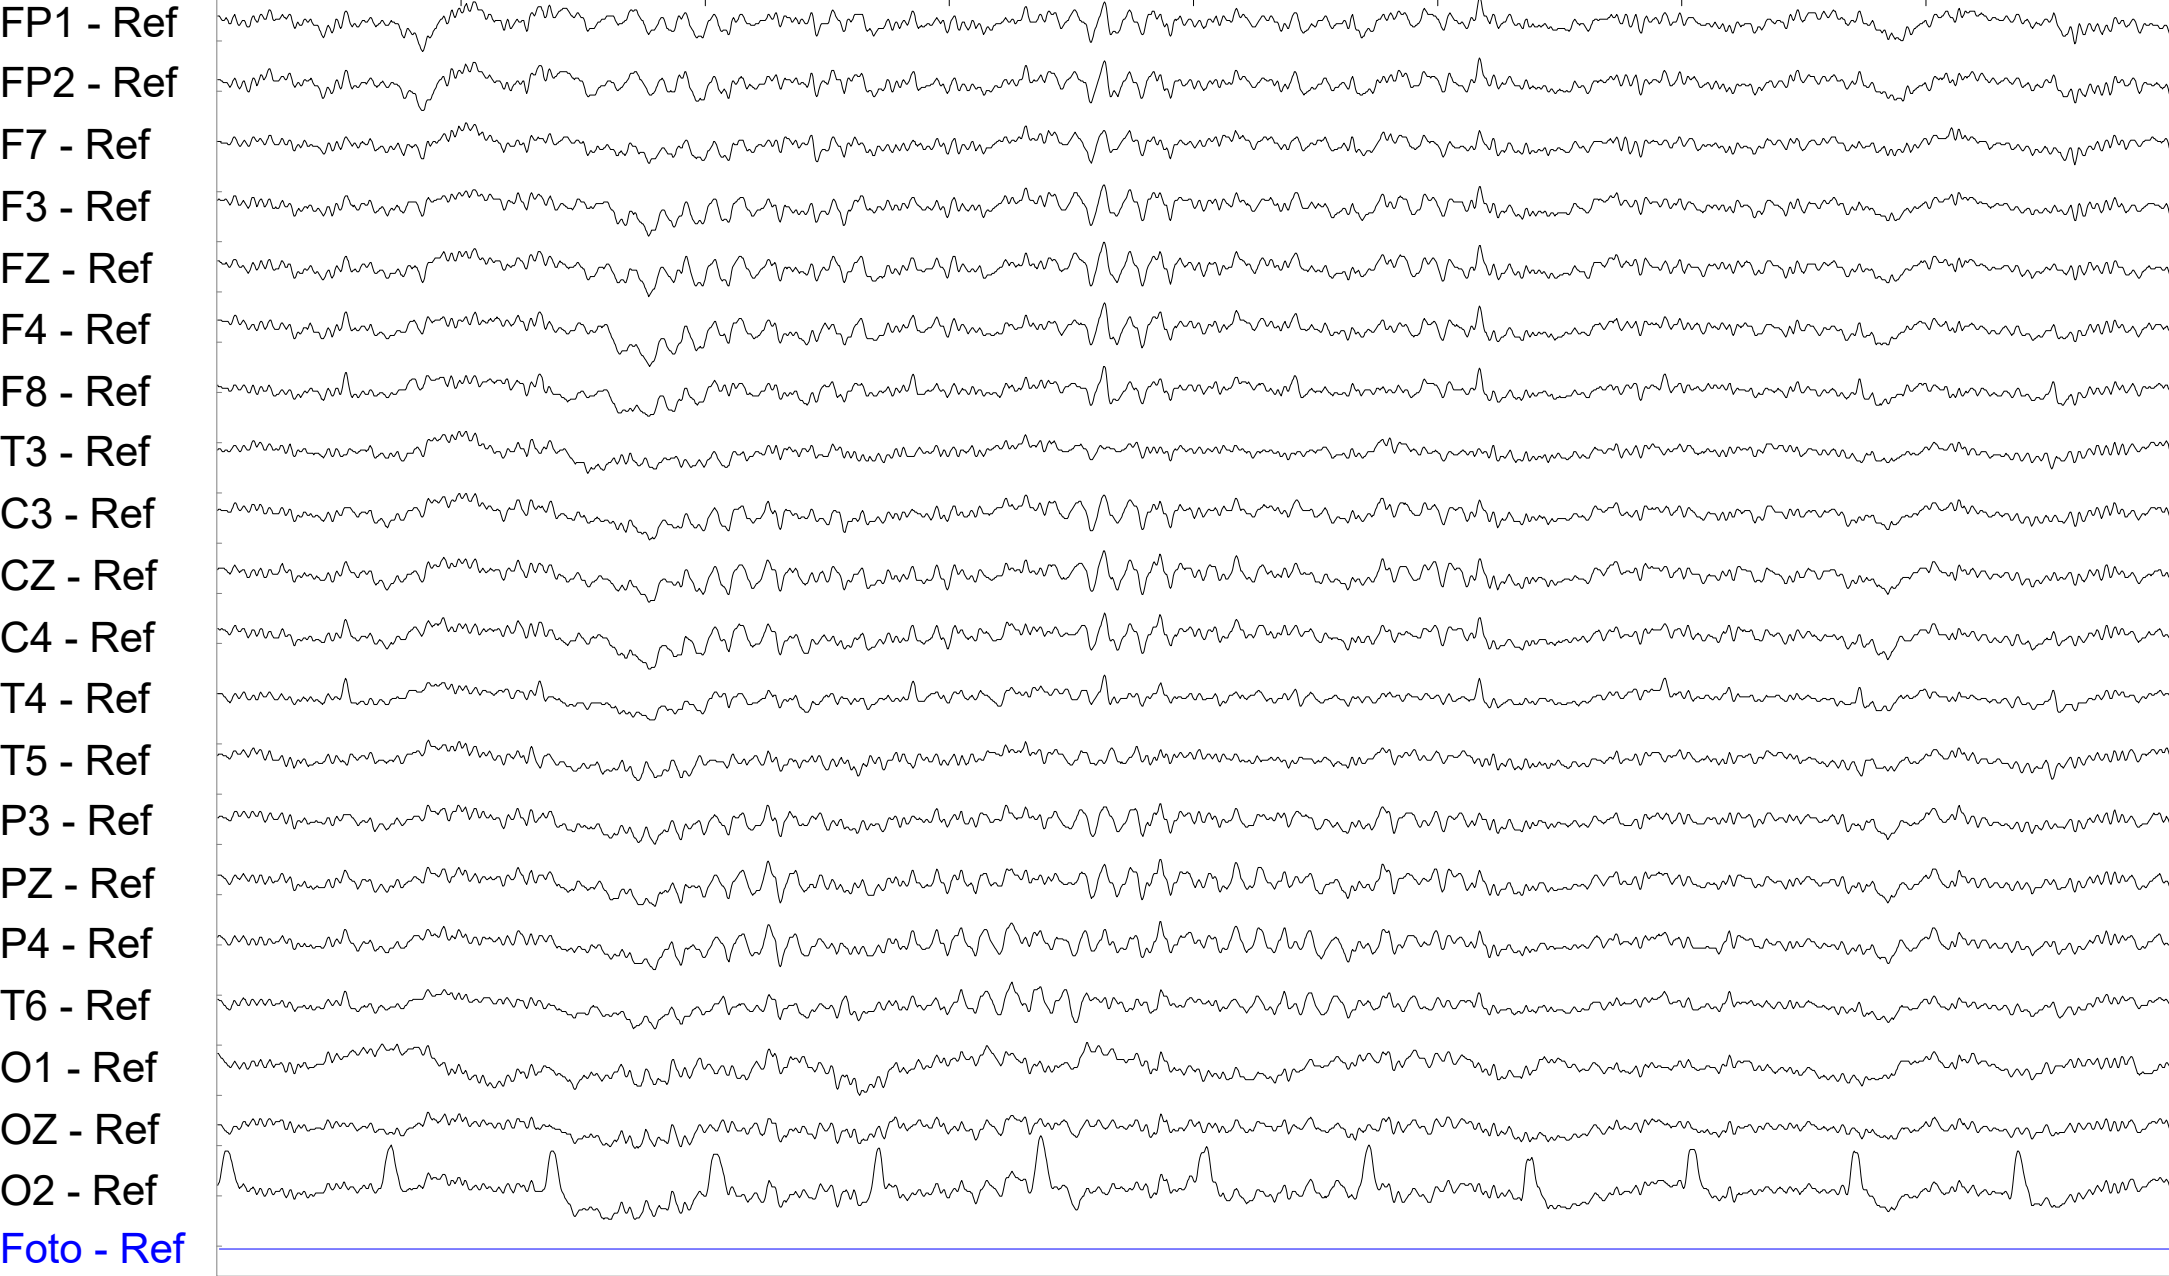



14:52:40	14:52:41	14:52:42	14:52:43	14:52:44	14:52:45	14:52:46	14:52:47
Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia	Hiperpneia
Época: 19 - Horário: 14:52:41 - Estágio: 0 (8 seg.)							

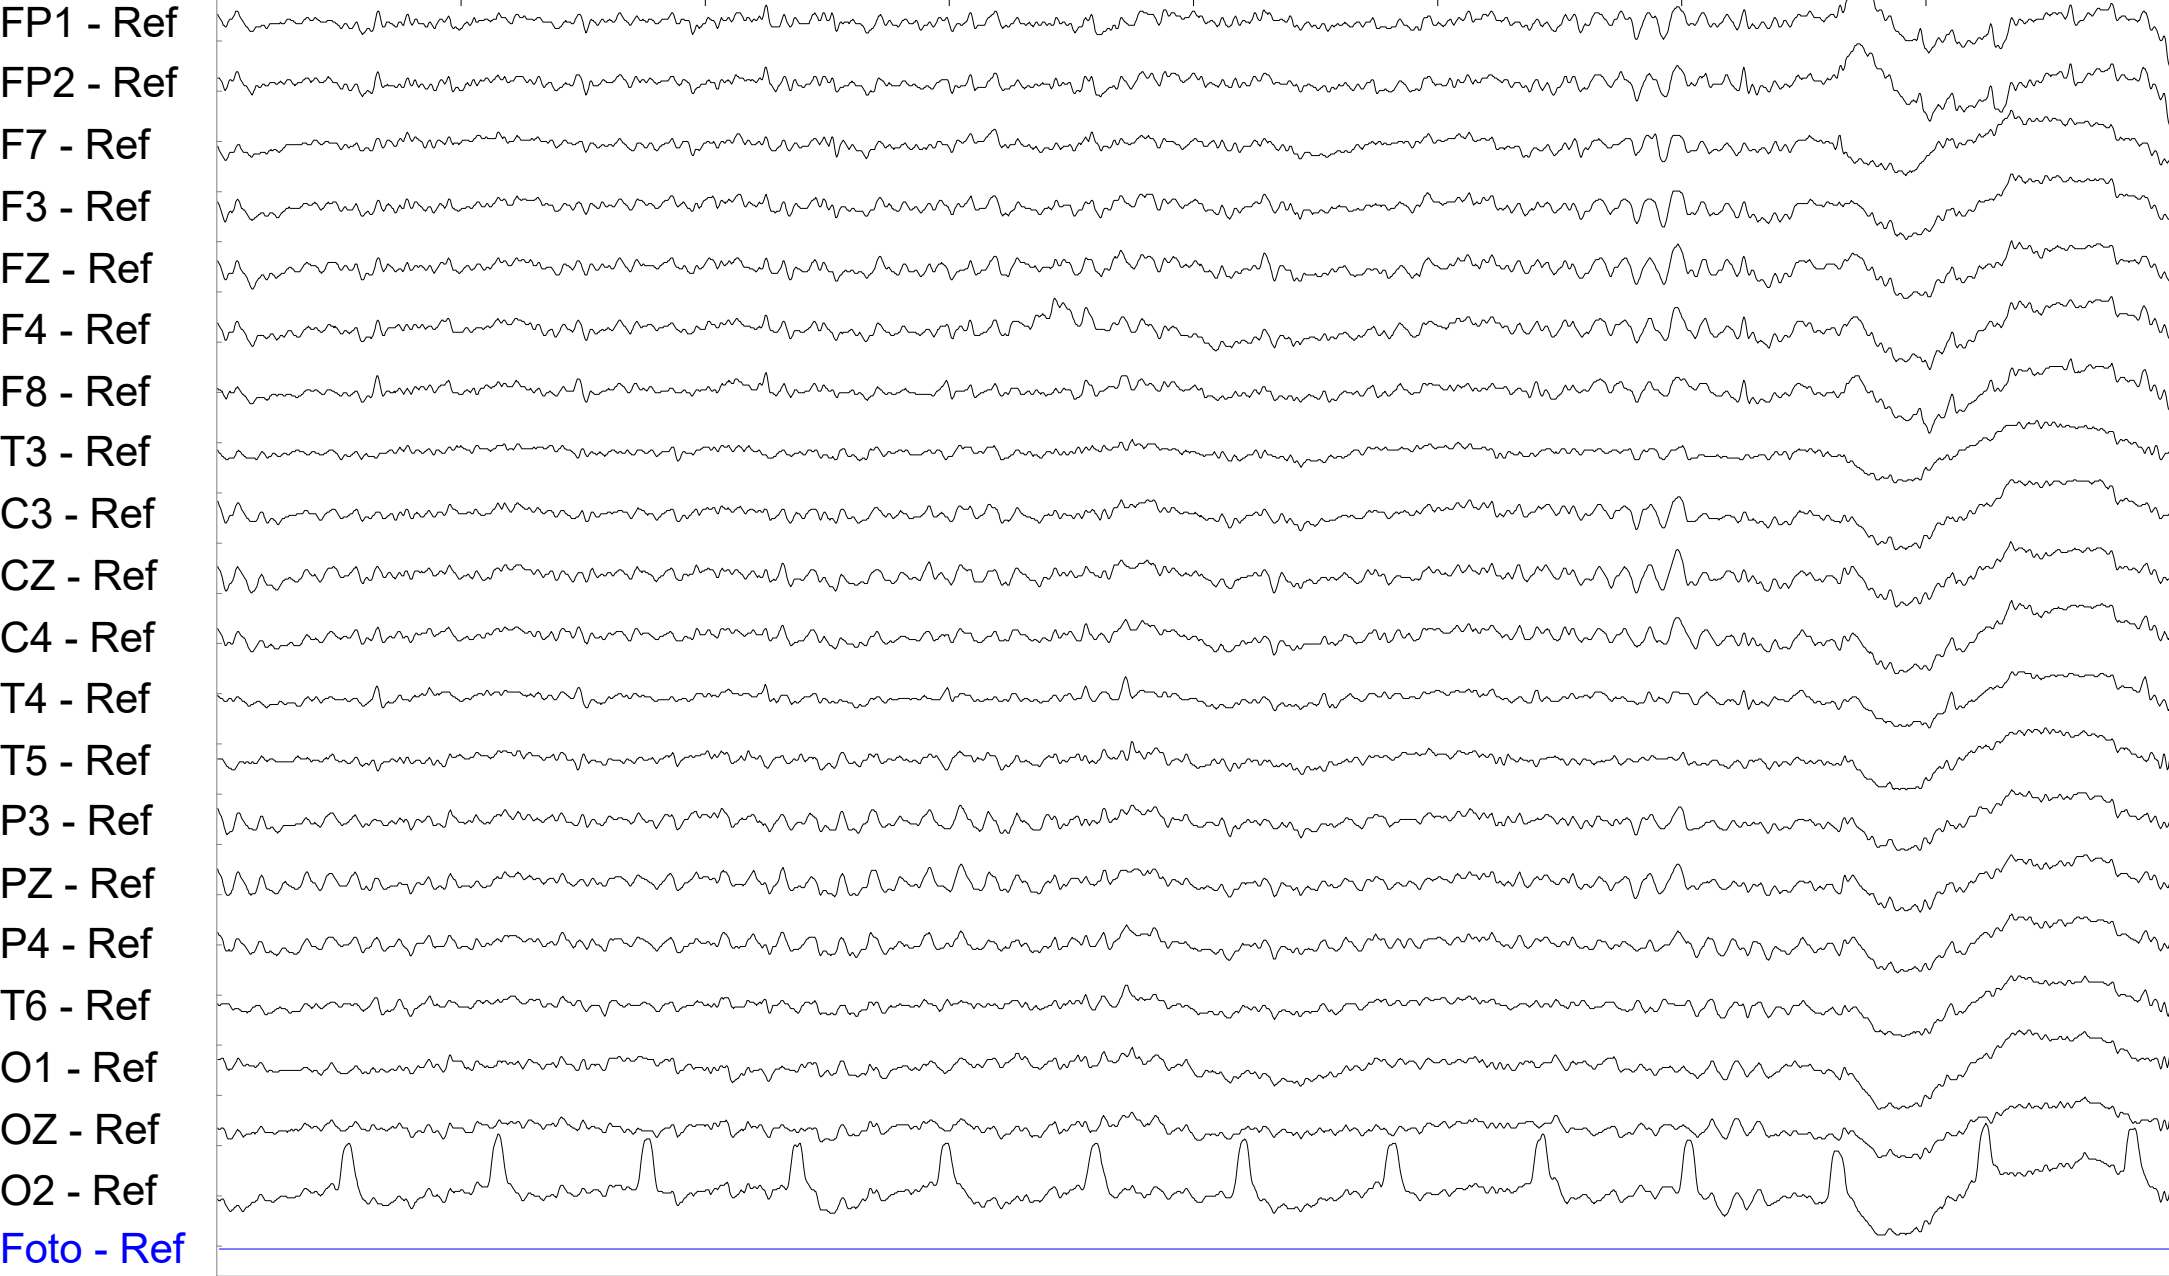


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 21/21

14:53:40 Pós hiperpneia 14:53:41 Pós hiperpneia 14:53:42 Pós hiperpneia 14:53:43 Pós hiperpneia 14:53:44 Pós hiperpneia 14:53:45 Pós hiperpneia 14:53:46 Pós hiperpneia 14:53:47 Pós hiperpneia
Época: 21 - Horário: 14:53:41 - Estágio: 0 (8 seg.)

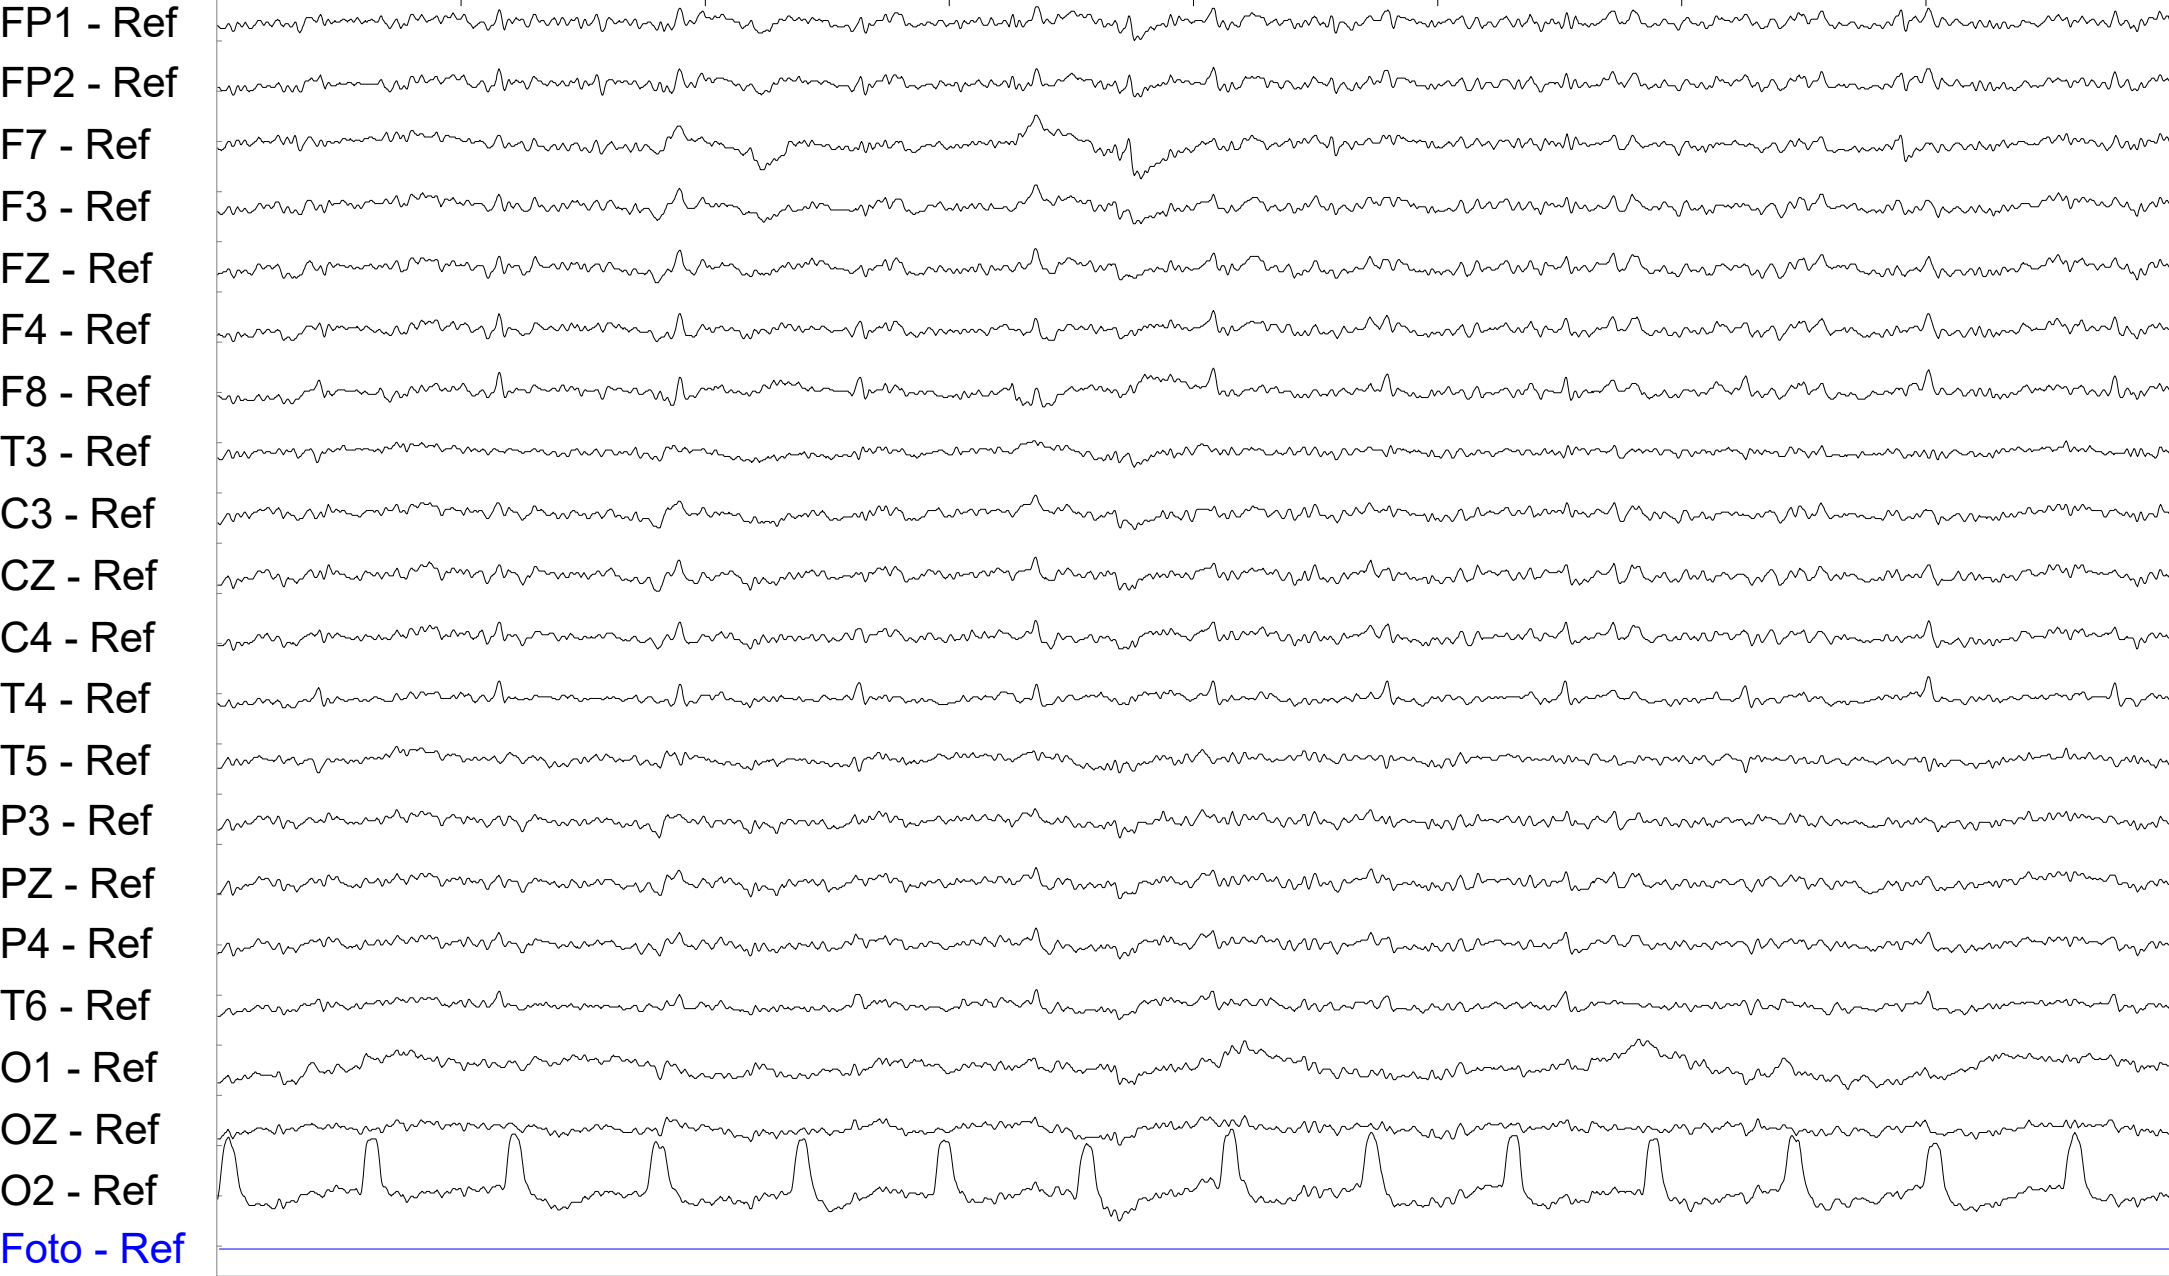

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 21/21

14:54:02

Vigília

14:54:03

Vigília

14:54:04

Vigília

14:54:05

Vigília

14:54:06

Vigília

14:54:07

Vigília


14:54:08

Vigília

14:54:09

Vigília

Época: 21 - Horário: 14:54:03 - Estágio: 0 (8 seg.)

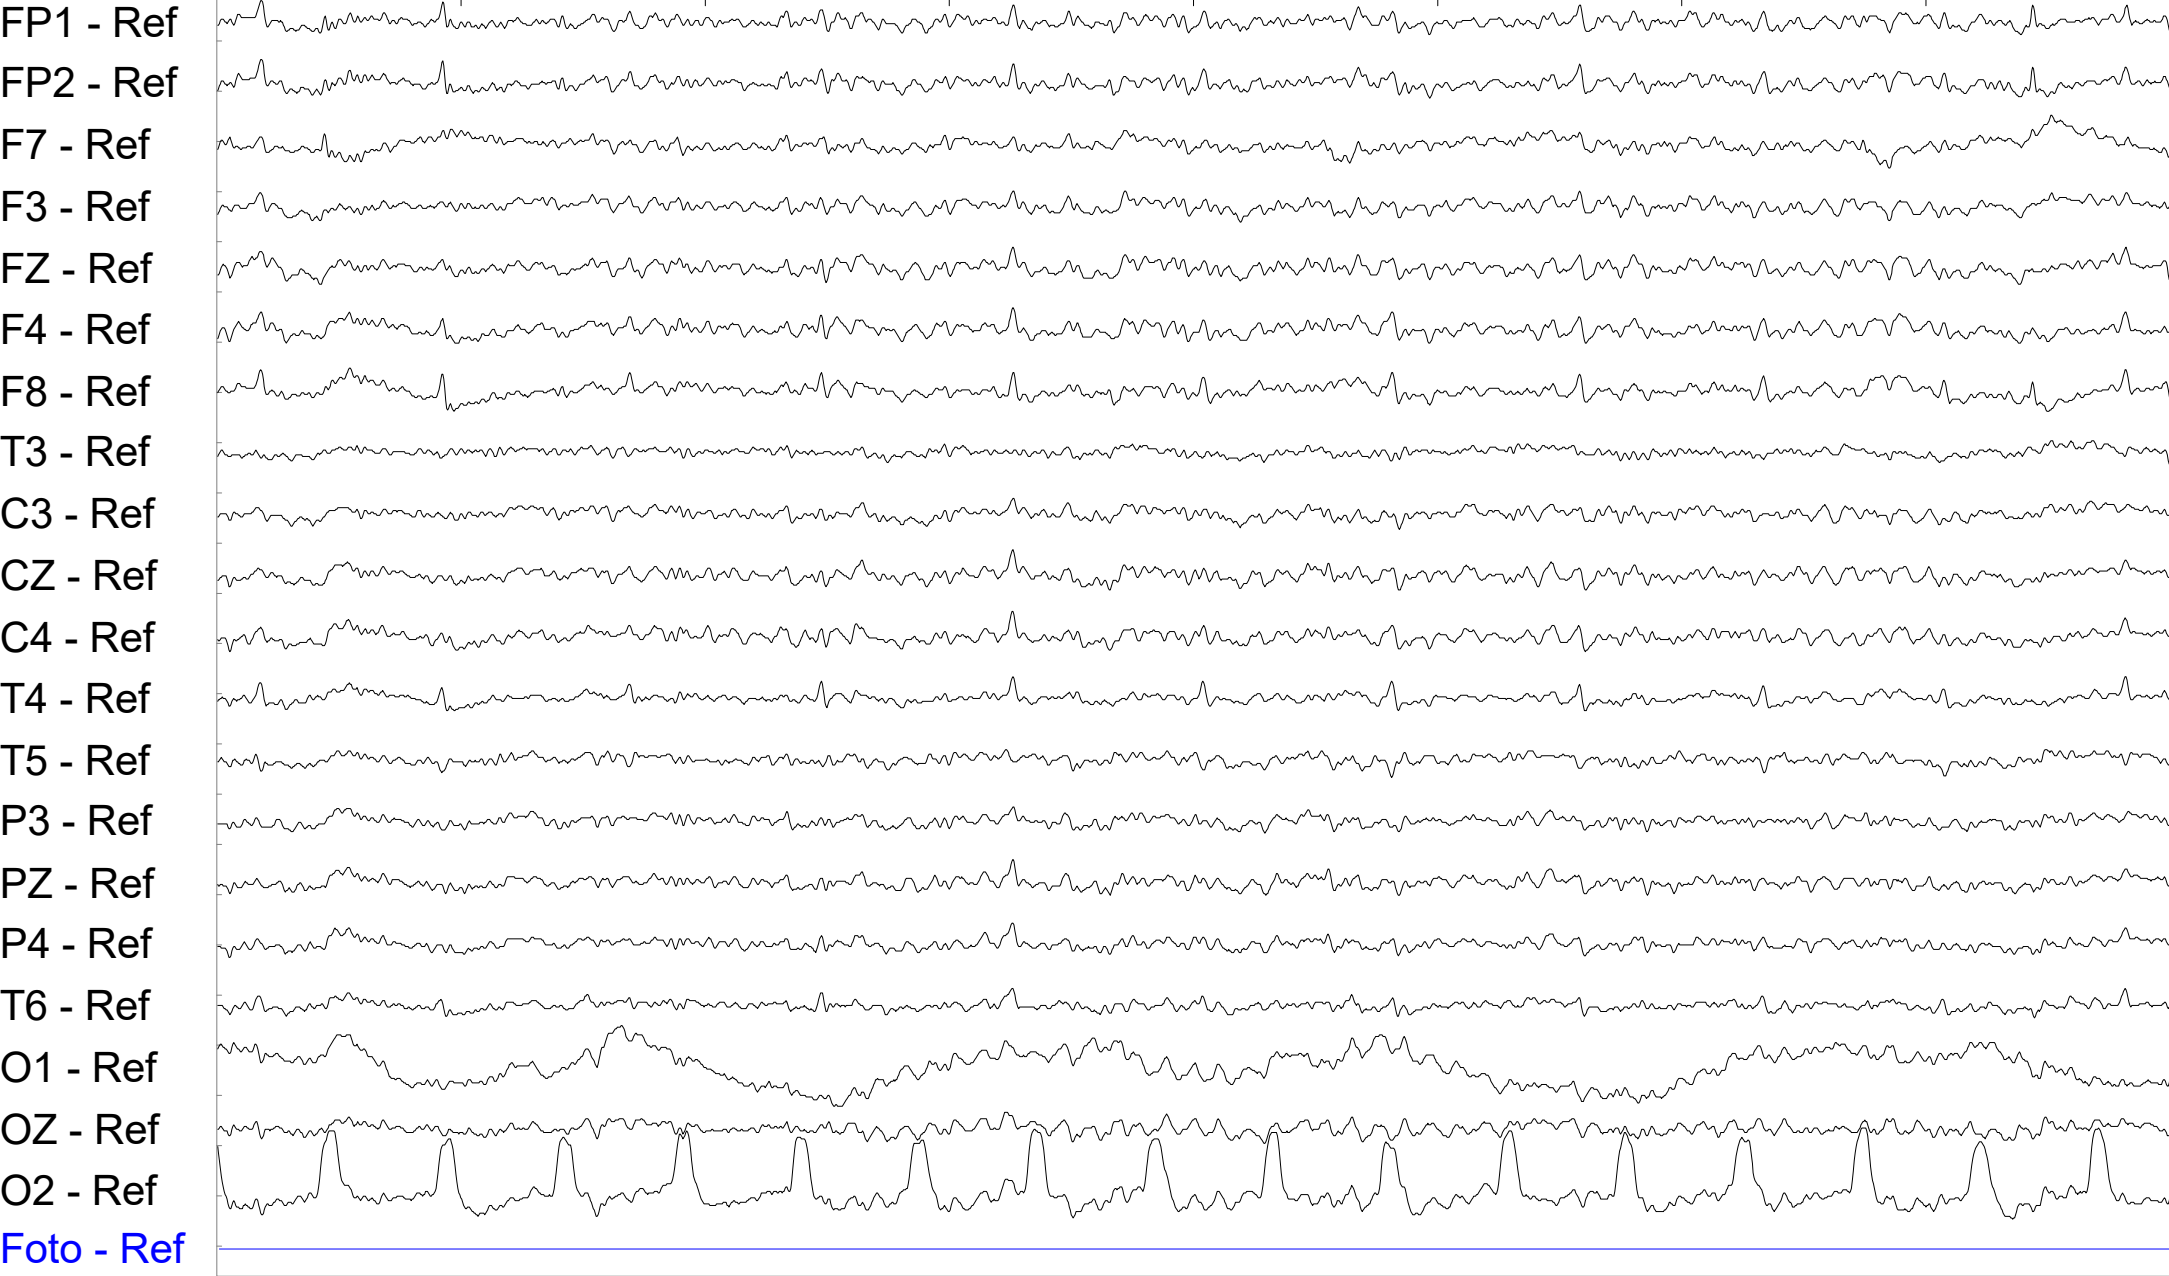



NEUROCLINIC


Informe o nome do médico

14:50:02 Foto Estimulação 14:50:03 Foto Estimulação 14:50:04 Foto Estimulação 14:50:05 Foto Estimulação 14:50:06 Foto Estimulação 14:50:07 Foto Estimulação 14:50:08 Foto Estimulação 14:50:09 Foto Estimulação

Época: 13 - Horário: 14:50:03 - Estágio: 0 (8 seg.)

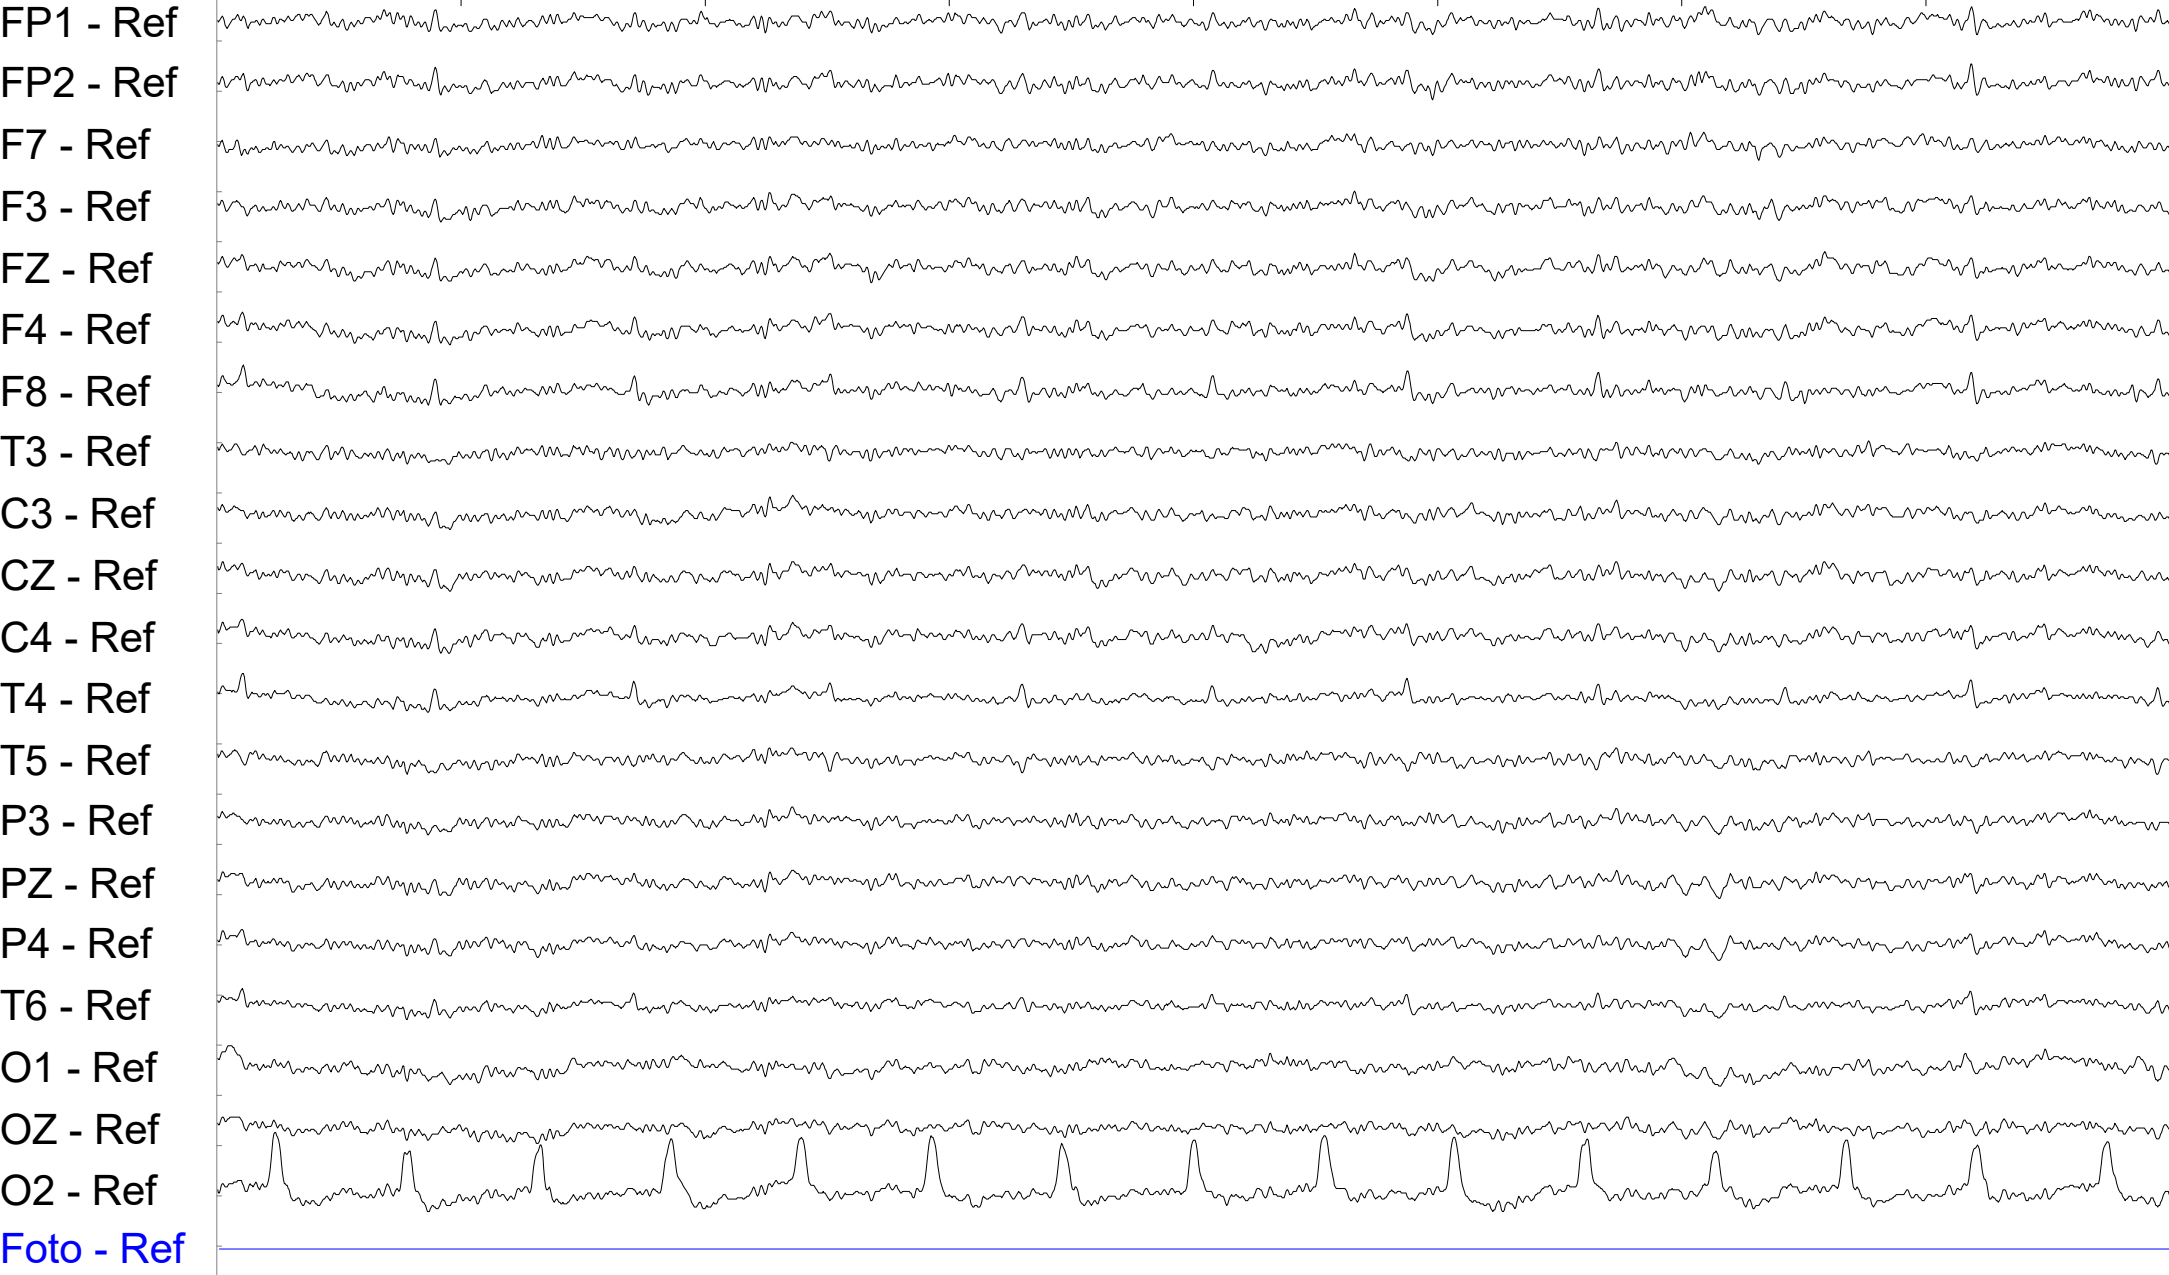

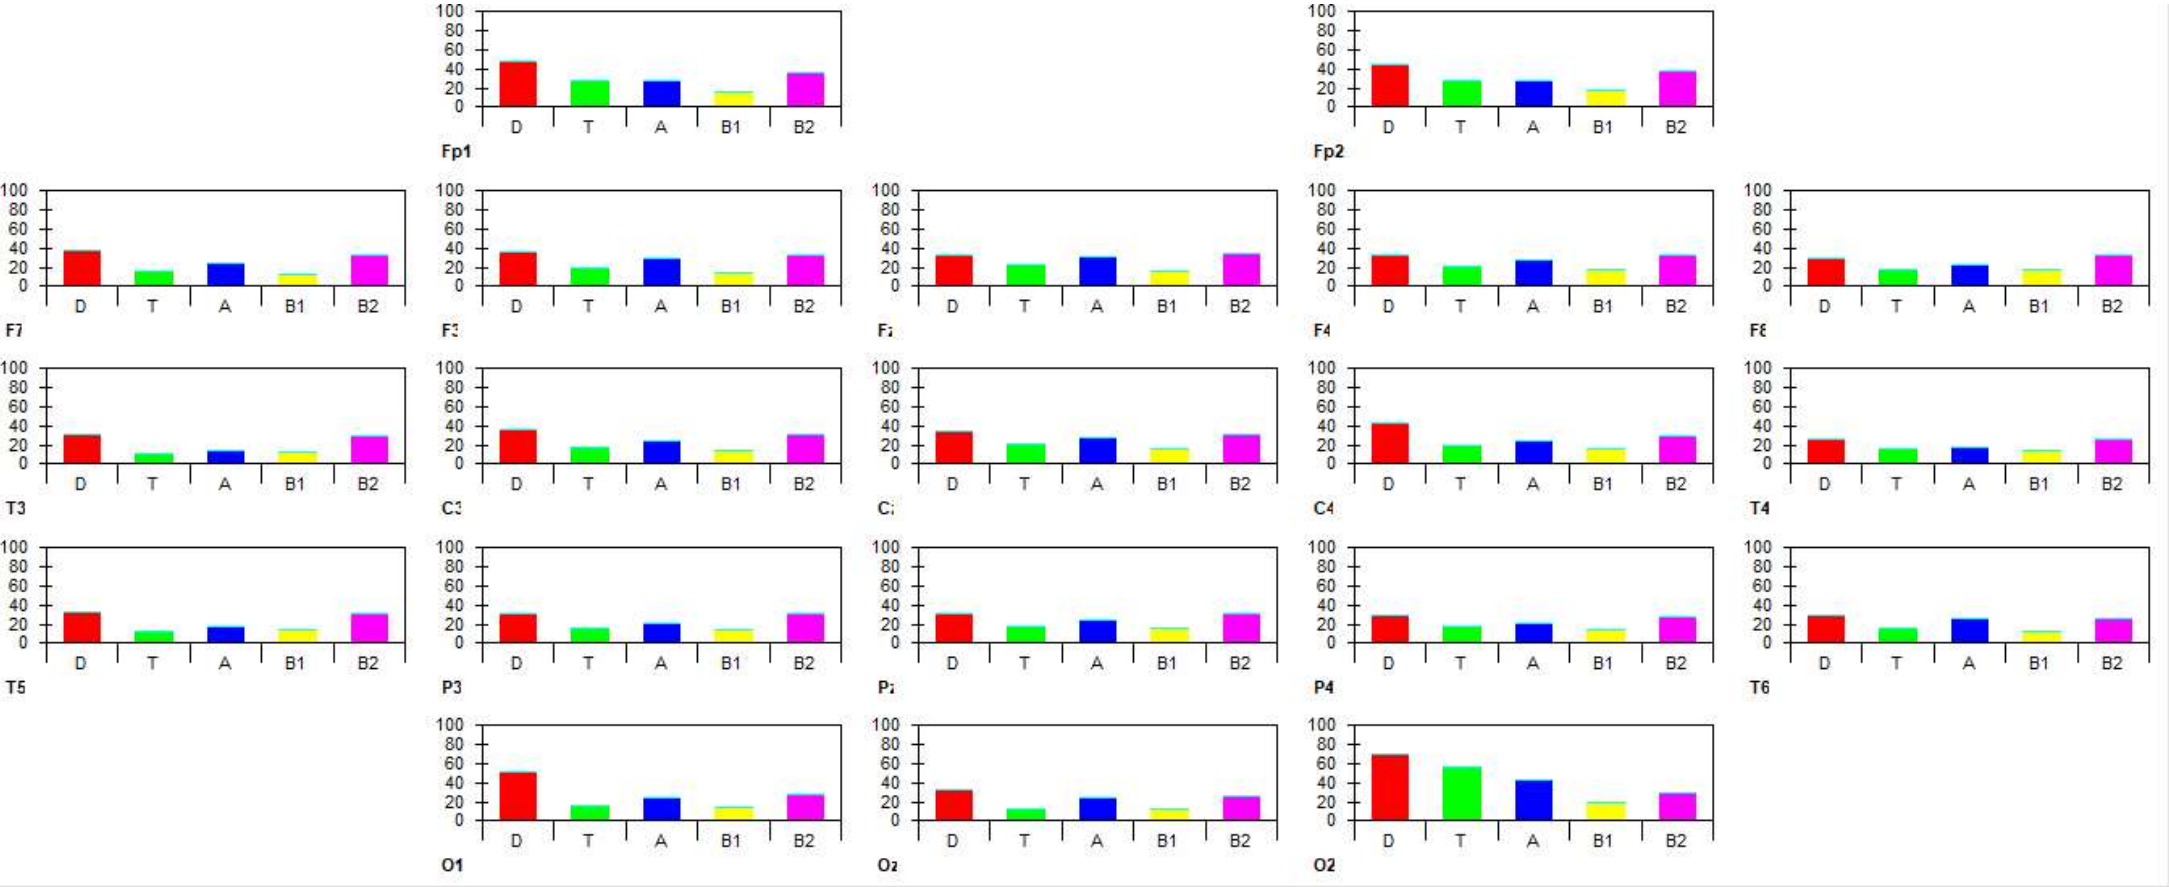

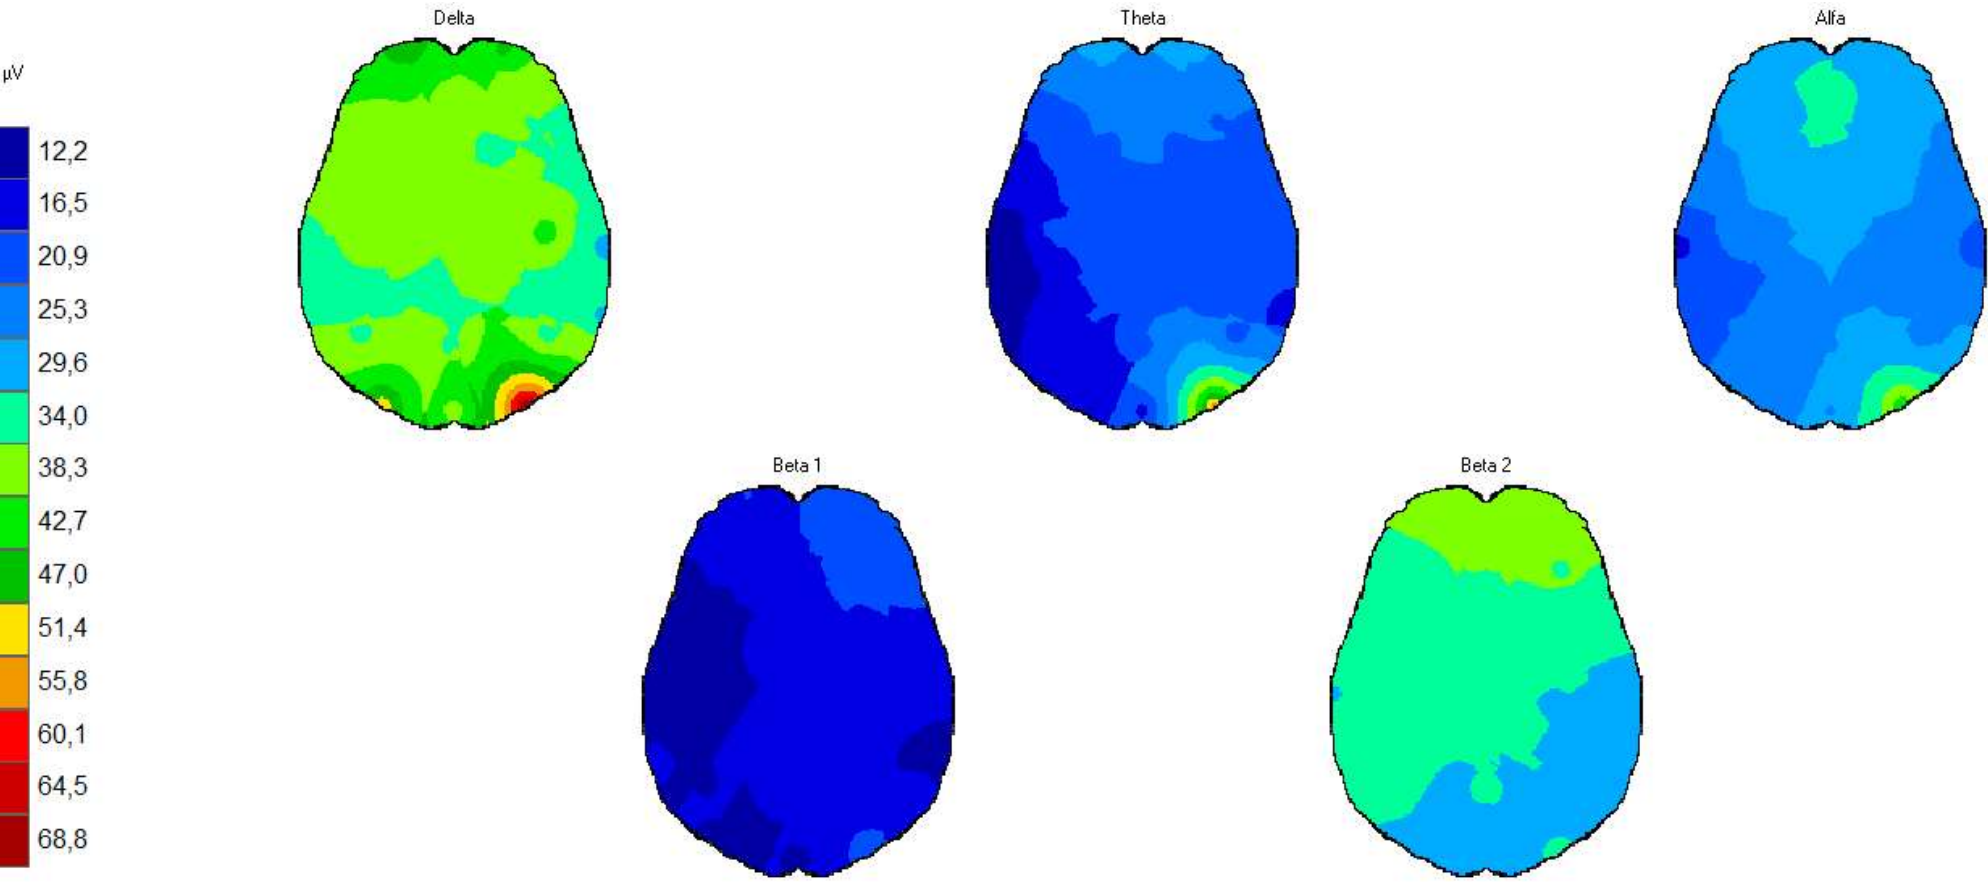

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2.0	47.6	30.4
T	4.0	27.8	17.8
A	9.5	28.3	18.1
B1	14.0	16.7	10.6
B2	20.0	36.2	23.1

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2.0	44.9	28.8
T	4.0	28.3	18.0
A	9.5	28.3	18.0
B1	15.5	17.2	10.9
B2	18.5	38.4	24.5

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	37.7	30.8
T	4.0	15.8	12.9
A	9.5	23.7	19.3
B1	13.5	13.1	10.7
B2	24.0	32.3	26.3

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	36.3	27.1
T	4.0	20.0	14.9
A	9.5	29.8	22.3
B1	15.0	14.4	10.8
B2	18.5	33.3	24.9

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	33.7	24.4
T	7.0	22.4	16.2
A	9.5	31.3	22.7
B1	15.5	16.3	11.8
B2	18.5	34.3	24.9

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2.0	33.7	25.4
T	4.5	20.4	15.4
A	9.0	28.3	21.3
B1	15.5	16.9	12.7
B2	18.5	33.6	25.3

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.5	29.8	24.4
T	4.0	18.4	15.1
A	9.5	23.3	19.1
B1	15.5	17.3	14.2
B2	18.5	33.2	27.2

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	31.0	31.9
T	4.0	10.4	10.7
A	9.5	13.8	14.2
B1	13.5	12.8	13.2
B2	24.0	29.2	30.1

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	37.1	29.8
T	4.0	17.3	13.9
A	9.5	24.8	19.9
B1	17.5	13.9	11.2
B2	18.5	31.3	25.1

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	34.0	26.2
T	7.0	20.8	15.8
A	9.5	28.1	21.6
B1	15.5	15.6	12.0
B2	18.5	31.6	24.4

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	42.3	32.2
T	7.5	19.7	14.9
A	9.0	23.8	18.1
B1	15.0	15.6	11.9
B2	19.5	30.2	23.0

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	26.9	26.4
T	4.0	16.8	16.3
A	10.5	17.5	17.2
B1	15.0	14.5	14.3
B2	19.5	26.3	25.8

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	32.9	30.2
T	4.0	12.3	11.3
A	9.0	18.2	16.7
B1	17.5	15.1	13.9
B2	18.5	30.4	27.9

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	31.9	27.7
T	7.5	18.7	14.4
A	9.0	21.3	18.5
B1	17.5	14.1	12.2
B2	19.0	31.2	27.1

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	32.0	26.6
T	7.5	18.2	15.1
A	9.5	24.0	20.0
B1	17.0	15.7	13.1
B2	18.5	30.4	25.3

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	30.3	27.0
T	7.5	17.3	15.4
A	10.0	21.5	19.2
B1	15.0	14.5	12.9
B2	19.5	28.5	25.4

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	28.9	26.6
T	4.0	15.2	14.0
A	9.5	25.5	23.4
B1	14.5	13.2	12.1
B2	19.5	28.0	23.9

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	.5	51.7	39.1
T	5.0	15.3	11.8
A	9.5	24.3	18.3
B1	17.5	13.7	10.4
B2	21.5	27.3	20.6

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1.0	32.9	29.9
T	6.5	13.0	11.8
A	9.5	24.2	22.0
B1	17.5	13.3	12.1
B2	21.5	26.7	24.2

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2.0	71.0	32.3
T	4.0	56.4	25.6
A	9.5	43.6	19.8
B1	15.0	18.7	8.5
B2	20.5	30.4	13.8

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	2,0	47,6	30,4	4,0	27,8	17,8	9,5	28,3	18,1	14,0	16,7	10,6	20,0	36,2	23,1
FP2	2,0	44,9	28,6	4,0	28,3	18,0	9,5	28,3	18,0	15,5	17,2	10,9	18,5	38,4	24,5
F7	1,0	37,7	30,8	4,0	15,8	12,9	9,5	23,7	19,3	13,5	13,1	10,7	24,0	32,3	26,3
F3	1,0	36,3	27,1	4,0	20,0	14,9	9,5	29,8	22,3	15,0	14,4	10,8	18,5	33,3	24,9
FZ	1,0	33,7	24,4	7,0	22,4	16,2	9,5	31,3	22,7	15,5	16,3	11,8	18,5	34,3	24,9
F4	2,0	33,7	25,4	4,5	20,4	15,4	9,0	28,3	21,3	15,5	16,9	12,7	18,5	33,6	25,3
F8	1,5	29,8	24,4	4,0	18,4	15,1	9,5	23,3	19,1	15,5	17,3	14,2	18,5	33,2	27,2
T3	1,0	31,0	31,9	4,0	10,4	10,7	9,5	13,8	14,2	13,5	12,8	13,2	24,0	29,2	30,1
C3	1,0	37,1	29,8	4,0	17,3	13,9	9,5	24,8	19,9	17,5	13,9	11,2	18,5	31,3	25,1
CZ	1,0	34,0	26,2	7,0	20,6	15,8	9,5	28,1	21,6	15,5	15,6	12,0	18,5	31,6	24,4
C4	1,0	42,3	32,2	7,5	19,7	14,9	9,0	23,8	18,1	15,0	15,6	11,9	19,5	30,2	23,0
T4	1,0	26,9	26,4	4,0	16,6	16,3	10,5	17,5	17,2	15,0	14,5	14,3	19,5	26,3	25,8
T5	1,0	32,9	30,2	4,0	12,3	11,3	9,0	18,2	16,7	17,5	15,1	13,9	18,5	30,4	27,9
P3	1,0	31,9	27,7	7,5	16,7	14,4	9,0	21,3	18,5	17,5	14,1	12,2	19,0	31,2	27,1
PZ	1,0	32,0	26,6	7,5	18,2	15,1	9,5	24,0	20,0	17,0	15,7	13,1	18,5	30,4	25,3
P4	1,0	30,3	27,0	7,5	17,3	15,4	10,0	21,5	19,2	15,0	14,5	12,9	19,5	28,5	25,4
T6	1,0	28,9	26,6	4,0	15,2	14,0	9,5	25,5	23,4	14,5	13,2	12,1	19,5	26,0	23,9
O1	,5	51,7	39,1	5,0	15,3	11,6	9,5	24,3	18,3	17,5	13,7	10,4	21,5	27,3	20,6
OZ	1,0	32,9	29,9	6,5	13,0	11,8	9,5	24,2	22,0	17,5	13,3	12,1	21,5	26,7	24,2
O2	2,0	71,0	32,3	4,0	56,4	25,6	9,5	43,6	19,8	15,0	18,7	8,5	20,5	30,4	13,8

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	2,0	47,6	30,4	4,0	27,8	17,8	9,5	28,3	18,1	14,0	16,7	10,6	20,0	36,2	23,1
FP2	2,0	44,9	28,6	4,0	28,3	18,0	9,5	28,3	18,0	15,5	17,2	10,9	18,5	38,4	24,5
F7	1,0	37,7	30,8	4,0	15,8	12,9	9,5	23,7	19,3	13,5	13,1	10,7	24,0	32,3	26,3
F3	1,0	36,3	27,1	4,0	20,0	14,9	9,5	29,8	22,3	15,0	14,4	10,8	18,5	33,3	24,9
FZ	1,0	33,7	24,4	7,0	22,4	16,2	9,5	31,3	22,7	15,5	16,3	11,8	18,5	34,3	24,9
F4	2,0	33,7	25,4	4,5	20,4	15,4	9,0	28,3	21,3	15,5	16,9	12,7	18,5	33,6	25,3
F8	1,5	29,8	24,4	4,0	18,4	15,1	9,5	23,3	19,1	15,5	17,3	14,2	18,5	33,2	27,2
T3	1,0	31,0	31,9	4,0	10,4	10,7	9,5	13,8	14,2	13,5	12,8	13,2	24,0	29,2	30,1
C3	1,0	37,1	29,8	4,0	17,3	13,9	9,5	24,8	19,9	17,5	13,9	11,2	18,5	31,3	25,1
CZ	1,0	34,0	26,2	7,0	20,6	15,8	9,5	28,1	21,6	15,5	15,6	12,0	18,5	31,6	24,4
C4	1,0	42,3	32,2	7,5	19,7	14,9	9,0	23,8	18,1	15,0	15,6	11,9	19,5	30,2	23,0
T4	1,0	26,9	26,4	4,0	16,6	16,3	10,5	17,5	17,2	15,0	14,5	14,3	19,5	26,3	25,8
T5	1,0	32,9	30,2	4,0	12,3	11,3	9,0	18,2	16,7	17,5	15,1	13,9	18,5	30,4	27,9
P3	1,0	31,9	27,7	7,5	16,7	14,4	9,0	21,3	18,5	17,5	14,1	12,2	19,0	31,2	27,1
PZ	1,0	32,0	26,6	7,5	18,2	15,1	9,5	24,0	20,0	17,0	15,7	13,1	18,5	30,4	25,3
P4	1,0	30,3	27,0	7,5	17,3	15,4	10,0	21,5	19,2	15,0	14,5	12,9	19,5	28,5	25,4
T6	1,0	28,9	26,6	4,0	15,2	14,0	9,5	25,5	23,4	14,5	13,2	12,1	19,5	26,0	23,9
O1	,5	51,7	39,1	5,0	15,3	11,6	9,5	24,3	18,3	17,5	13,7	10,4	21,5	27,3	20,6
OZ	1,0	32,9	29,9	6,5	13,0	11,8	9,5	24,2	22,0	17,5	13,3	12,1	21,5	26,7	24,2
O2	2,0	71,0	32,3	4,0	56,4	25,6	9,5	43,6	19,8	15,0	18,7	8,5	20,5	30,4	13,8

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	14:43:41	02:04	Olhos fechados
5	14:45:44	02:07	Vigília
9	14:47:51	02:03	Olhos abertos
13	14:49:54	01:04	Foto Estimulação
13	14:50:00	00:00	Foto 1 hz
13	14:50:05	00:00	Foto 3 hz
14	14:50:10	00:00	Foto 6 hz
14	14:50:15	00:00	Foto Desativado
14	14:50:16	00:00	Foto 1 hz
14	14:50:18	00:00	Foto 1 hz
14	14:50:23	00:00	Foto 3 hz
14	14:50:28	00:00	Foto 6 hz
14	14:50:33	00:00	Foto Desativado
14	14:50:36	00:00	Foto 1 hz
14	14:50:37	00:00	Foto 1 hz
15	14:50:58	00:30	Olhos fechados
15	14:50:42	00:00	Foto 3 hz
15	14:50:47	00:00	Foto 6 hz
15	14:50:52	00:00	Foto Desativado
16	14:51:28	01:20	Hiperpneia
19	14:52:48	01:03	Pós hiperpneia
21	14:53:51	00:19	Vigília