




10:33:12 Olhos abertos 10:33:16 Olhos abertos 10:33:19 Olhos abertos 10:33:20 Olhos abertos 10:33:21 Olhos abertos 10:33:22 Olhos abertos 10:33:23 Olhos abertos 10:33:24 Olhos abertos


Época: 1 - Horário: 10:33:16 - Estágio: 0 (8 seg.)

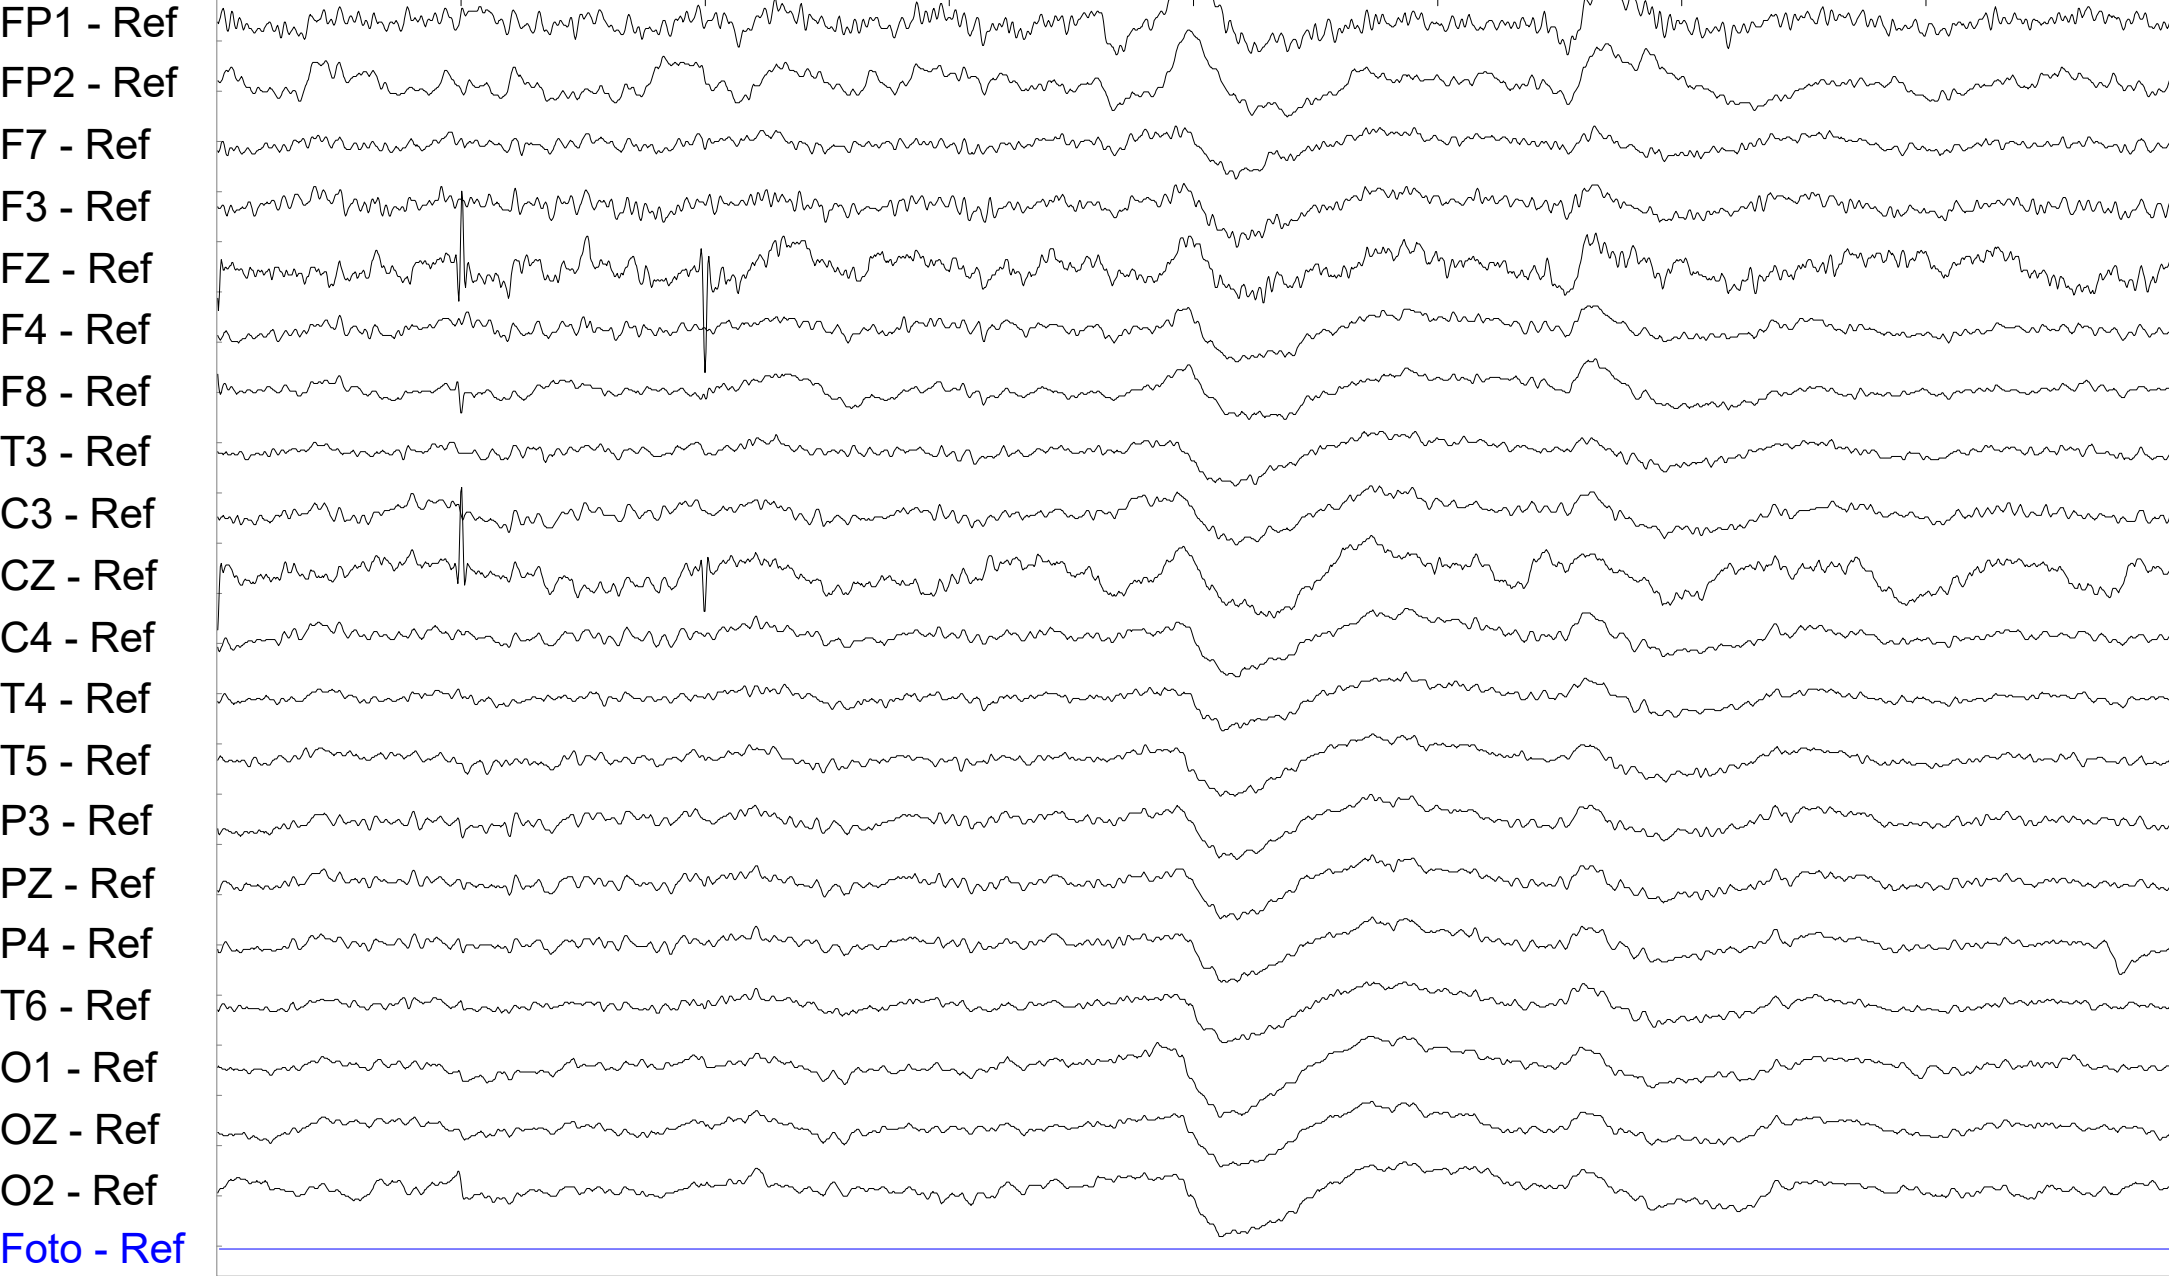




10:34:47 Olhos abertos 10:34:48 Olhos abertos 10:34:49 Olhos abertos 10:34:50 Olhos abertos 10:34:51 Olhos abertos 10:34:52 Olhos abertos 10:34:53 Olhos abertos 10:34:54 Olhos abertos
Época: 4 - Horário: 10:34:48 - Estágio: 0/8 seg.)

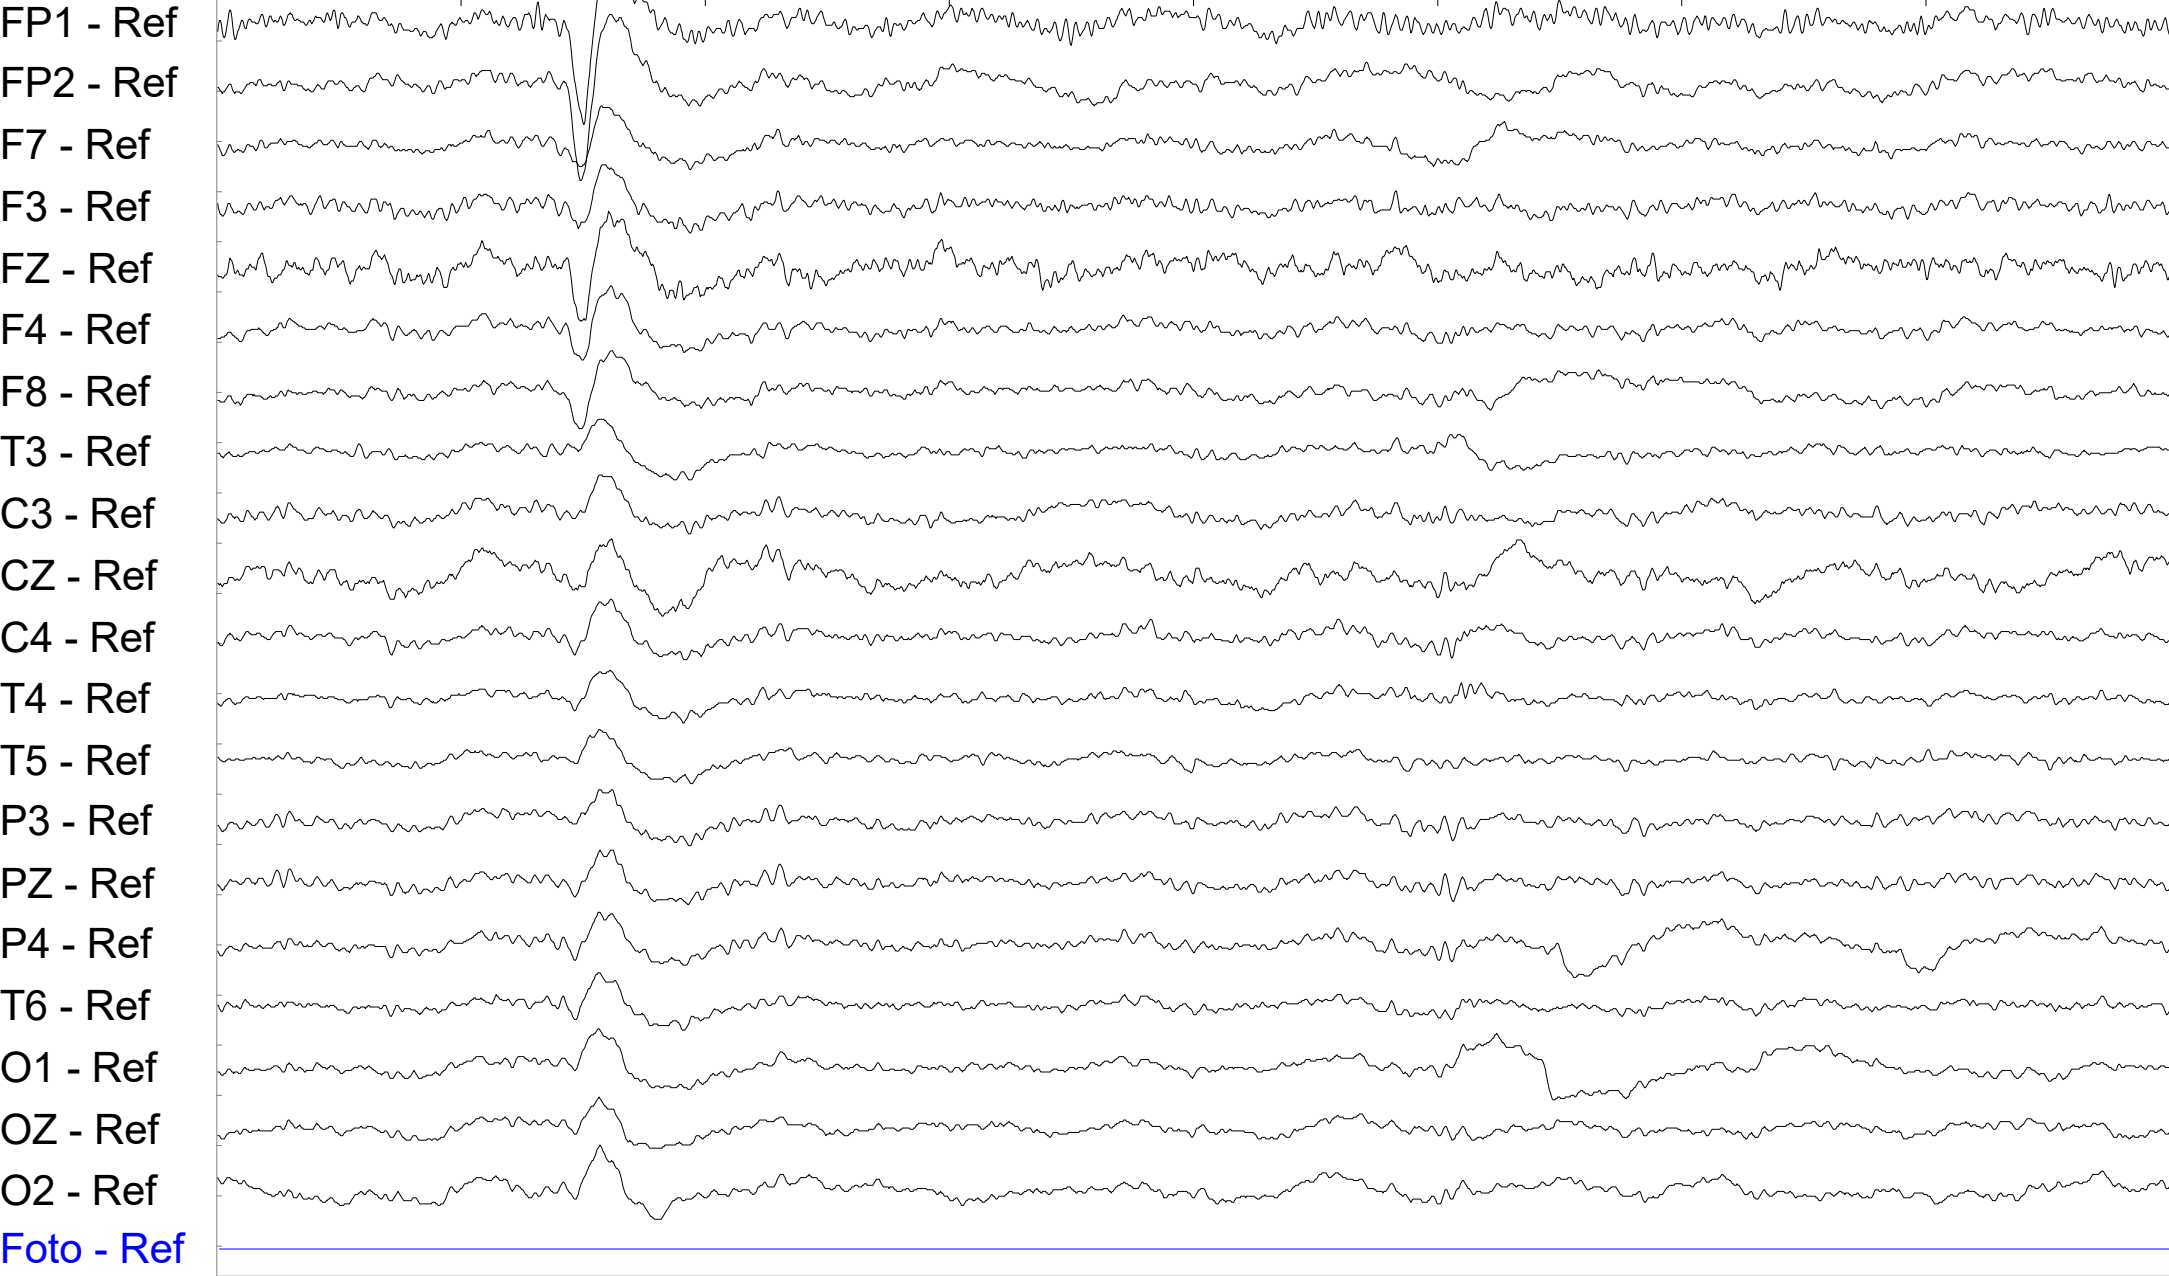



10:36:17	10:36:18	10:36:19	10:36:20	10:36:21	10:36:22	10:36:23	10:36:24
Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados	Olhos fechados

Época: 7 - Horário: 10:36:18 - Estágio: 0 (8 seg.)

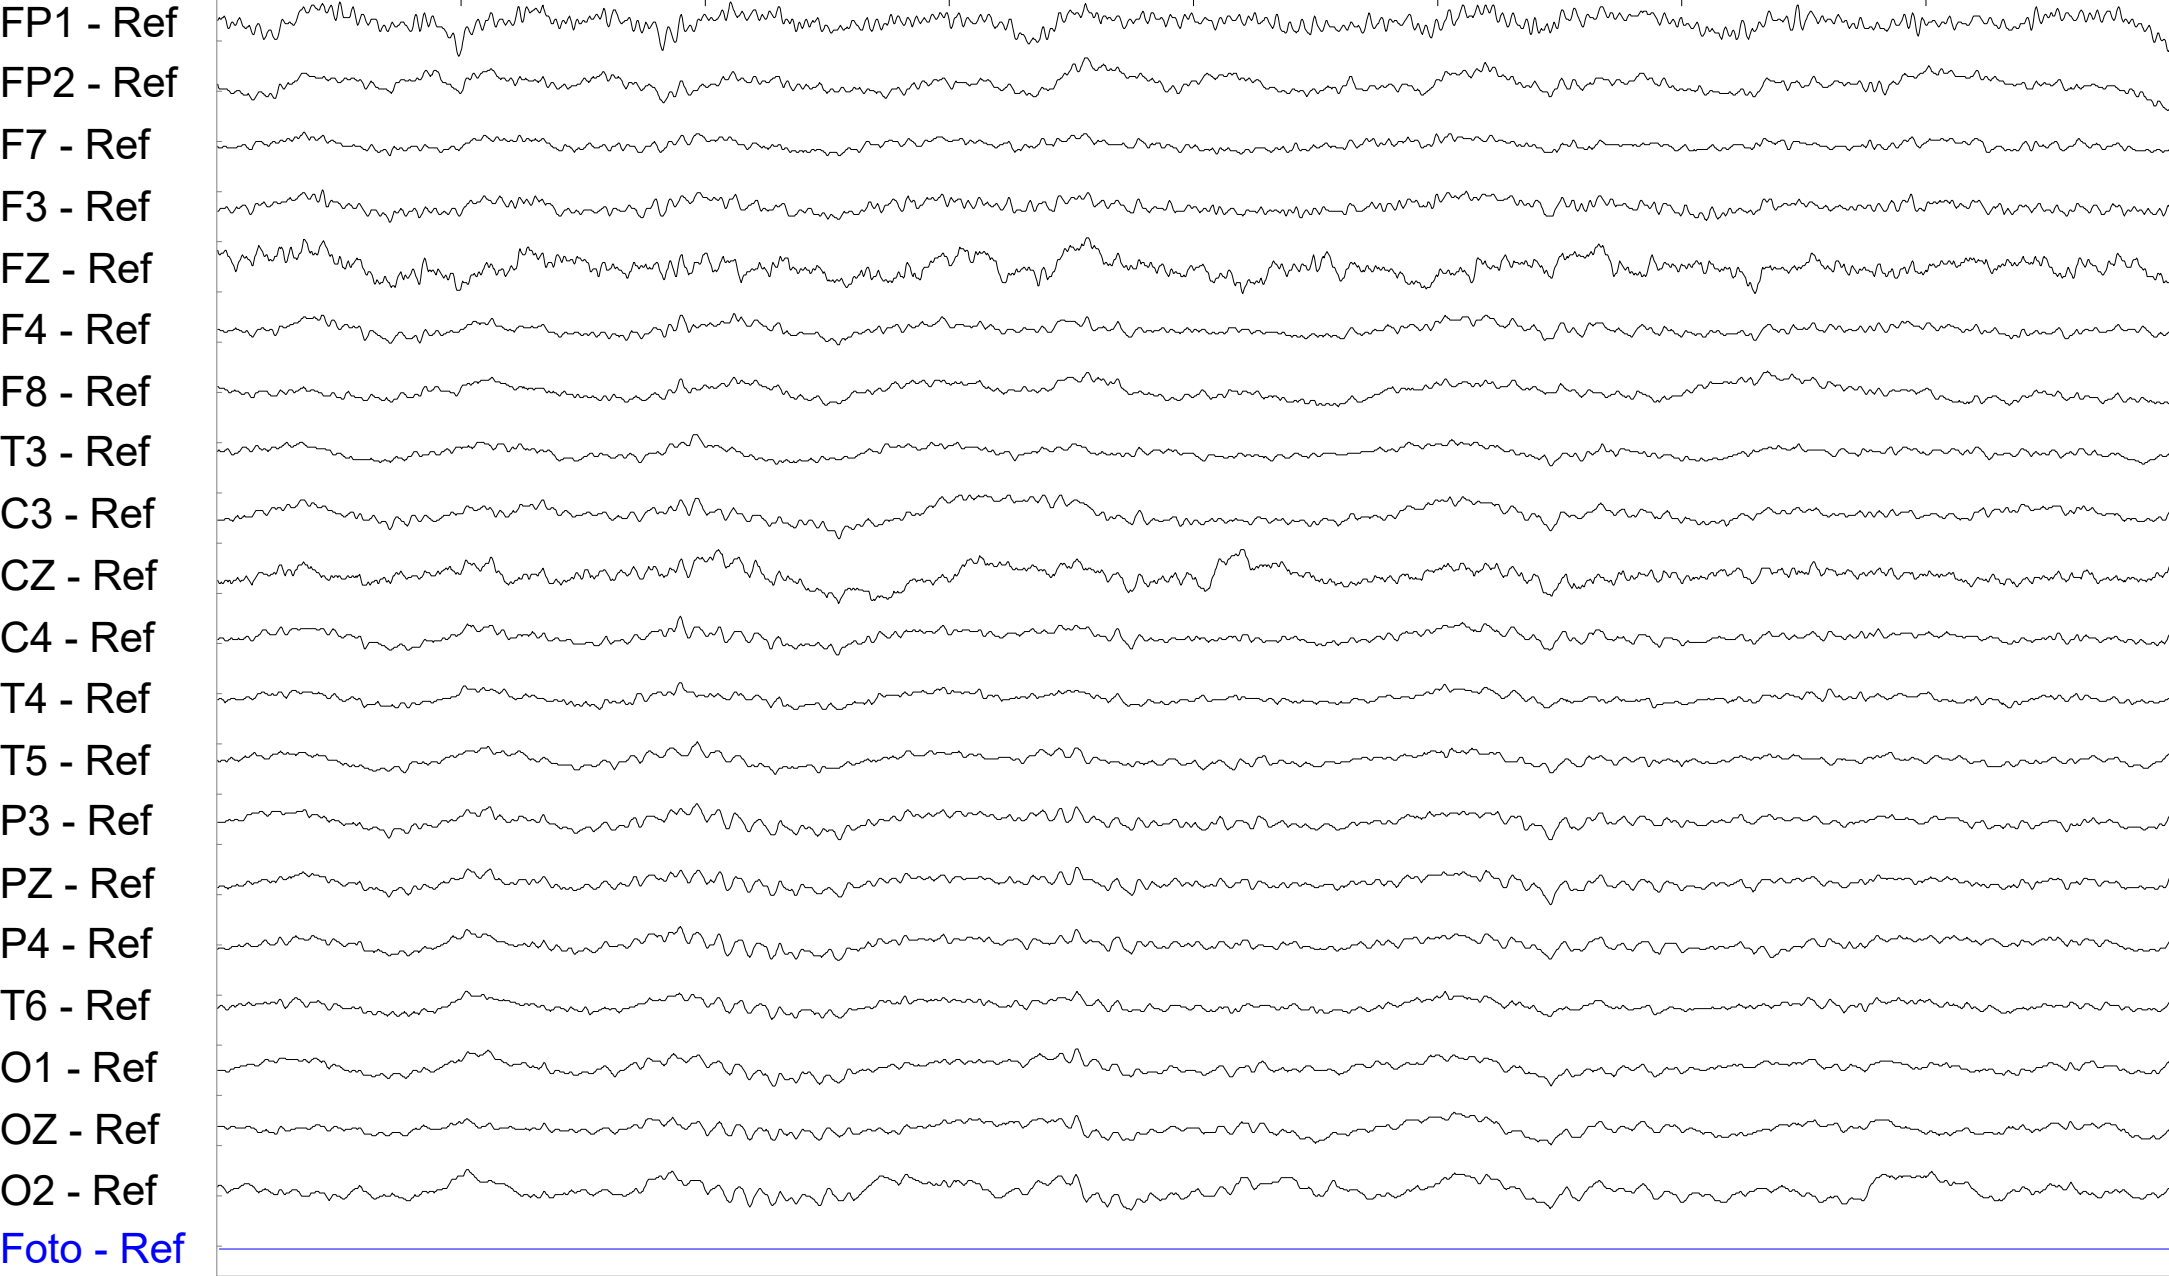



NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 9/21

10:37:17 Olhos fechados 10:37:18 Olhos fechados 10:37:19 Olhos fechados 10:37:20 Olhos fechados 10:37:21 Olhos fechados 10:37:22 Olhos fechados 10:37:23 Olhos fechados 10:37:24 Olhos fechados
Época: 9 - Horário: 10:37:18 - Estágio: 0 (8 seg.)

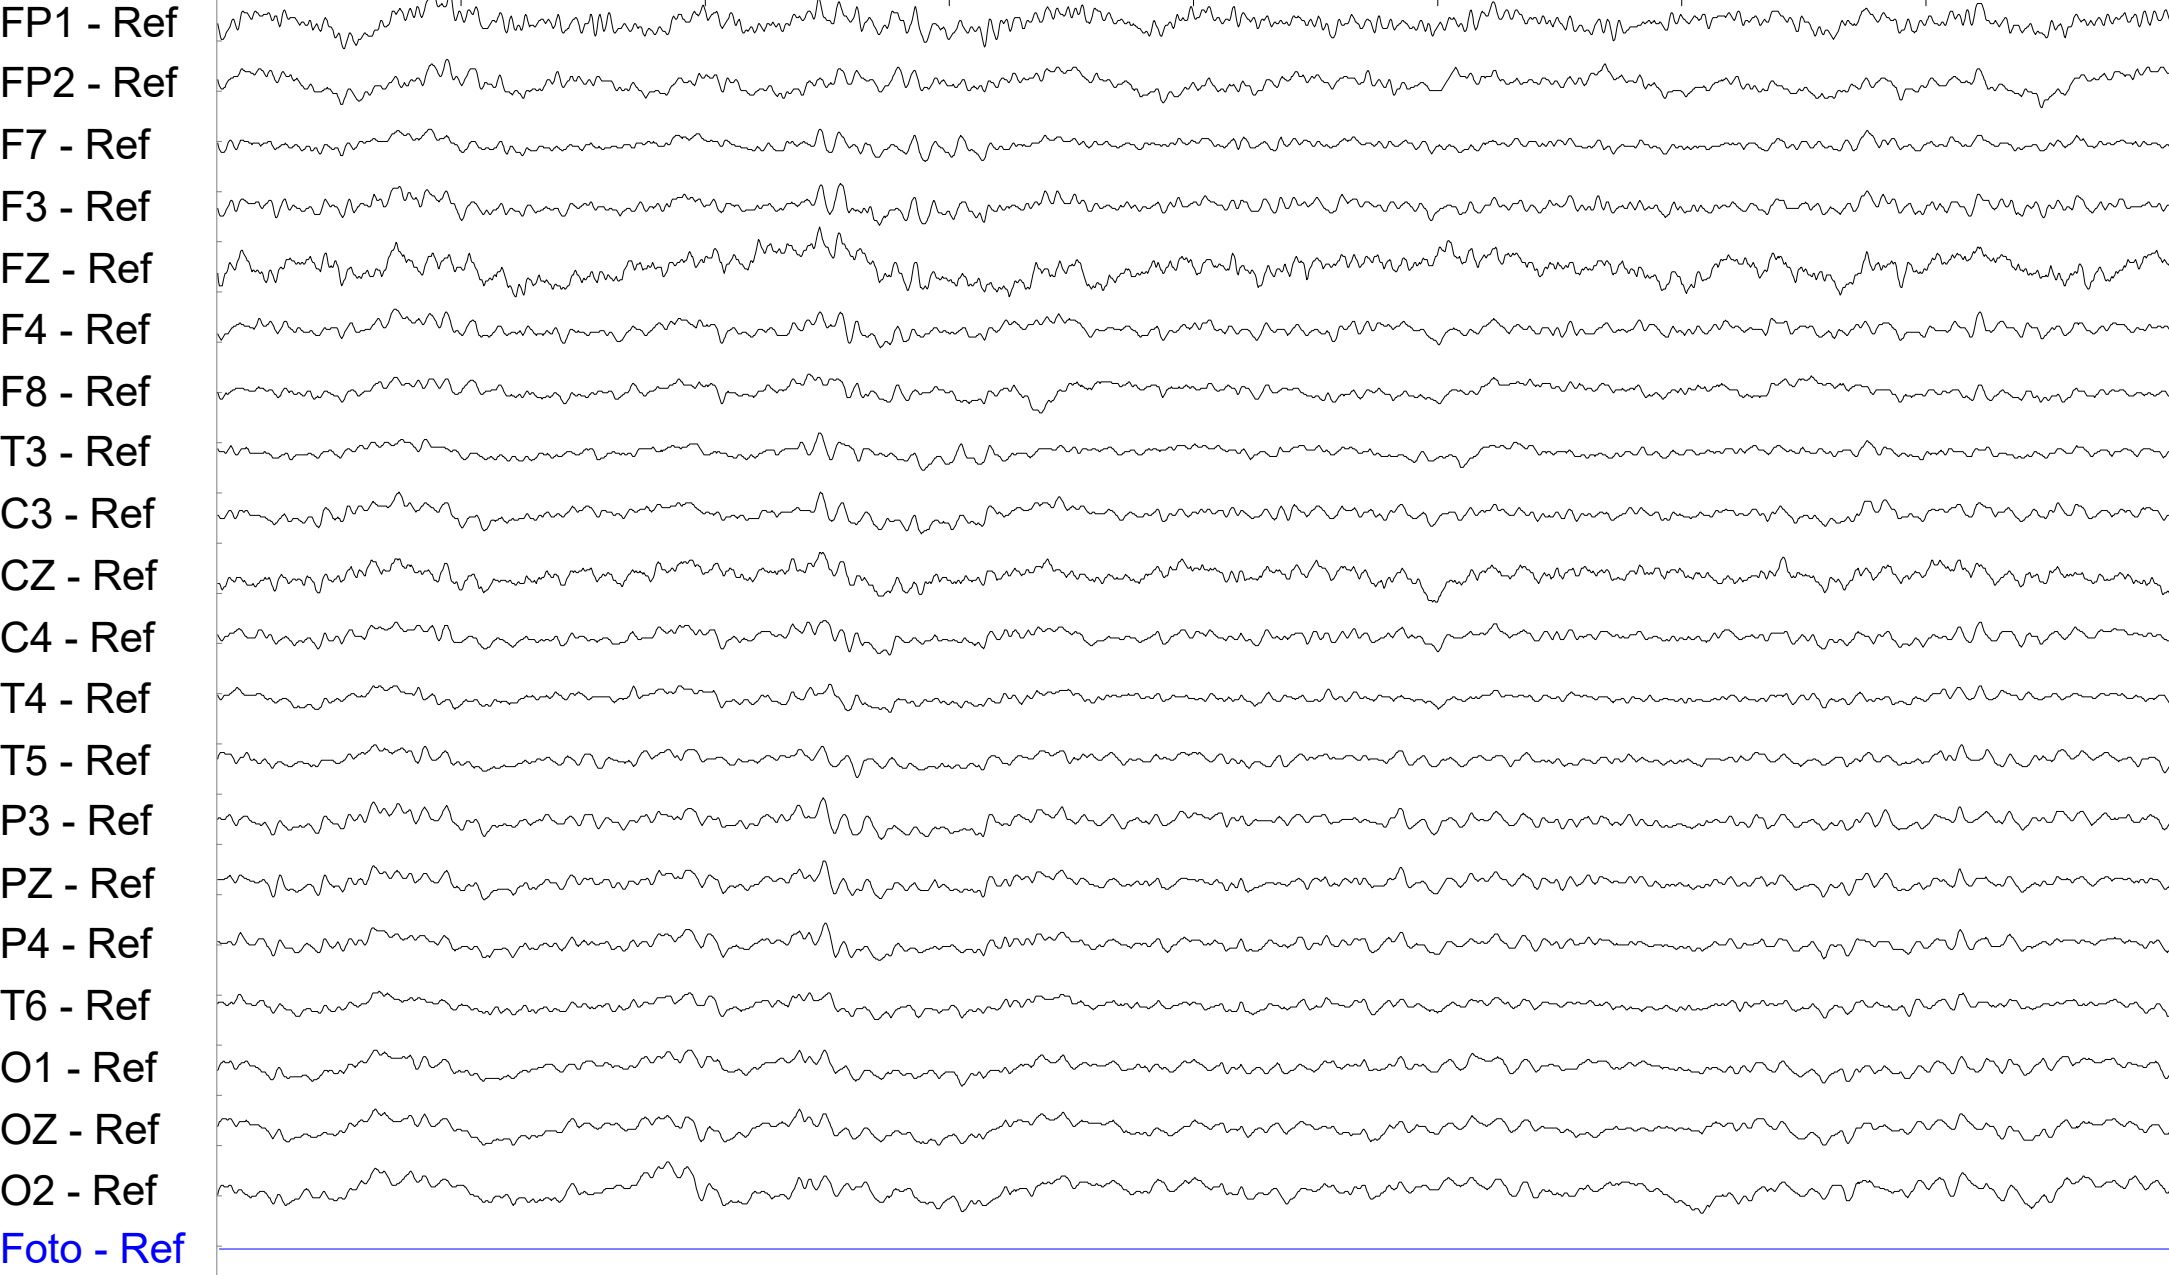



10:38:46

Vigília

10:38:47

Vigília

10:38:48

Vigília

10:38:49

Vigília

10:38:50

Vigília

10:38:51

Vigília


10:38:52

Vigília

10:38:53

Vigília

Época: 12 - Horário: 10:38:47 - Estágio: 0 (8 seg.)

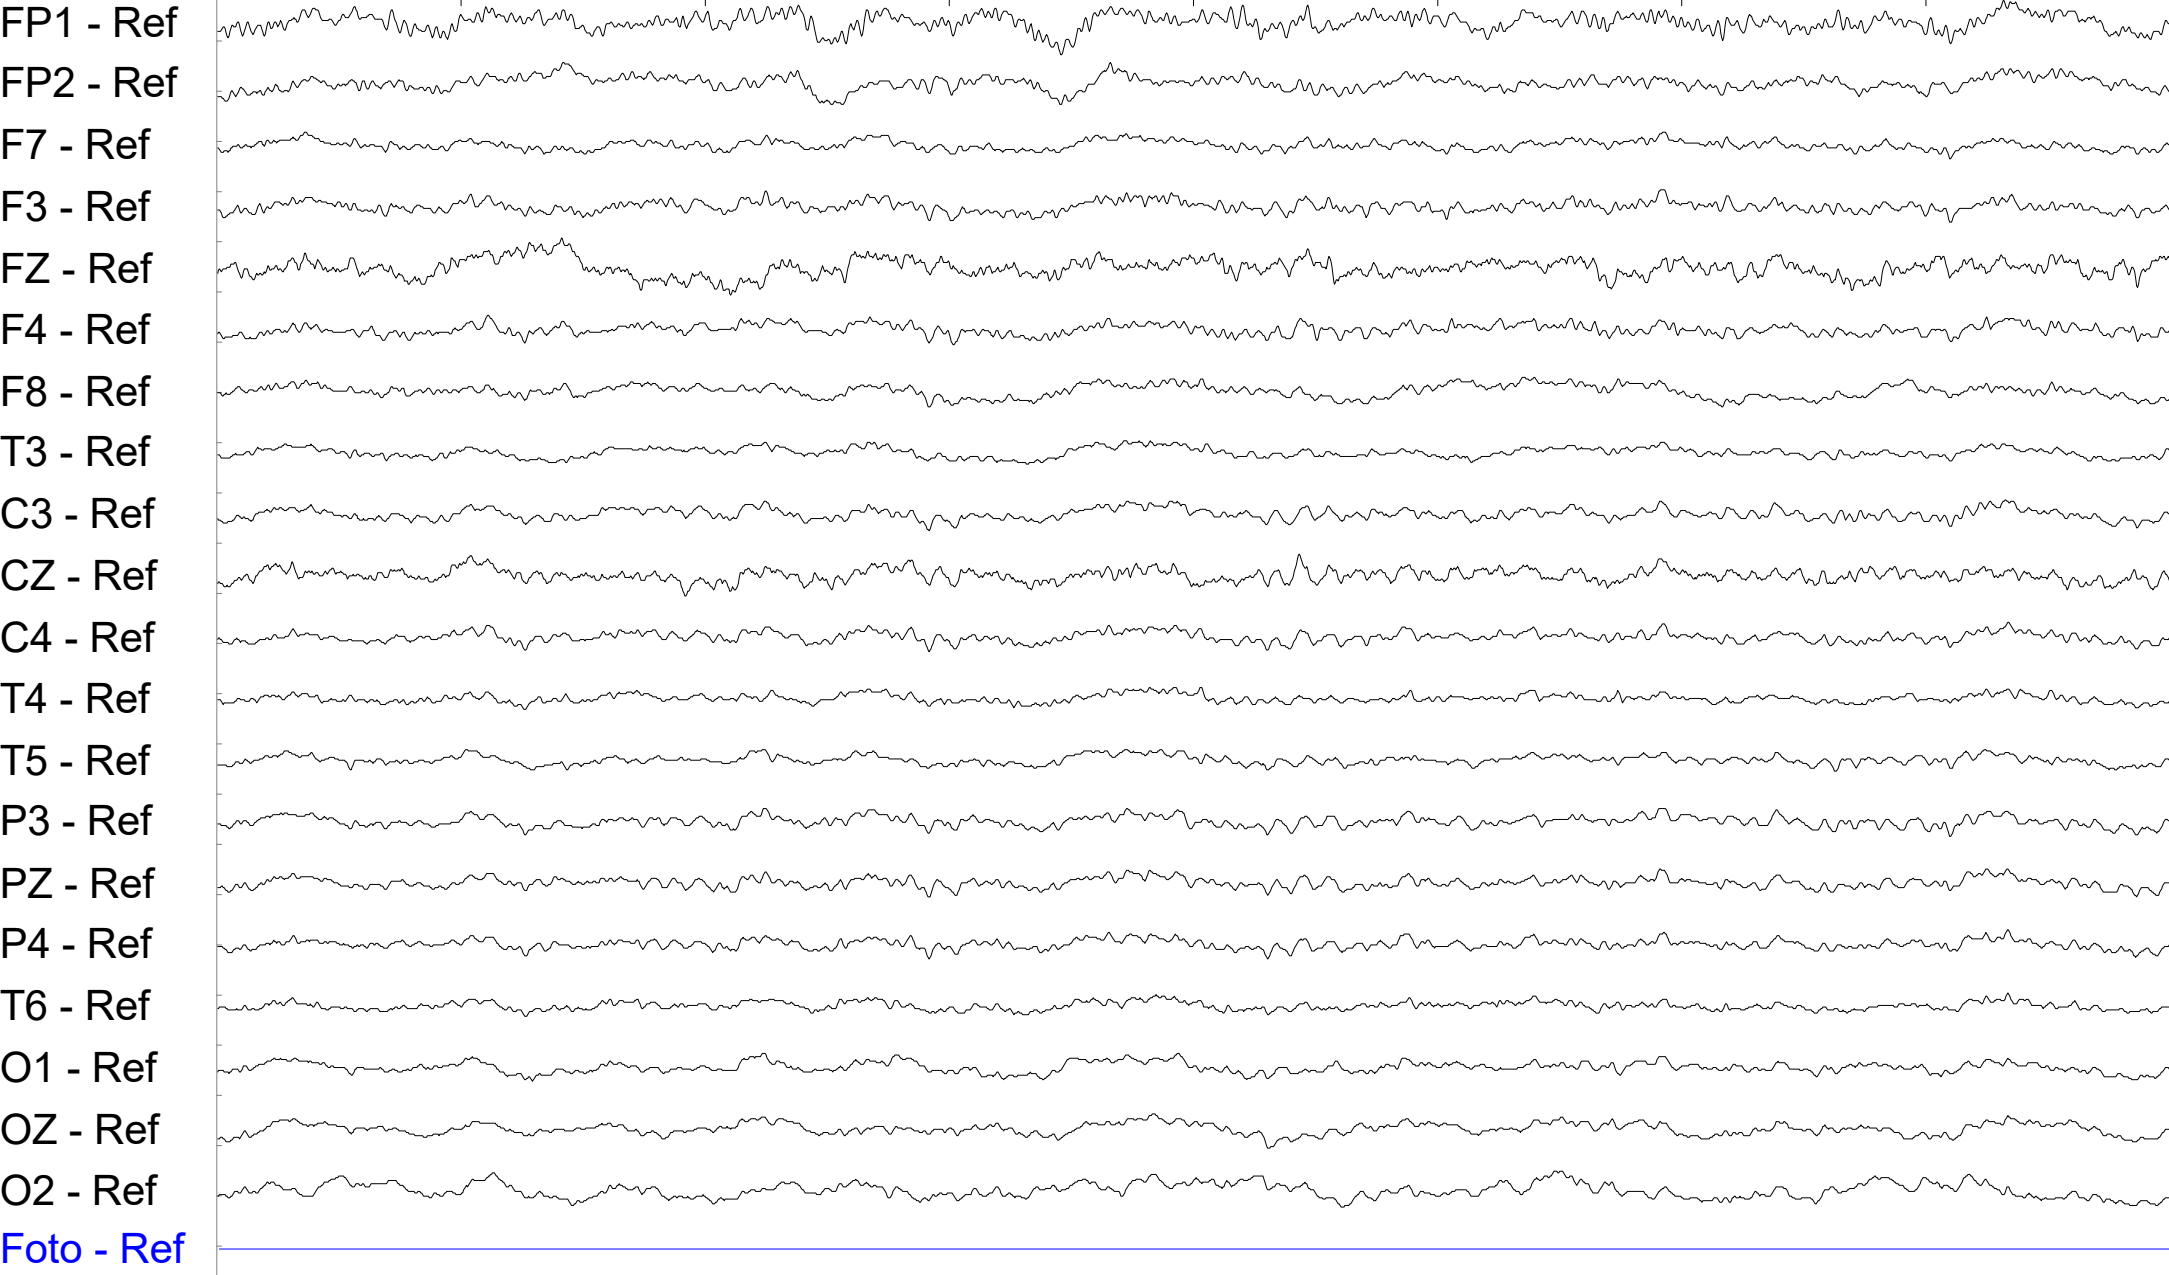


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 14/21

10:39:46 Foto Estimulação 10:39:47 Foto Estimulação 10:39:48 Foto Estimulação 10:39:49 Foto Estimulação 10:39:50 Foto Estimulação 10:39:51 Foto Estimulação 10:39:53 Foto Estimulação 10:39:53 Foto Estimulação
Época: 14 - Horário: 10:39:47 - Estágio: 0 (8 seg.)

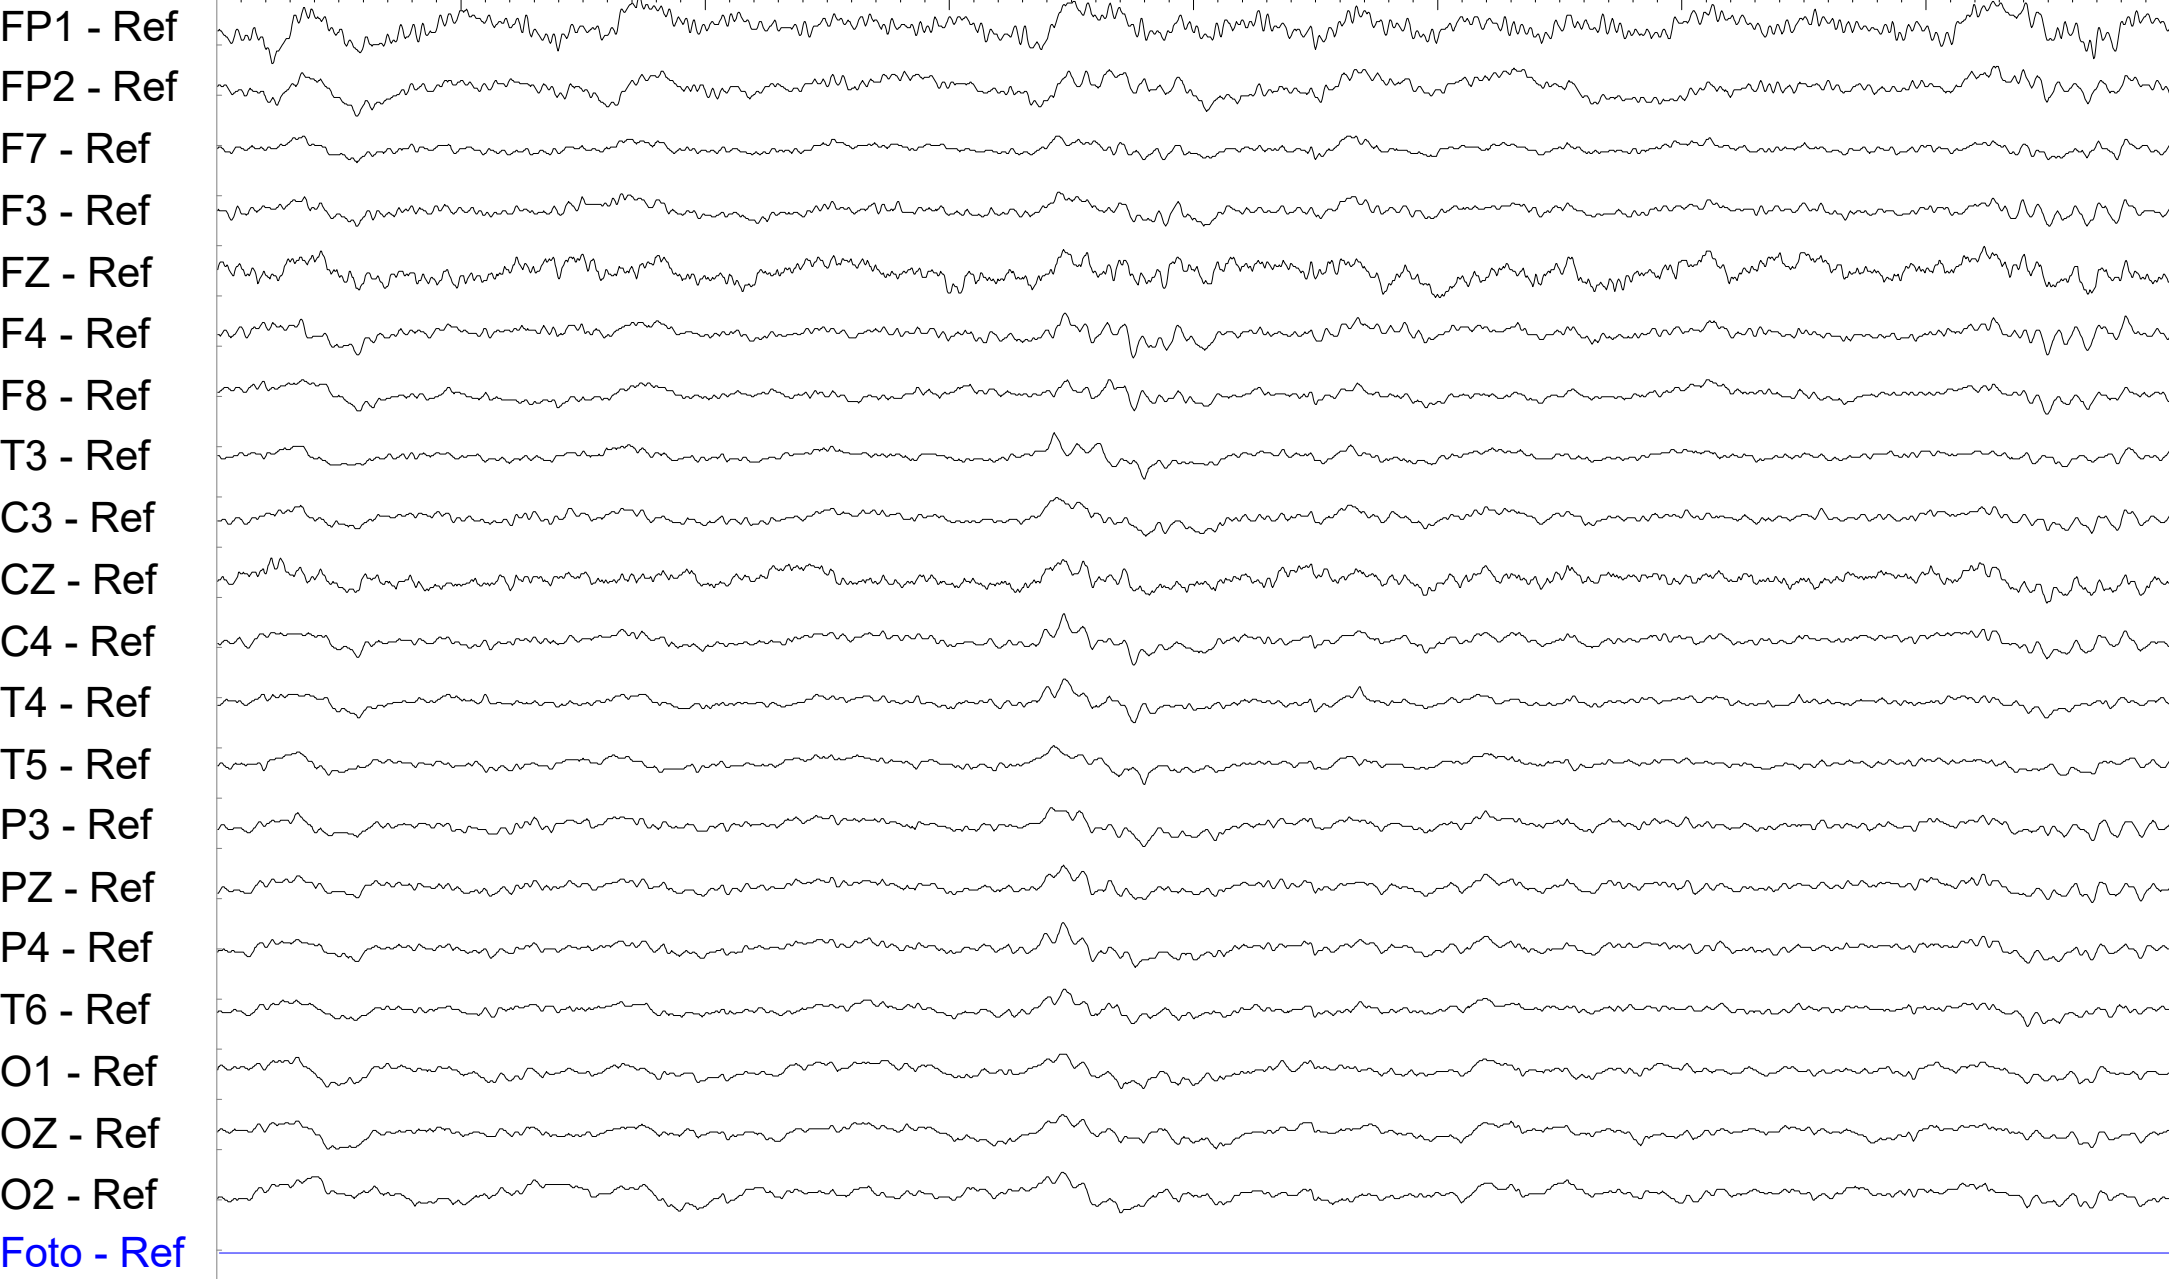


NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 15/21


10:40:16 Foto Estimulação 10:40:17 Foto Estimulação 10:40:18 Foto Estimulação 10:40:19 Foto Estimulação 10:40:20 Foto Estimulação 10:40:21 Foto Estimulação 10:40:22 Foto Estimulação 10:40:23 Olhos fechados
Época: 15 - Horário: 10:40:17 - Estágio: 0 (8 seg.)

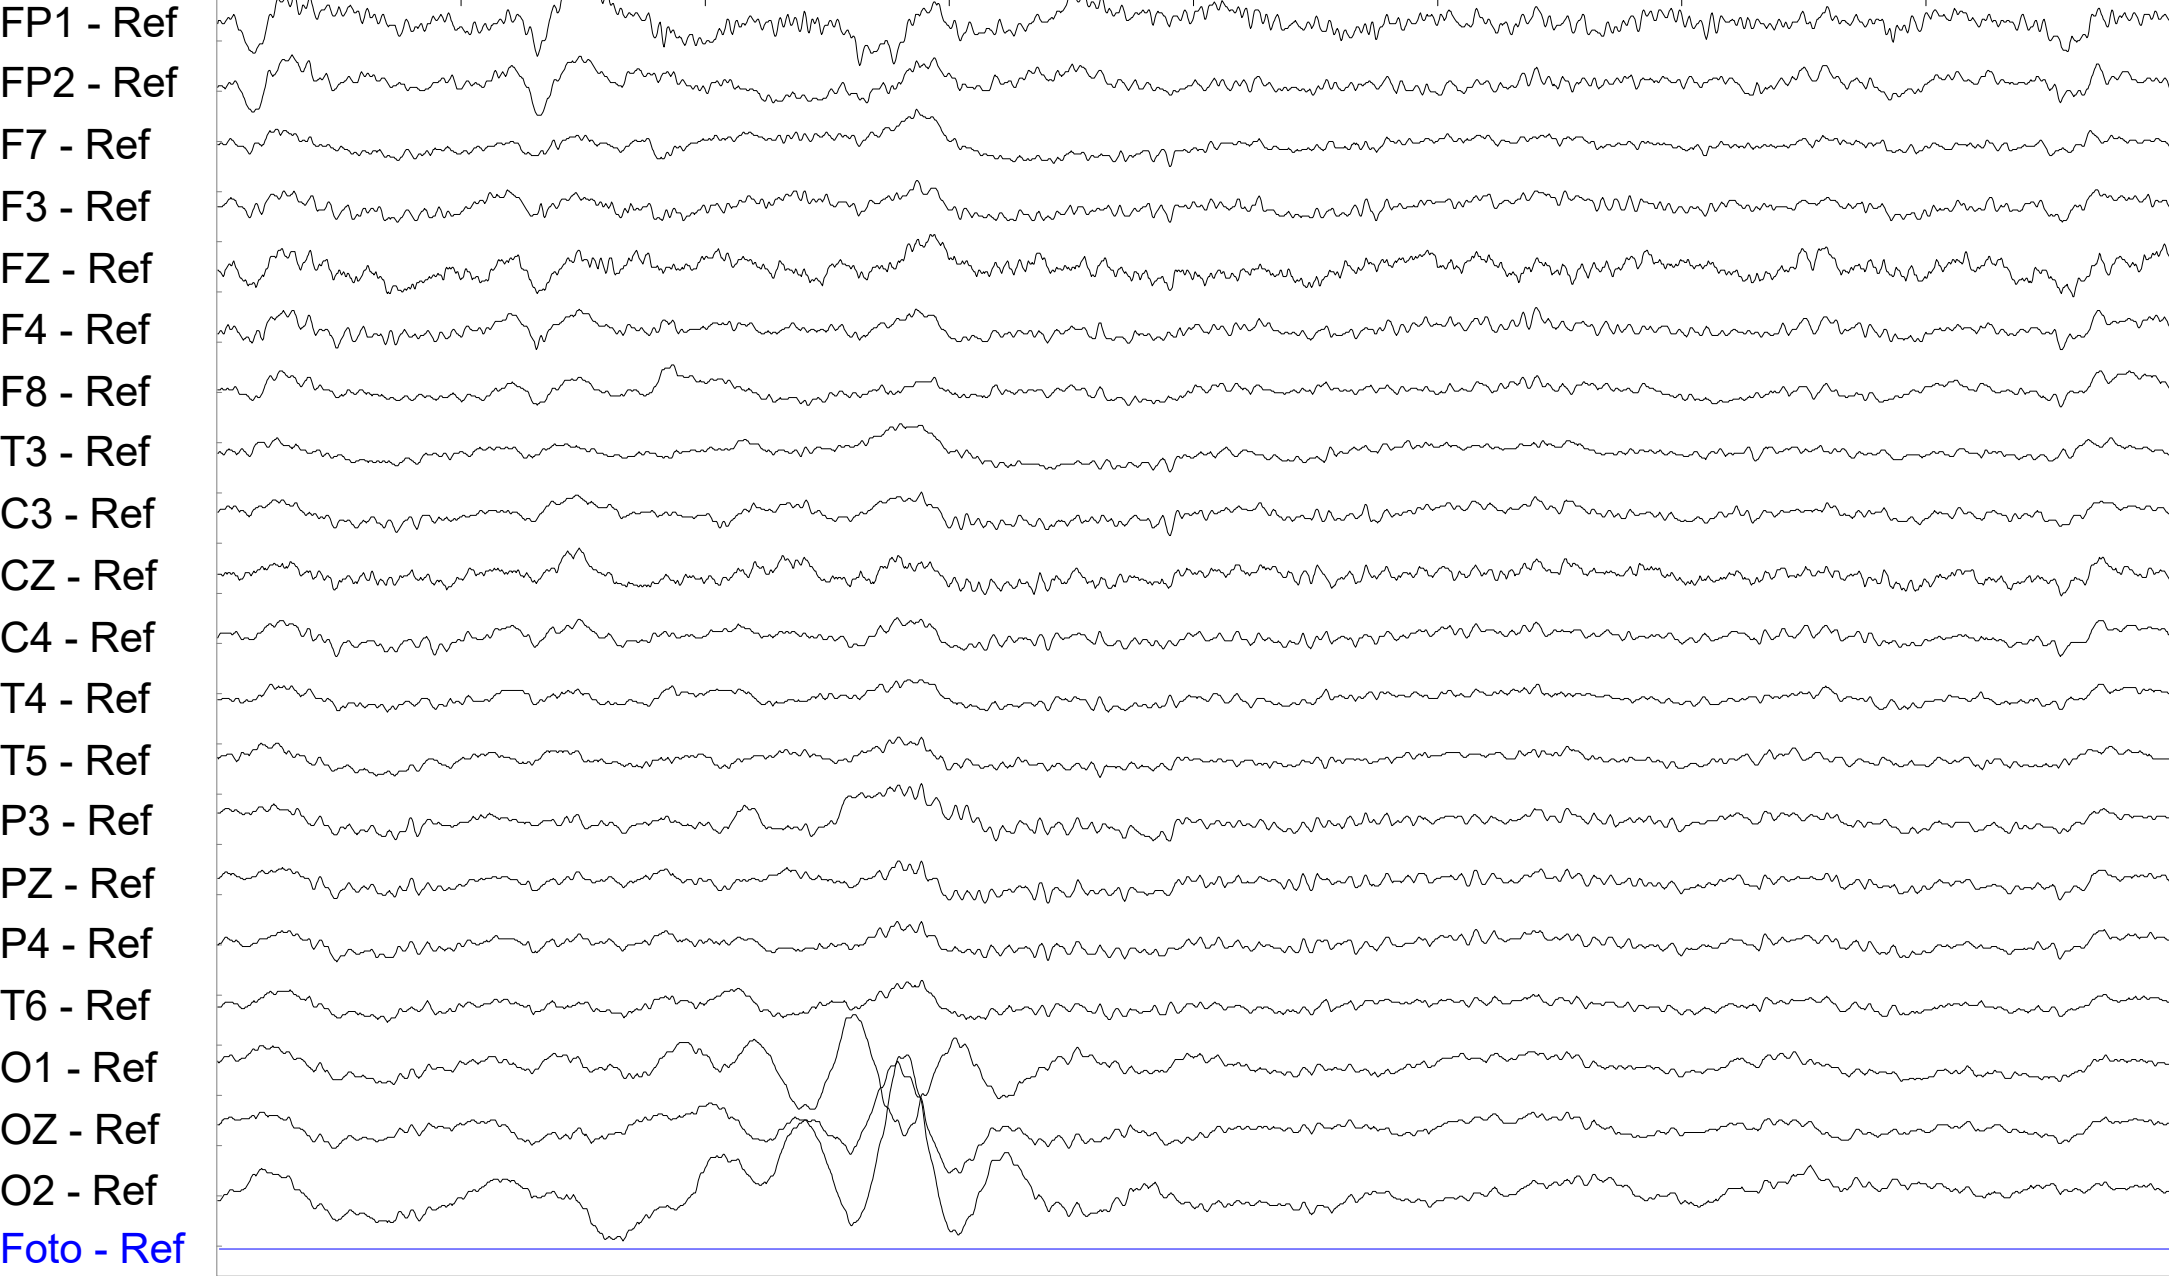

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

10:40:46 Olhos fechados 10:40:47 Olhos fechados 10:40:48 Olhos fechados 10:40:49 Olhos fechados 10:40:50 Olhos fechados 10:40:51 Olhos fechados 10:40:52 Olhos fechados 10:40:53 Olhos fechados
Época: 16 - Horário: 10:40:47 - Estágio: 0 (8 seg.)

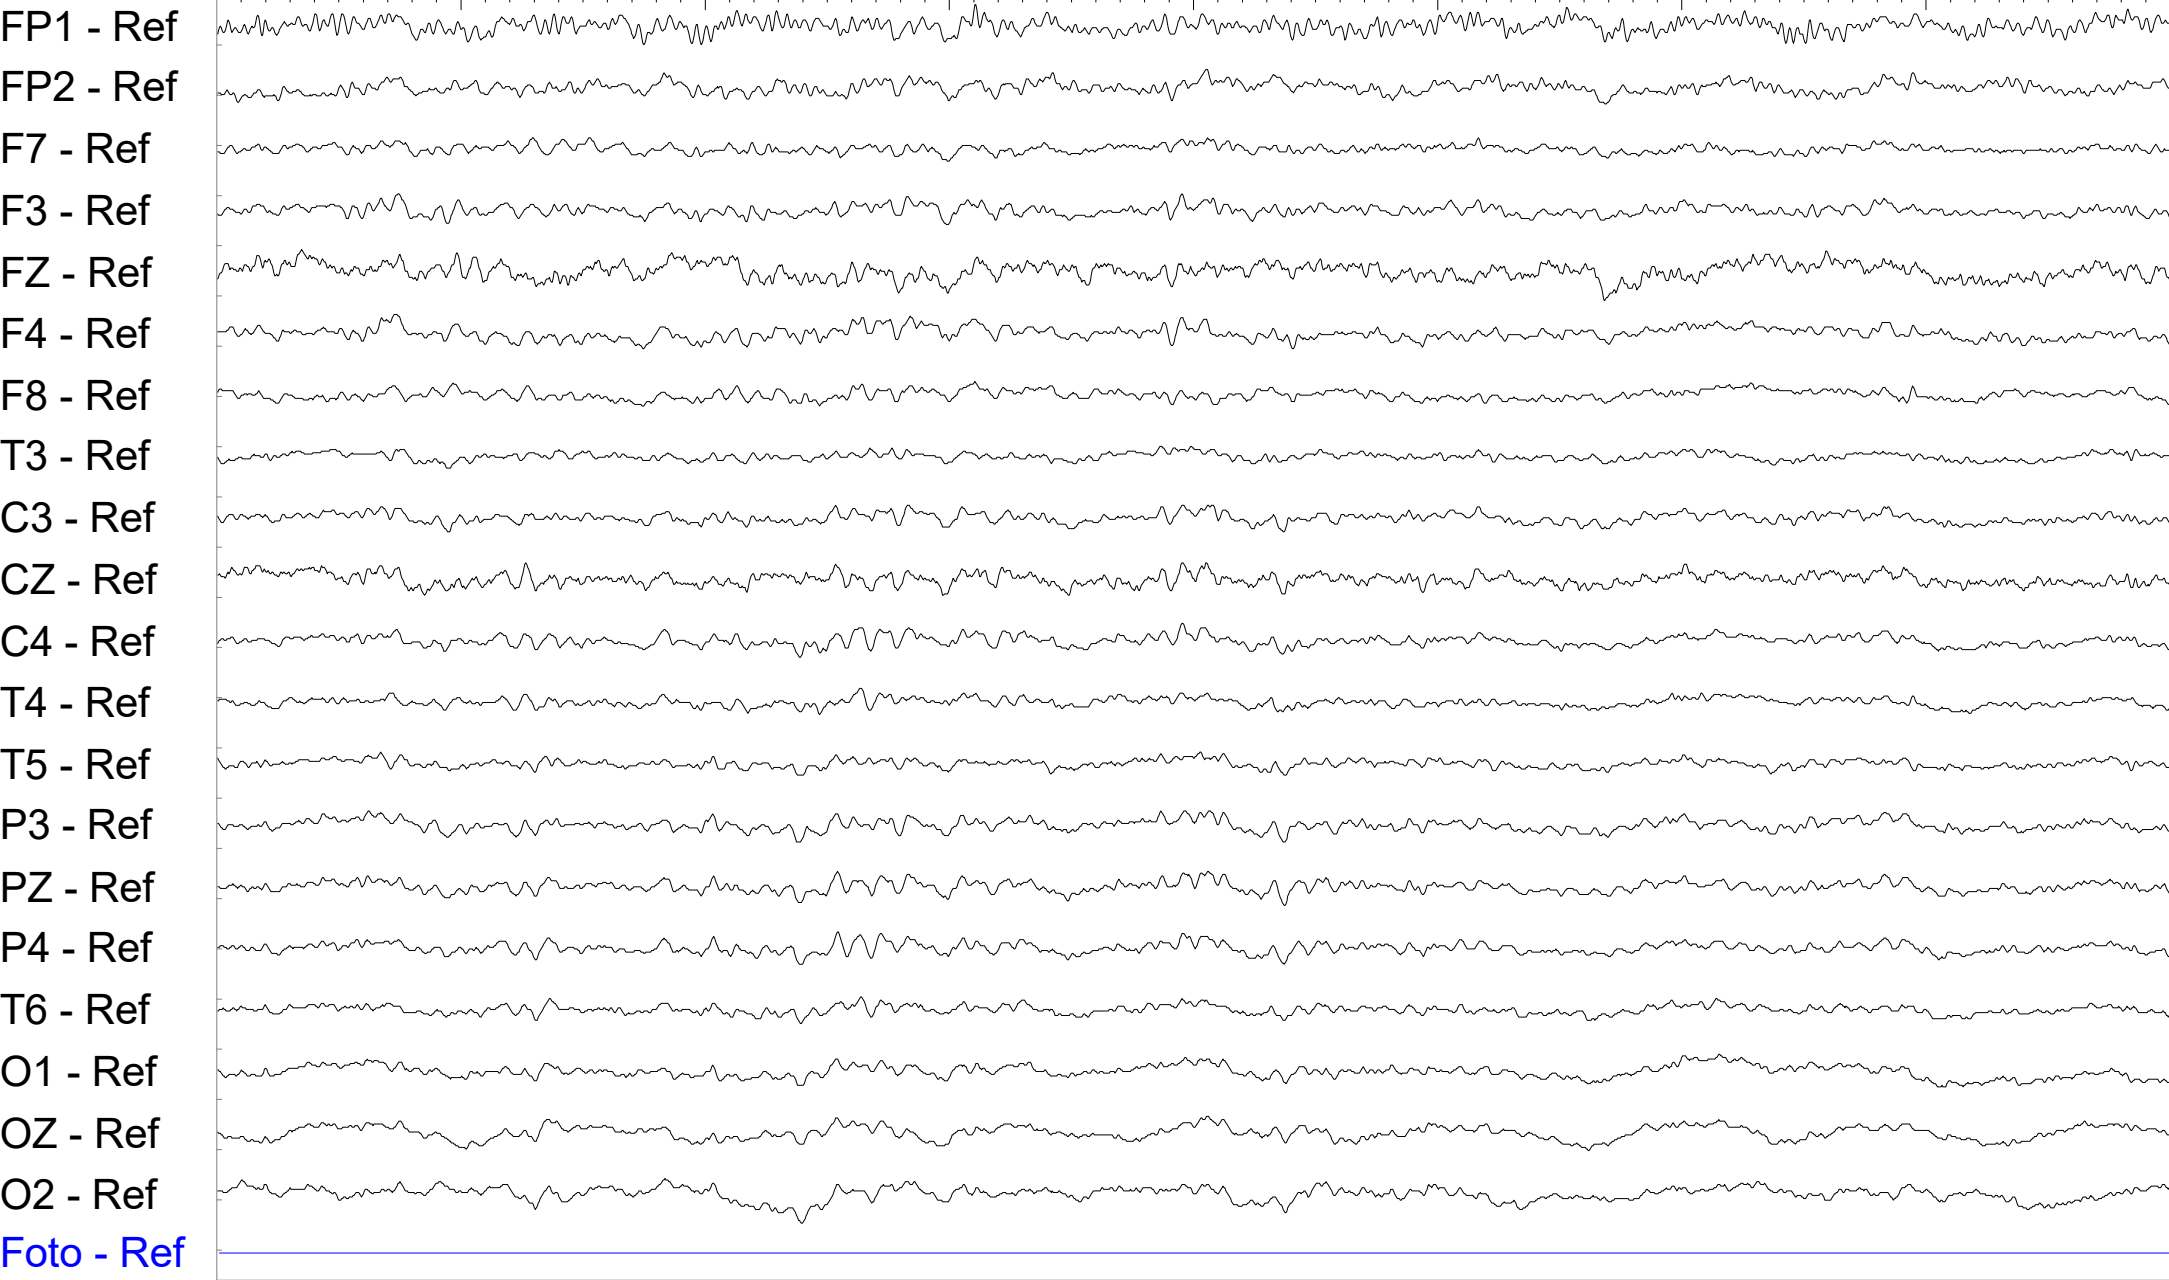

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 18/21

10:41:46

Hiperpneia

10:41:47

Hiperpneia

10:41:48

Hiperpneia

10:41:49

Hiperpneia

10:41:50

Hiperpneia

10:41:51

Hiperpneia

10:41:52

Hiperpneia

10:41:53

Hiperpneia

Época: 18 - Horário: 10:41:47 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref

P4 - Ref


T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref

Foto - Ref

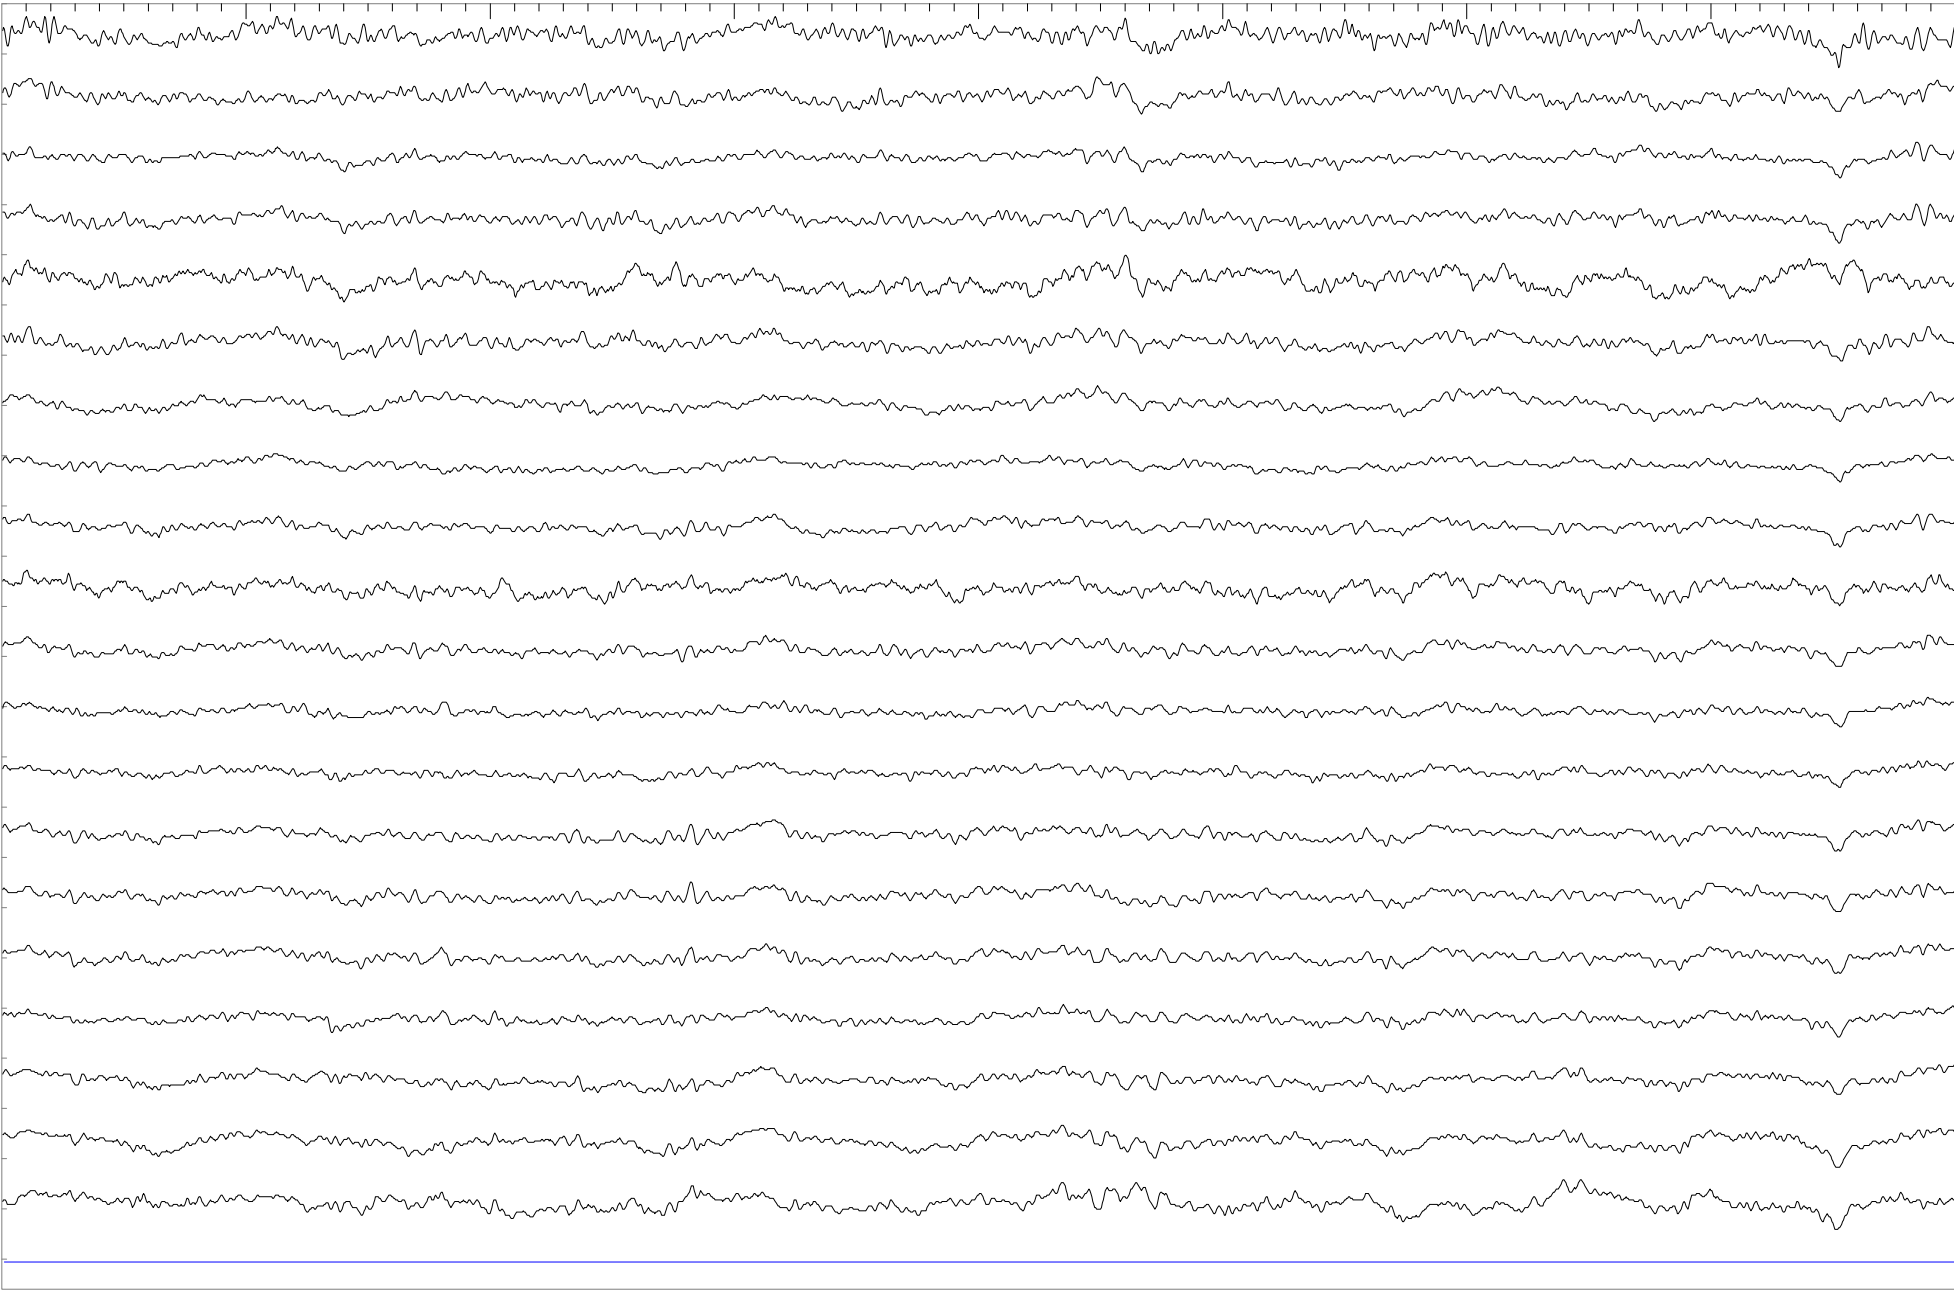

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

Pág. 19/21

10:42:16

Pós hiperpneia

10:42:17

Pós hiperpneia

10:42:18

Pós hiperpneia

10:42:19

Pós hiperpneia

10:42:20

Pós hiperpneia

10:42:21

Pós hiperpneia


10:42:22


Pós hiperpneia

10:42:23

Pós hiperpneia


Época: 19 - Horário: 10:42:17 - Estágio: 0 (8 seg.)

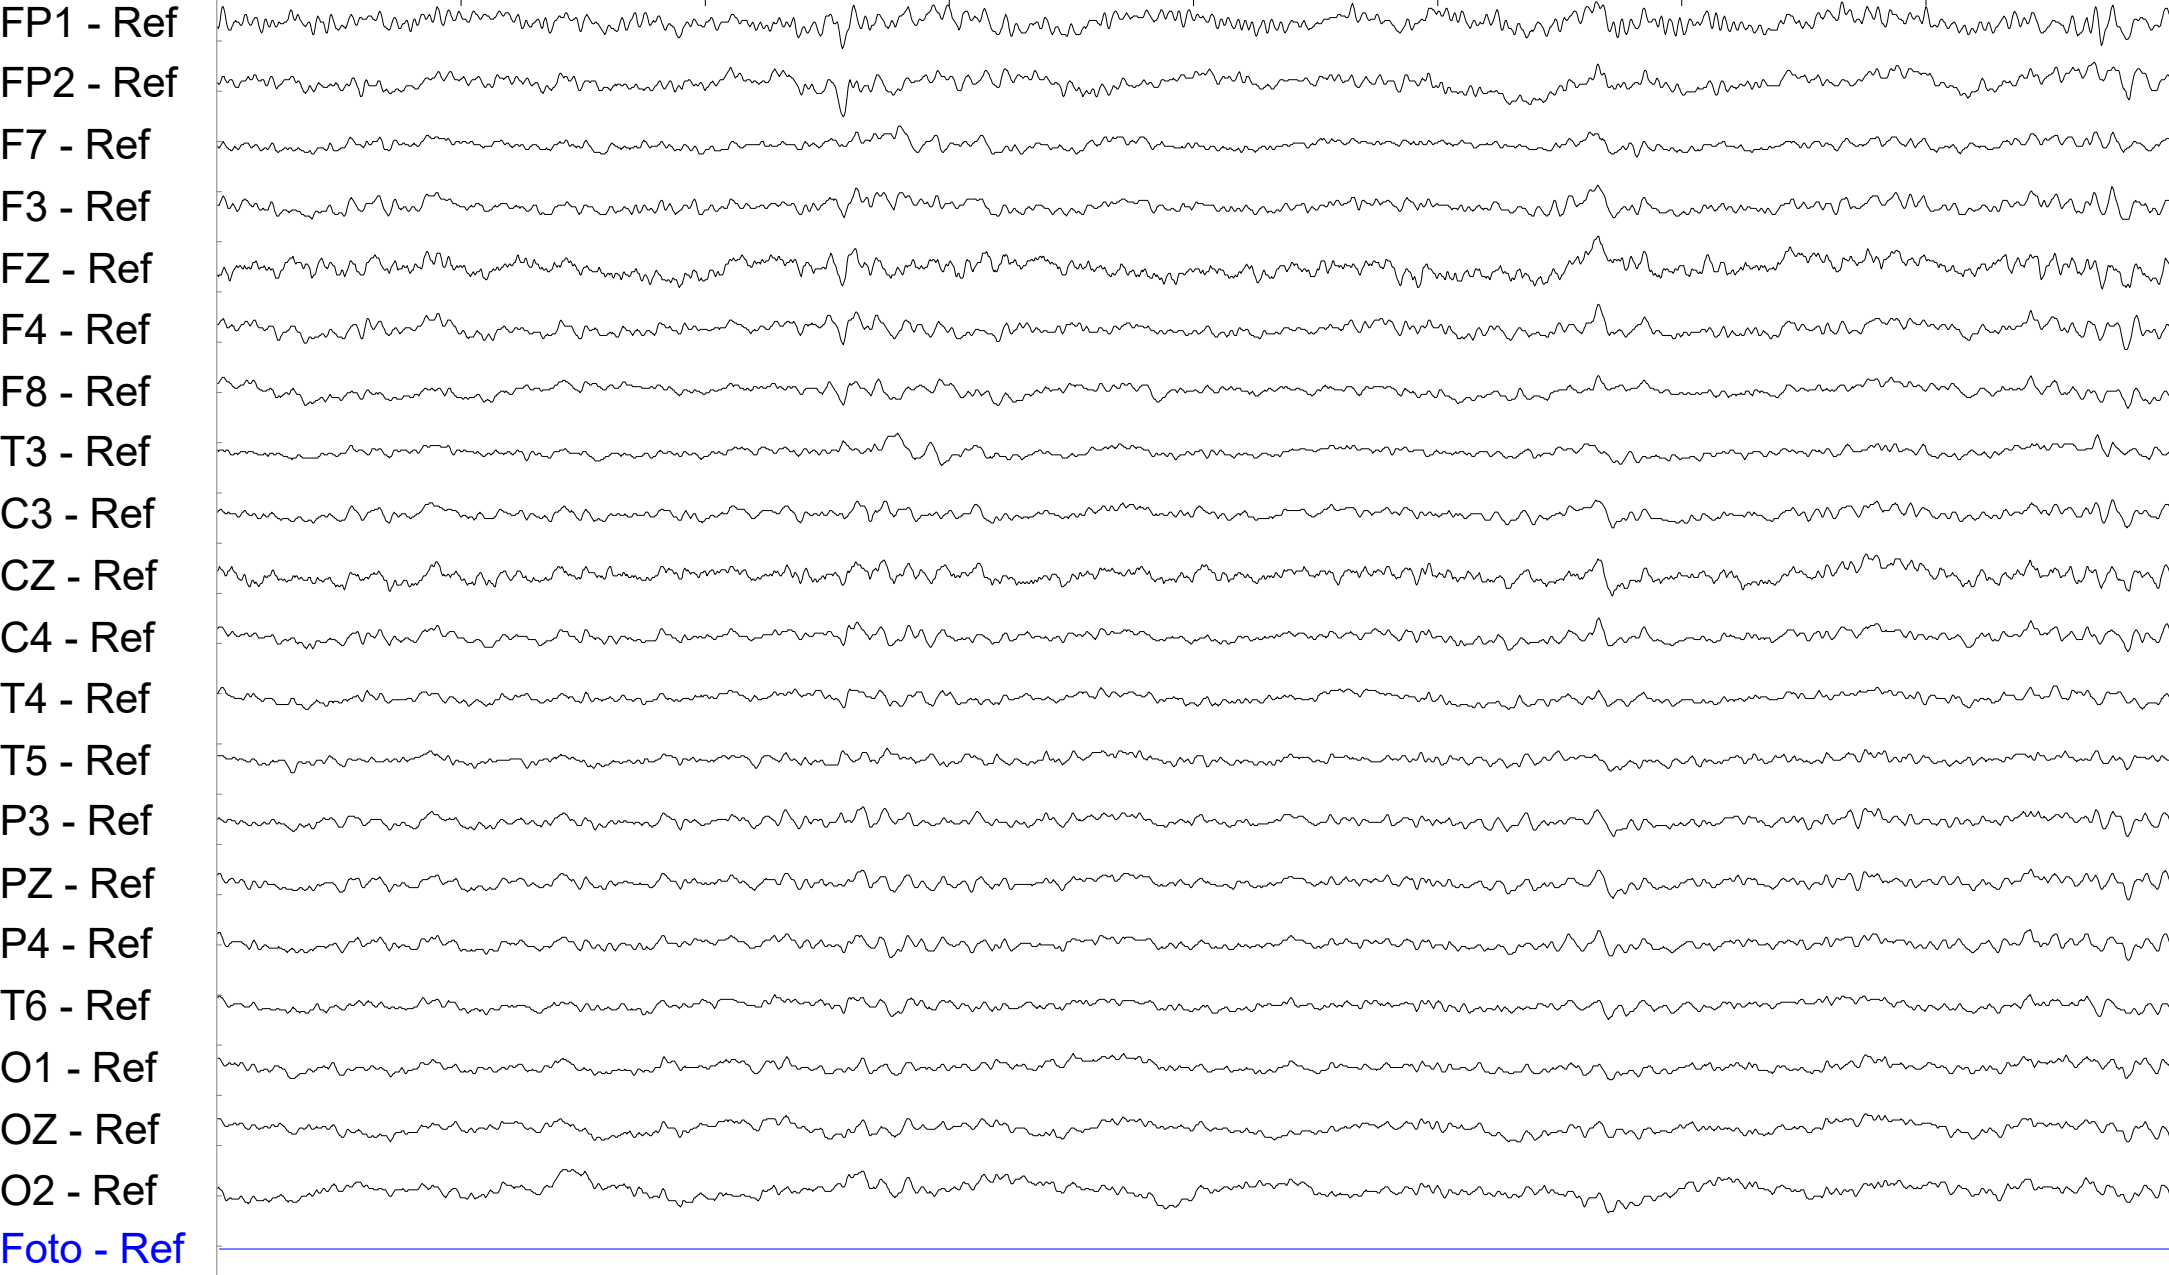



10:43:16 Vigília 10:43:17 Vigília 10:43:18 Vigília 10:43:19 Vigília 10:43:20 Vigília 10:43:21 Vigília 10:43:22 Vigília 10:43:23 Vigília

Época: 21 - Horário: 10:43:17 - Estágio: 0 (8 seg.)

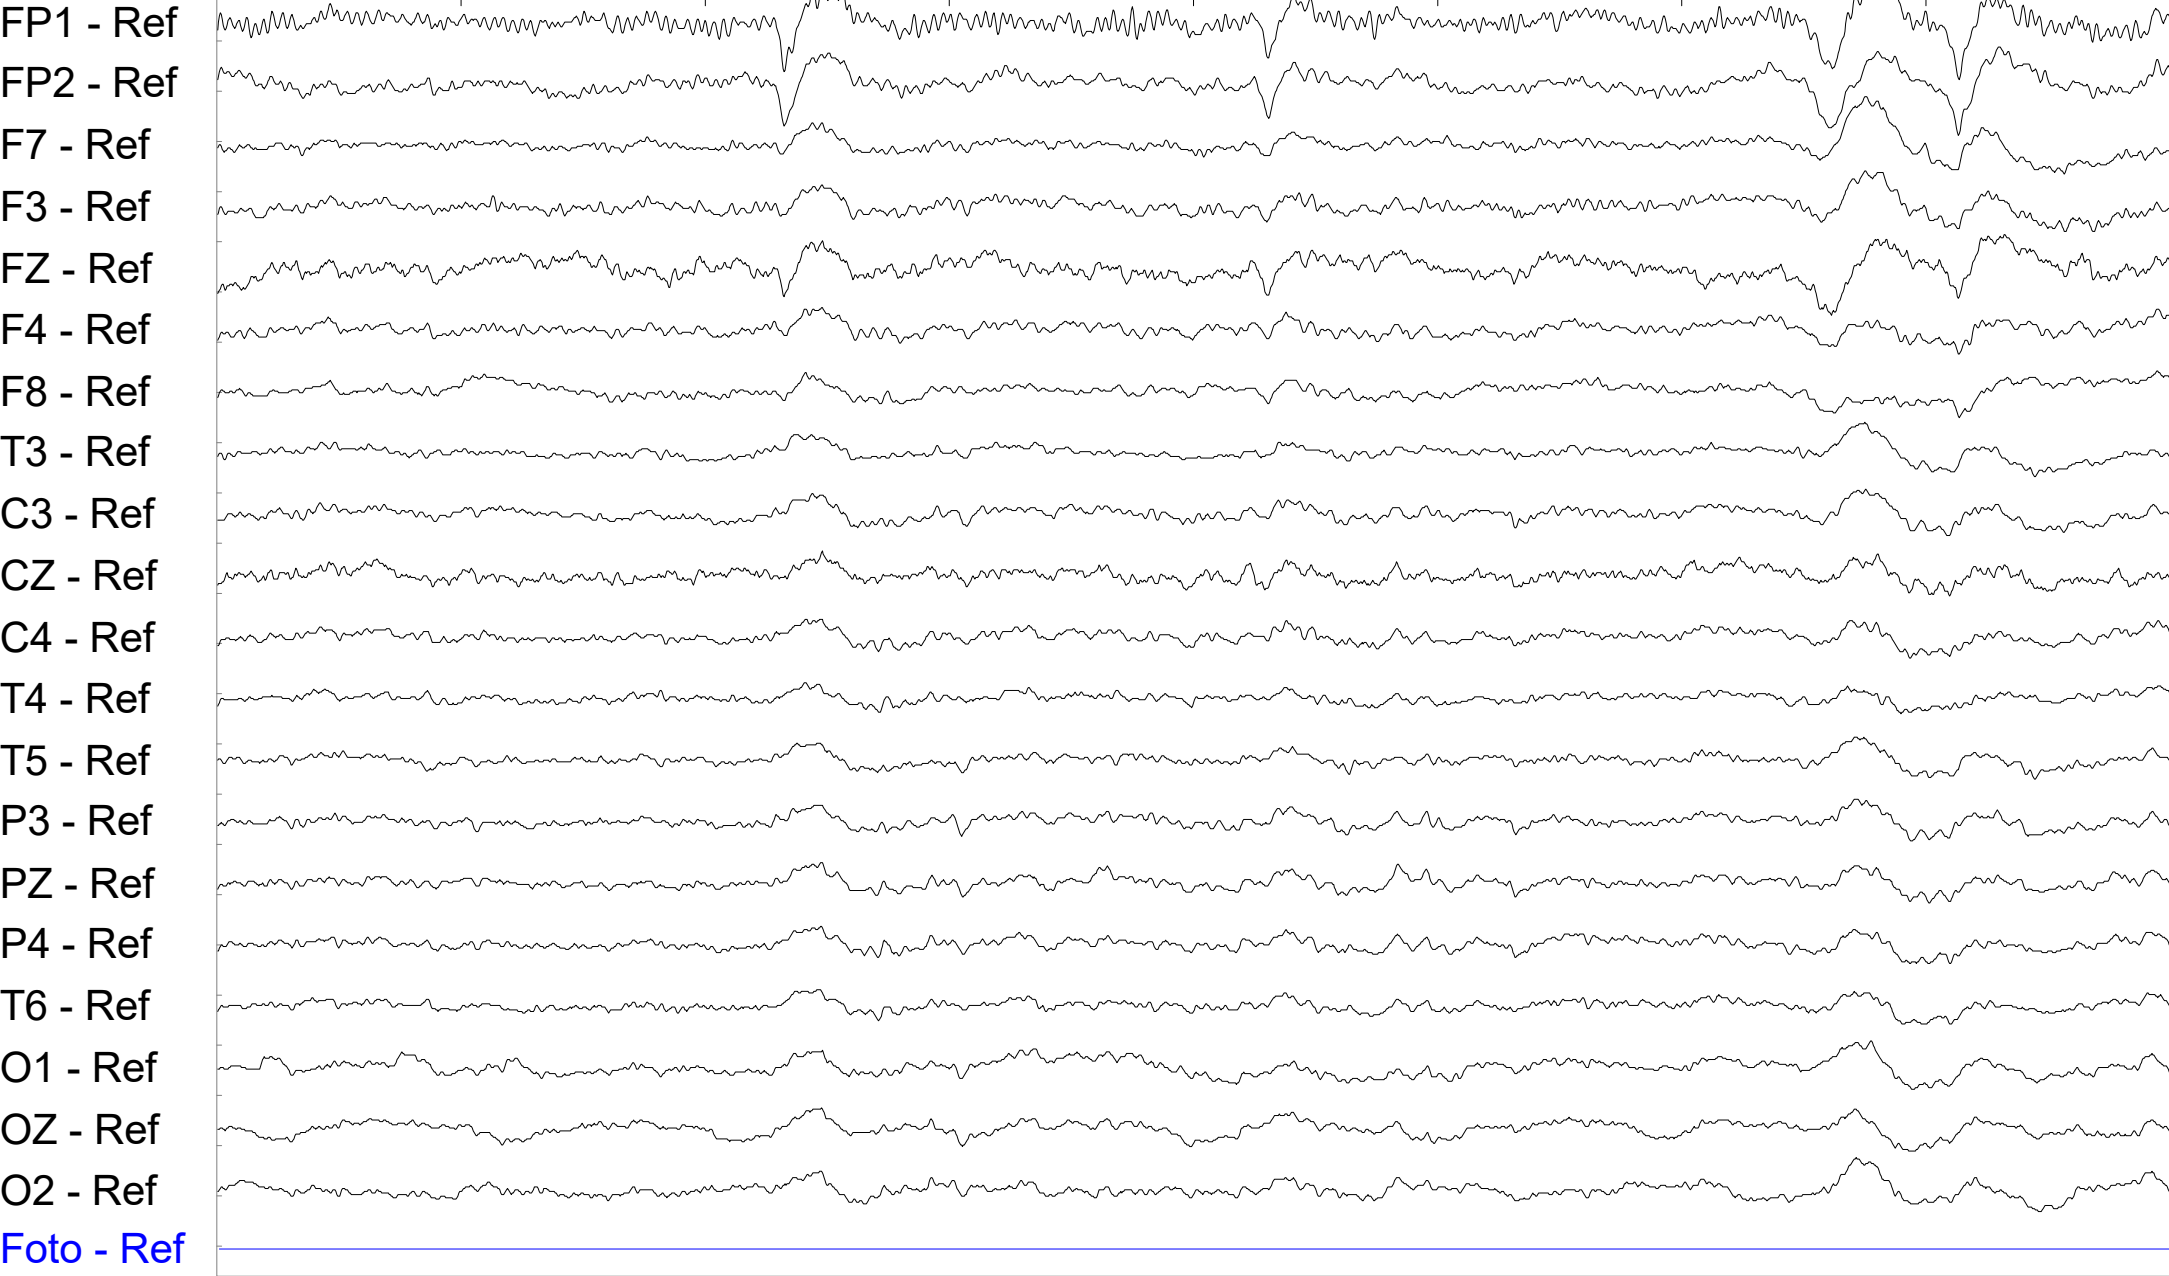

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

10:43:35

Vigília

10:43:36

Vigília

10:43:37

Vigília

10:43:38

Vigília

10:43:39

Vigília

10:43:40

Vigília


10:43:41


Vigília


10:43:42

Vigília

Época: 21 - Horário: 10:43:36 - Estágio: 0 (8 seg.)

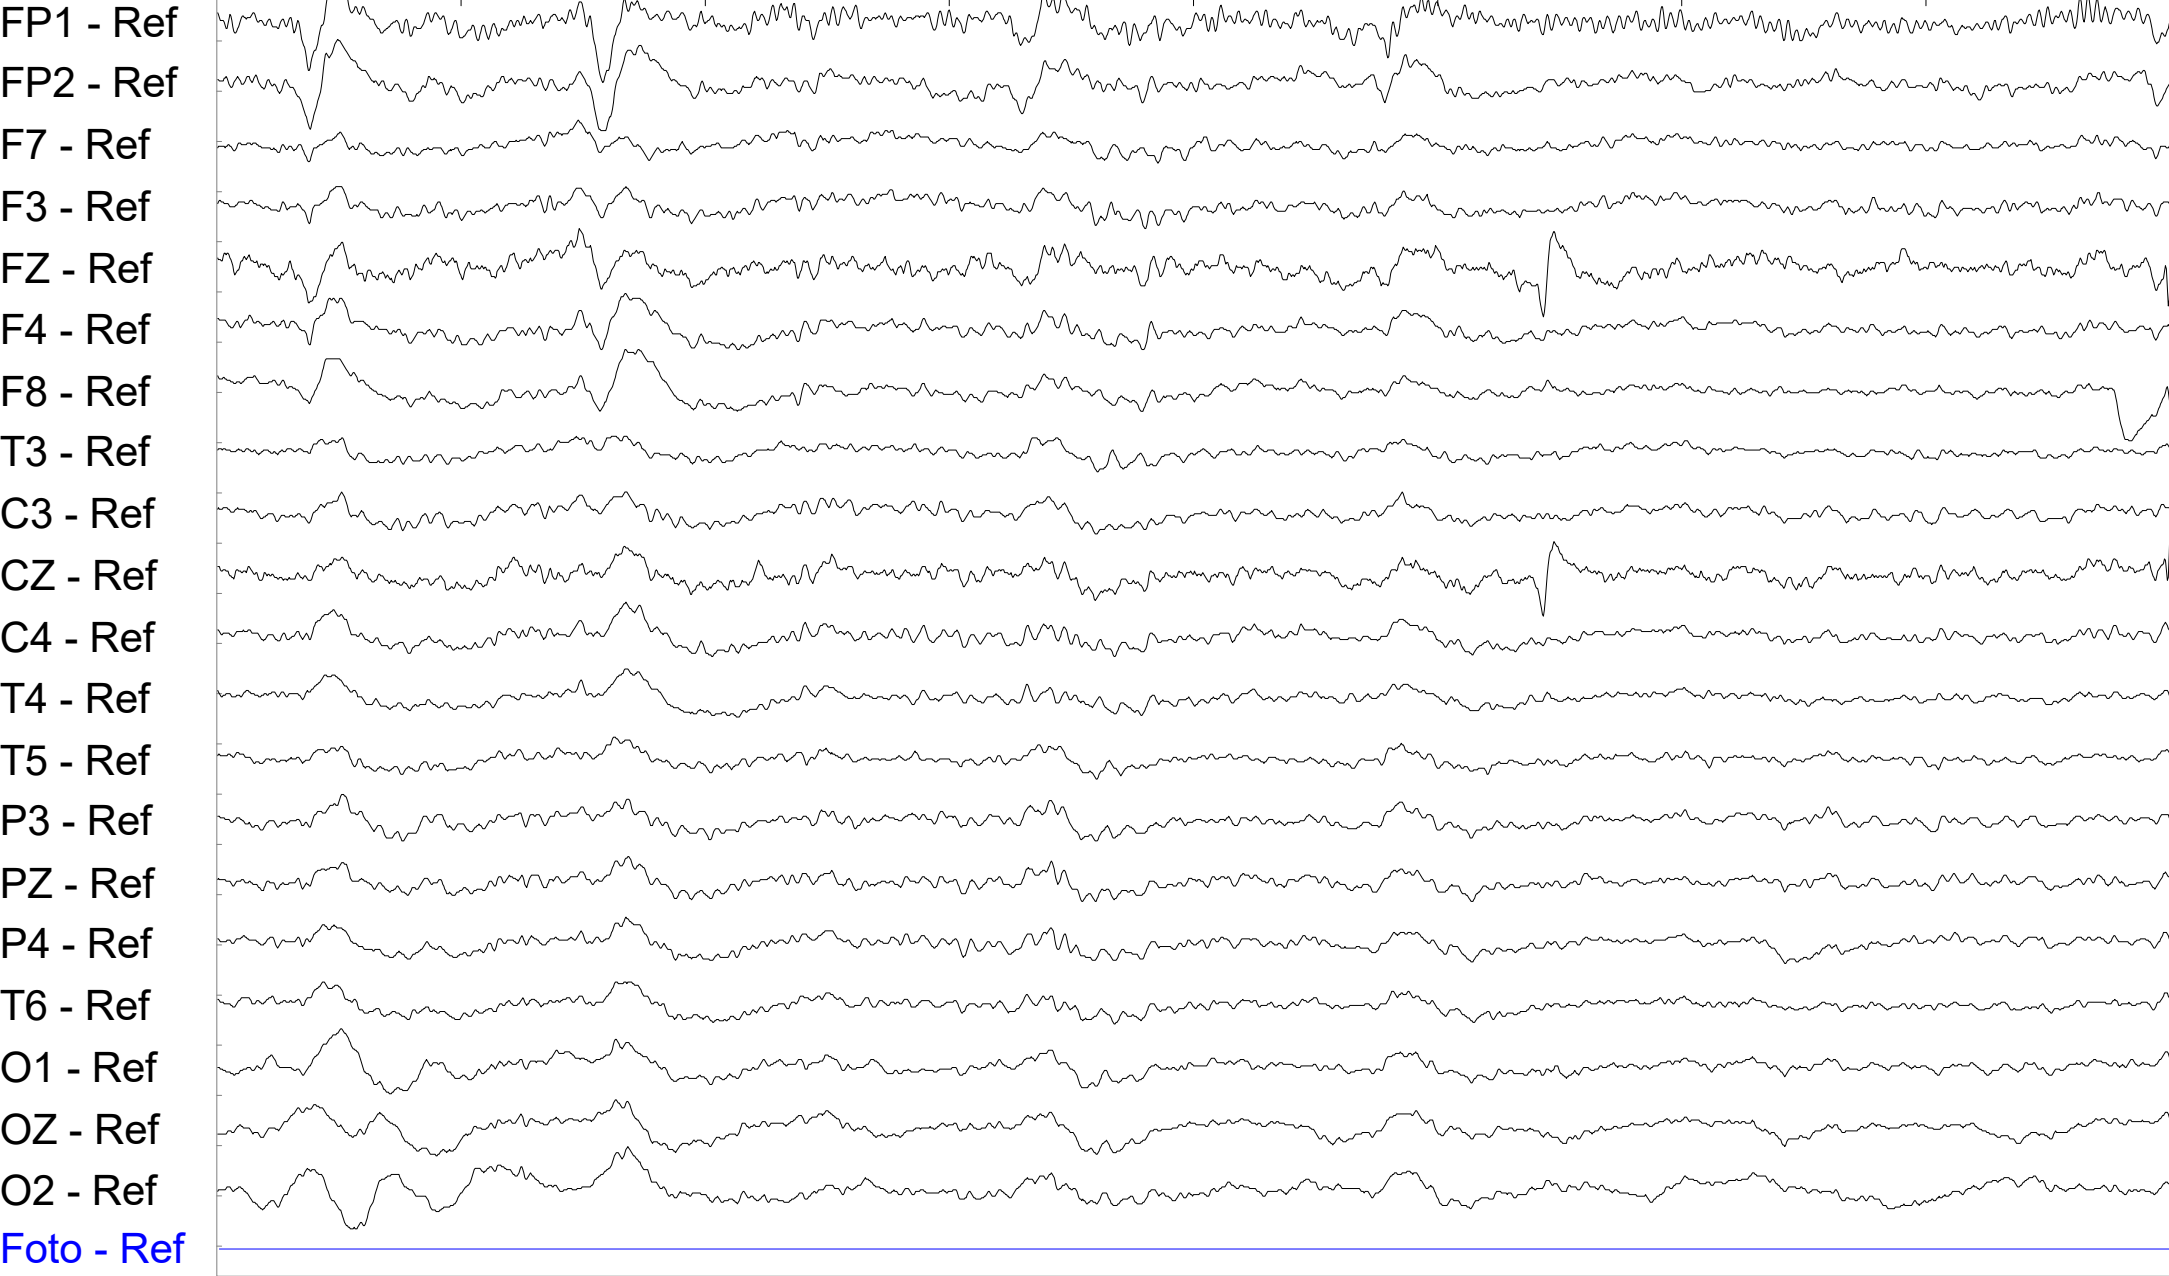

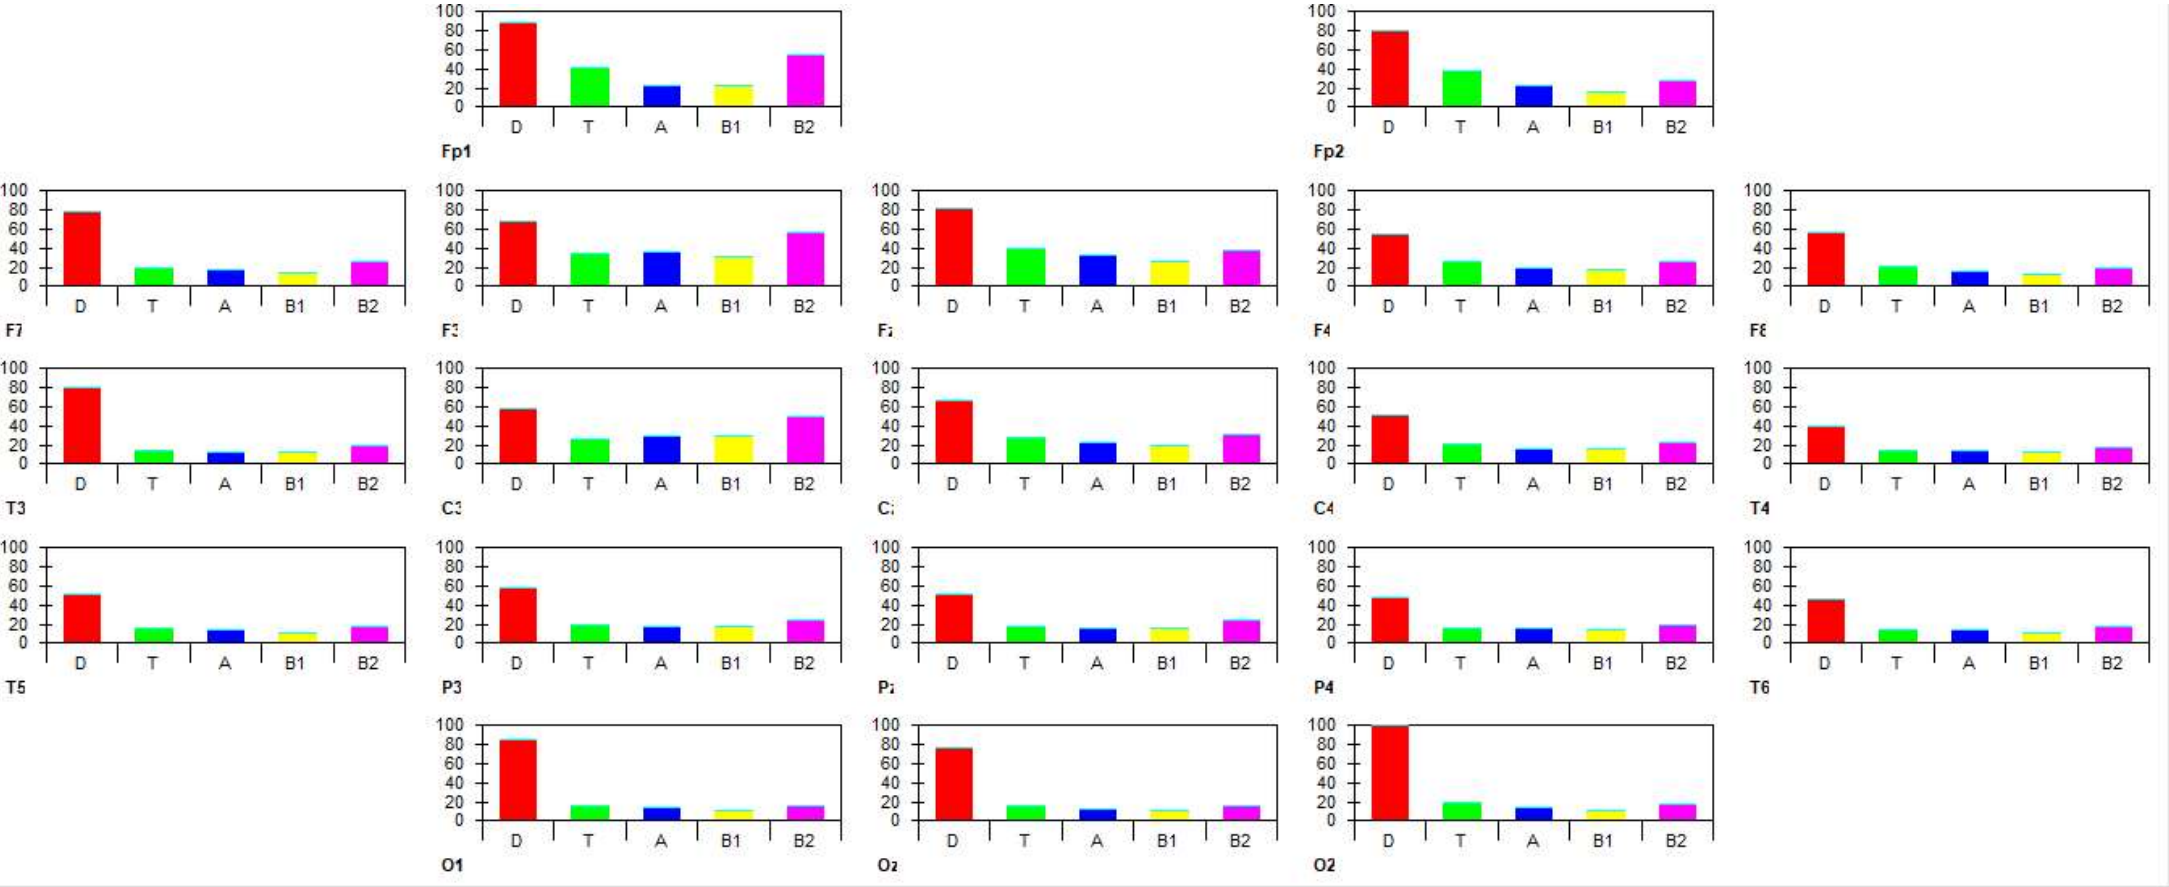

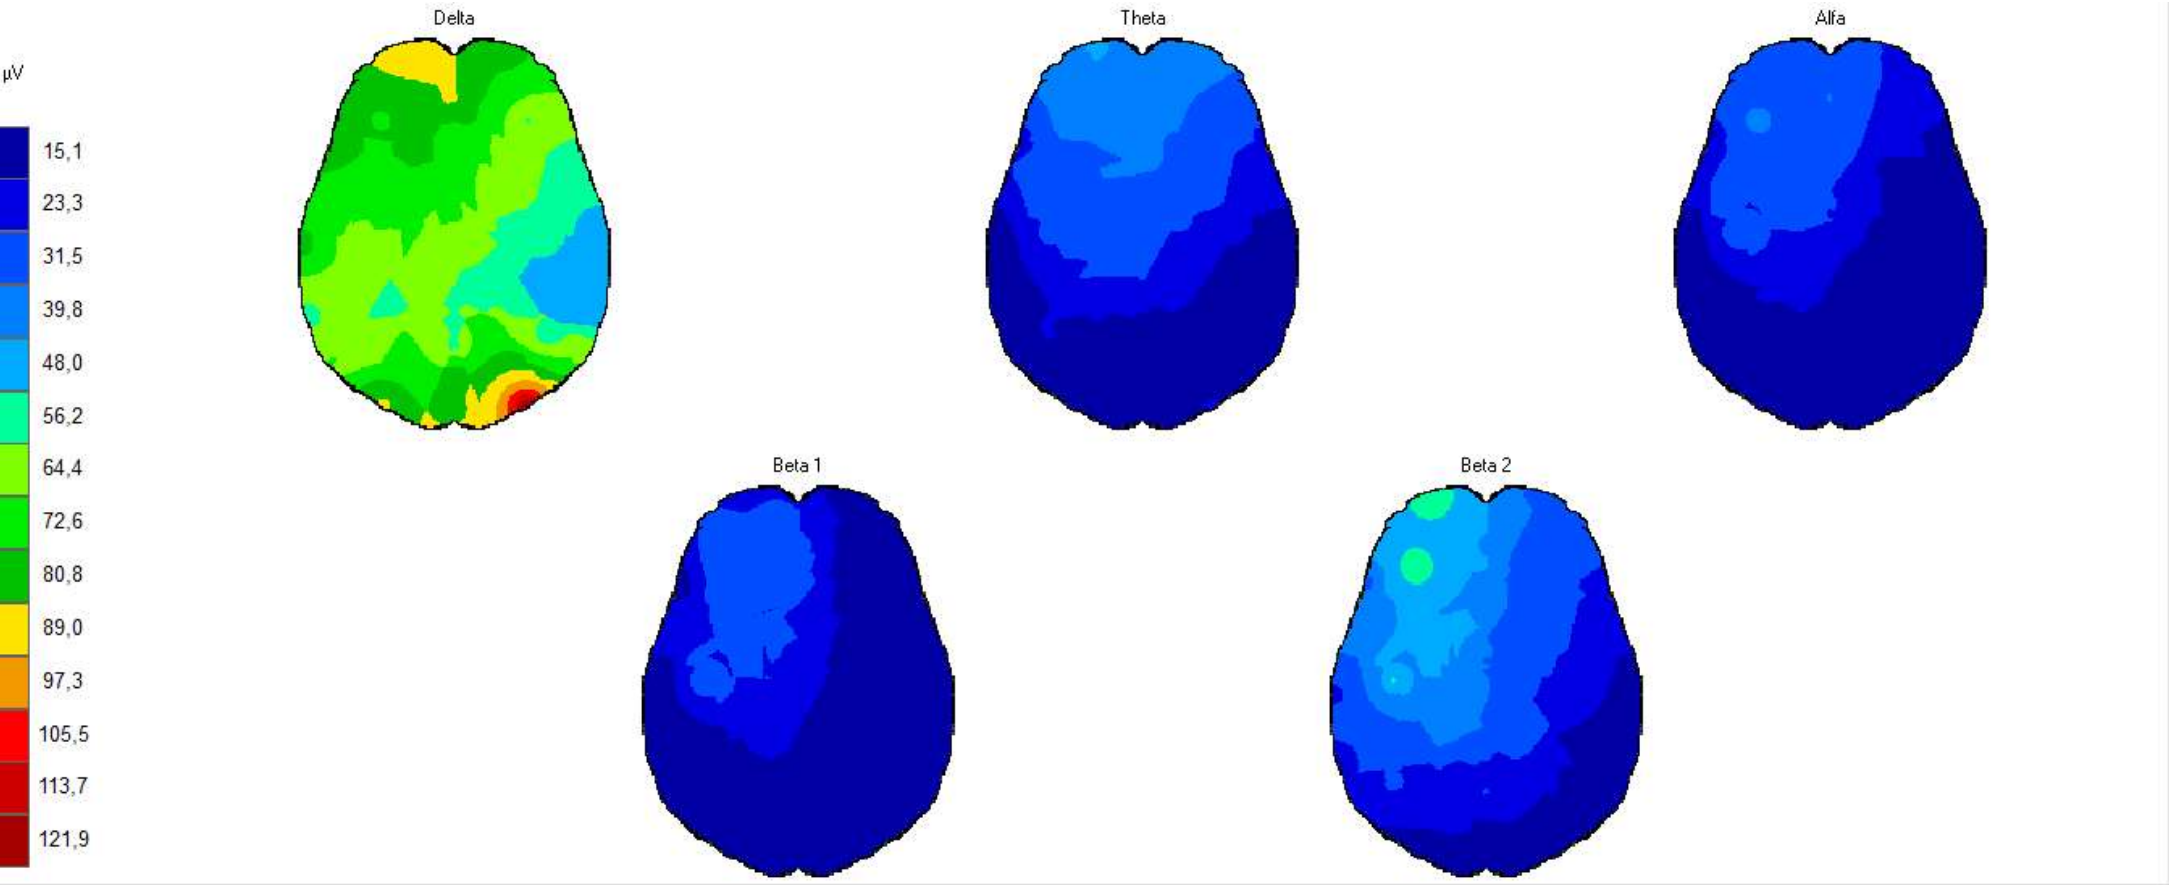

Ep1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	69,0	38,6
T	4,0	41,2	17,9
A	10,0	23,6	10,2
B1	17,0	22,0	9,5
B2	27,0	54,6	23,7

Ep2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	60,8	43,5
T	4,0	38,4	20,6
A	8,0	23,1	12,5
B1	16,5	15,8	8,5
B2	19,0	27,7	14,9

F7			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	79,1	50,5
T	4,0	20,2	12,9
A	9,5	17,0	10,9
B1	15,0	13,8	8,8
B2	26,0	26,5	16,9

F3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	68,2	30,1
T	6,5	34,4	15,2
A	10,0	36,7	16,2
B1	13,0	30,9	13,7
B2	30,5	56,3	24,9

Fz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	81,6	37,7
T	4,0	39,7	18,3
A	8,0	32,1	14,8
B1	13,5	26,1	12,1
B2	19,0	37,2	17,2

F4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	54,2	37,7
T	4,0	26,8	18,7
A	10,0	19,5	13,6
B1	18,0	16,9	11,8
B2	19,0	26,2	18,2

F8			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	57,2	44,4
T	4,0	21,8	16,9
A	10,0	16,6	12,9
B1	13,5	13,4	10,4
B2	19,0	19,8	15,4

T3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	79,7	56,8
T	4,0	14,6	10,4
A	10,0	12,8	9,1
B1	14,5	13,3	9,4
B2	20,5	19,9	14,2

C3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	59,0	30,3
T	6,5	26,5	13,6
A	10,0	29,1	15,0
B1	15,5	29,9	15,3
B2	22,5	50,1	25,8

Cz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	66,9	39,7
T	4,0	26,0	16,6
A	10,0	23,0	13,6
B1	13,0	19,7	11,7
B2	18,5	31,1	18,4

C4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	52,0	40,6
T	4,0	21,2	16,6
A	10,0	16,7	13,1
B1	13,5	15,9	12,4
B2	19,0	22,2	17,4

T4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	40,0	40,9
T	4,0	14,7	15,0
A	10,0	13,4	13,7
B1	13,5	12,8	13,1
B2	19,0	17,0	17,4

T5			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	50,9	47,3
T	4,0	15,4	14,3
A	9,5	13,5	12,5
B1	15,5	10,7	9,9
B2	23,0	17,2	16,0

P3			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	57,5	41,6
T	4,0	19,9	14,4
A	11,5	17,8	12,9
B1	15,5	17,7	12,8
B2	20,5	25,2	18,3

Pz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	51,6	40,8
T	4,0	18,1	14,3
A	10,5	16,7	13,2
B1	17,5	16,2	12,8
B2	20,5	23,8	18,8

P4			
	F.Dom.	µV	µV %
D	1,0	47,6	41,7
T	4,0	16,2	14,2
A	10,5	16,3	14,3
B1	13,0	14,9	13,1
B2	19,0	19,2	16,8

T6			
	F.Dom.	µV	µV %
D	,5	45,7	44,4
T	4,0	14,8	14,2
A	10,5	14,1	13,7
B1	14,5	11,4	11,1
B2	19,0	17,0	16,5

O1			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,5	85,9	59,7
T	4,0	16,6	11,5
A	10,5	14,5	10,1
B1	13,0	11,0	7,8
B2	19,0	16,0	11,1

Oz			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,5	76,5	57,8
T	4,0	16,3	12,3
A	8,0	12,7	9,8
B1	13,0	11,3	8,5
B2	19,0	15,7	11,6

O2			
	F.Dom.	µV	µV %
D	2,5	126,1	66,9
T	4,0	20,0	10,6
A	8,0	14,5	7,7
B1	15,0	11,1	5,9
B2	19,0	16,9	9,0

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	89,0	38,6	4,0	41,2	17,9	10,0	23,6	10,2	17,0	22,0	9,5	27,0	54,6	23,7
FP2	1,0	80,8	43,5	4,0	38,4	20,6	8,0	23,1	12,5	16,5	15,8	8,5	19,0	27,7	14,9
F7	1,0	79,1	50,5	4,0	20,2	12,9	9,5	17,0	10,9	15,0	13,8	8,8	26,0	26,5	16,9
F3	1,0	68,2	30,1	6,5	34,4	15,2	10,0	36,7	16,2	13,0	30,9	13,7	30,5	56,3	24,9
FZ	1,0	81,6	37,7	4,0	39,7	18,3	8,0	32,1	14,8	13,5	26,1	12,1	19,0	37,2	17,2
F4	1,0	54,2	37,7	4,0	26,8	18,7	10,0	19,5	13,6	18,0	16,9	11,8	19,0	26,2	18,2
F8	,5	57,2	44,4	4,0	21,8	16,9	10,0	16,6	12,9	13,5	13,4	10,4	19,0	19,8	15,4
T3	1,0	79,7	56,8	4,0	14,6	10,4	10,0	12,8	9,1	14,5	13,3	9,4	20,5	19,9	14,2
C3	1,0	59,0	30,3	6,5	26,5	13,6	10,0	29,1	15,0	15,5	29,9	15,3	22,5	50,1	25,8
CZ	1,0	66,9	39,7	4,0	28,0	16,6	10,0	23,0	13,6	13,0	19,7	11,7	18,5	31,1	18,4
C4	,5	52,0	40,6	4,0	21,2	16,6	10,0	16,7	13,1	13,5	15,9	12,4	19,0	22,2	17,4
T4	,5	40,0	40,9	4,0	14,7	15,0	10,0	13,4	13,7	13,5	12,8	13,1	19,0	17,0	17,4
T5	1,0	50,9	47,3	4,0	15,4	14,3	9,5	13,5	12,5	15,5	10,7	9,9	23,0	17,2	16,0
P3	1,0	57,5	41,6	4,0	19,9	14,4	11,5	17,8	12,9	15,5	17,7	12,8	20,5	25,2	18,3
PZ	1,0	51,6	40,8	4,0	18,1	14,3	10,5	16,7	13,2	17,5	16,2	12,8	20,5	23,8	18,8
P4	1,0	47,6	41,7	4,0	16,2	14,2	10,5	16,3	14,3	13,0	14,9	13,1	19,0	19,2	16,8
T6	,5	45,7	44,4	4,0	14,6	14,2	10,5	14,1	13,7	14,5	11,4	11,1	19,0	17,0	16,5
O1	2,5	85,9	59,7	4,0	16,6	11,5	10,5	14,5	10,1	13,0	11,0	7,6	19,0	16,0	11,1
OZ	2,5	76,5	57,8	4,0	16,3	12,3	8,0	12,7	9,6	13,0	11,3	8,5	19,0	15,7	11,8
O2	2,5	126,1	66,9	4,0	20,0	10,6	8,0	14,5	7,7	15,0	11,1	5,9	19,0	16,9	9,0

	Delta			Theta			Alfa			Beta 1			Beta 2		
	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %	F.Dom.	µV	µV %
FP1	1,0	89,0	38,6	4,0	41,2	17,9	10,0	23,6	10,2	17,0	22,0	9,5	27,0	54,6	23,7
FP2	1,0	80,8	43,5	4,0	38,4	20,6	8,0	23,1	12,5	16,5	15,8	8,5	19,0	27,7	14,9
F7	1,0	79,1	50,5	4,0	20,2	12,9	9,5	17,0	10,9	15,0	13,8	8,8	26,0	26,5	16,9
F3	1,0	68,2	30,1	6,5	34,4	15,2	10,0	36,7	16,2	13,0	30,9	13,7	30,5	56,3	24,9
FZ	1,0	81,6	37,7	4,0	39,7	18,3	8,0	32,1	14,8	13,5	26,1	12,1	19,0	37,2	17,2
F4	1,0	54,2	37,7	4,0	26,8	18,7	10,0	19,5	13,6	18,0	16,9	11,8	19,0	26,2	18,2
F8	,5	57,2	44,4	4,0	21,8	16,9	10,0	16,6	12,9	13,5	13,4	10,4	19,0	19,8	15,4
T3	1,0	79,7	56,8	4,0	14,6	10,4	10,0	12,8	9,1	14,5	13,3	9,4	20,5	19,9	14,2
C3	1,0	59,0	30,3	6,5	26,5	13,6	10,0	29,1	15,0	15,5	29,9	15,3	22,5	50,1	25,8
CZ	1,0	66,9	39,7	4,0	28,0	16,6	10,0	23,0	13,6	13,0	19,7	11,7	18,5	31,1	18,4
C4	,5	52,0	40,6	4,0	21,2	16,6	10,0	16,7	13,1	13,5	15,9	12,4	19,0	22,2	17,4
T4	,5	40,0	40,9	4,0	14,7	15,0	10,0	13,4	13,7	13,5	12,8	13,1	19,0	17,0	17,4
T5	1,0	50,9	47,3	4,0	15,4	14,3	9,5	13,5	12,5	15,5	10,7	9,9	23,0	17,2	16,0
P3	1,0	57,5	41,6	4,0	19,9	14,4	11,5	17,8	12,9	15,5	17,7	12,8	20,5	25,2	18,3
PZ	1,0	51,6	40,8	4,0	18,1	14,3	10,5	16,7	13,2	17,5	16,2	12,8	20,5	23,8	18,8
P4	1,0	47,6	41,7	4,0	16,2	14,2	10,5	16,3	14,3	13,0	14,9	13,1	19,0	19,2	16,8
T6	,5	45,7	44,4	4,0	14,6	14,2	10,5	14,1	13,7	14,5	11,4	11,1	19,0	17,0	16,5
O1	2,5	85,9	59,7	4,0	16,6	11,5	10,5	14,5	10,1	13,0	11,0	7,6	19,0	16,0	11,1
OZ	2,5	76,5	57,8	4,0	16,3	12,3	8,0	12,7	9,6	13,0	11,3	8,5	19,0	15,7	11,8
O2	2,5	126,1	66,9	4,0	20,0	10,6	8,0	14,5	7,7	15,0	11,1	5,9	19,0	16,9	9,0

Relação de modos de gravação e eventos

<u>Época</u>	<u>Horário</u>	<u>Duração</u>	<u>Descrição</u>
1	10:33:12	02:02	Olhos abertos
5	10:35:19	02:43	Olhos fechados
10	10:38:02	01:14	Vigília
12	10:39:15	01:08	Foto Estimulação
13	10:39:20	00:00	Foto 1 hz
13	10:39:24	00:00	Foto 3 hz
13	10:39:29	00:00	Foto 6 hz
13	10:39:34	00:00	Foto Desativado
13	10:39:35	00:00	Foto 1 hz
13	10:39:36	00:00	Foto 1 hz
13	10:39:37	00:00	Foto 1 hz
13	10:39:42	00:00	Foto 3 hz
14	10:39:47	00:00	Foto 6 hz
14	10:39:53	00:00	Foto Desativado
14	10:39:53	00:00	Foto 1 hz
14	10:39:58	00:00	Foto 3 hz
14	10:40:03	00:00	Foto 6 hz
14	10:40:08	00:00	Foto Desativado
14	10:40:08	00:00	Foto 1 hz
15	10:40:23	00:43	Olhos fechados
16	10:41:06	01:02	Hiperpneia
18	10:42:08	01:04	Pós hiperpneia
20	10:43:12	00:31	Vigília