



13:35:46 13:35:47 13:35:48 13:35:49 13:35:50 13:35:51 13:35:52 13:35:53  
Sono induzido Sono induzido Sono induzido Sono induzido Sono induzido Sono induzido Sono induzido Sono induzido  
Época: 1 - Horário: 13:35:47 - Estágio: 0 (8 seg.)

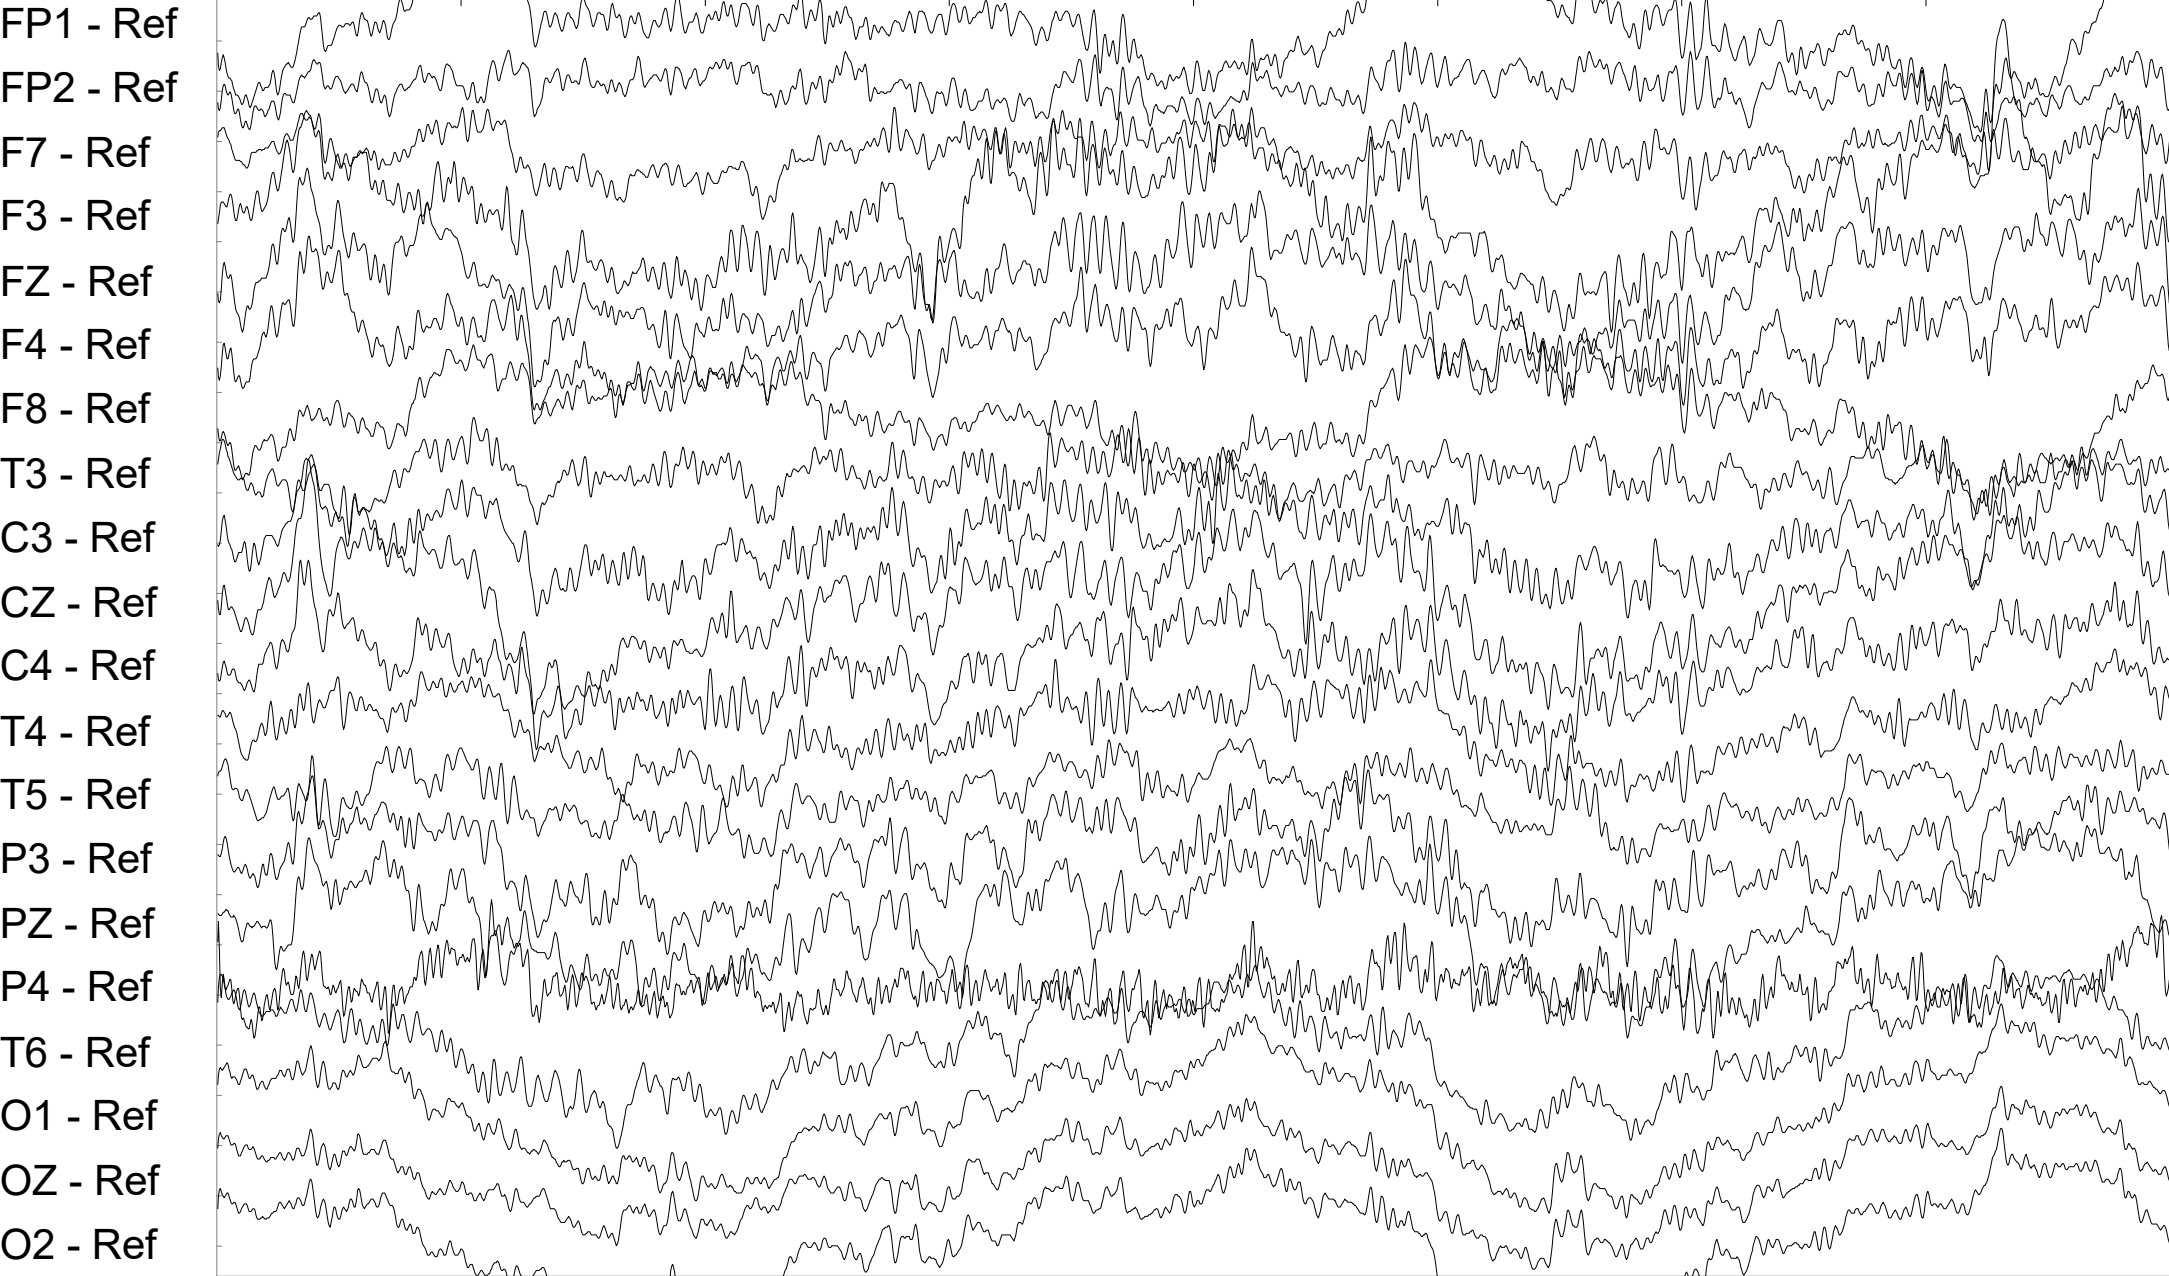


13:37:46 Sono induzido 13:37:47 Sono induzido 13:37:48 Sono induzido 13:37:49 Sono induzido 13:37:50 Sono induzido 13:37:51 Sono induzido 13:37:52 Sono induzido 13:37:53 Sono induzido

Época: 5 - Horário: 13:37:47 - Estágio: 0 (8 seg.)

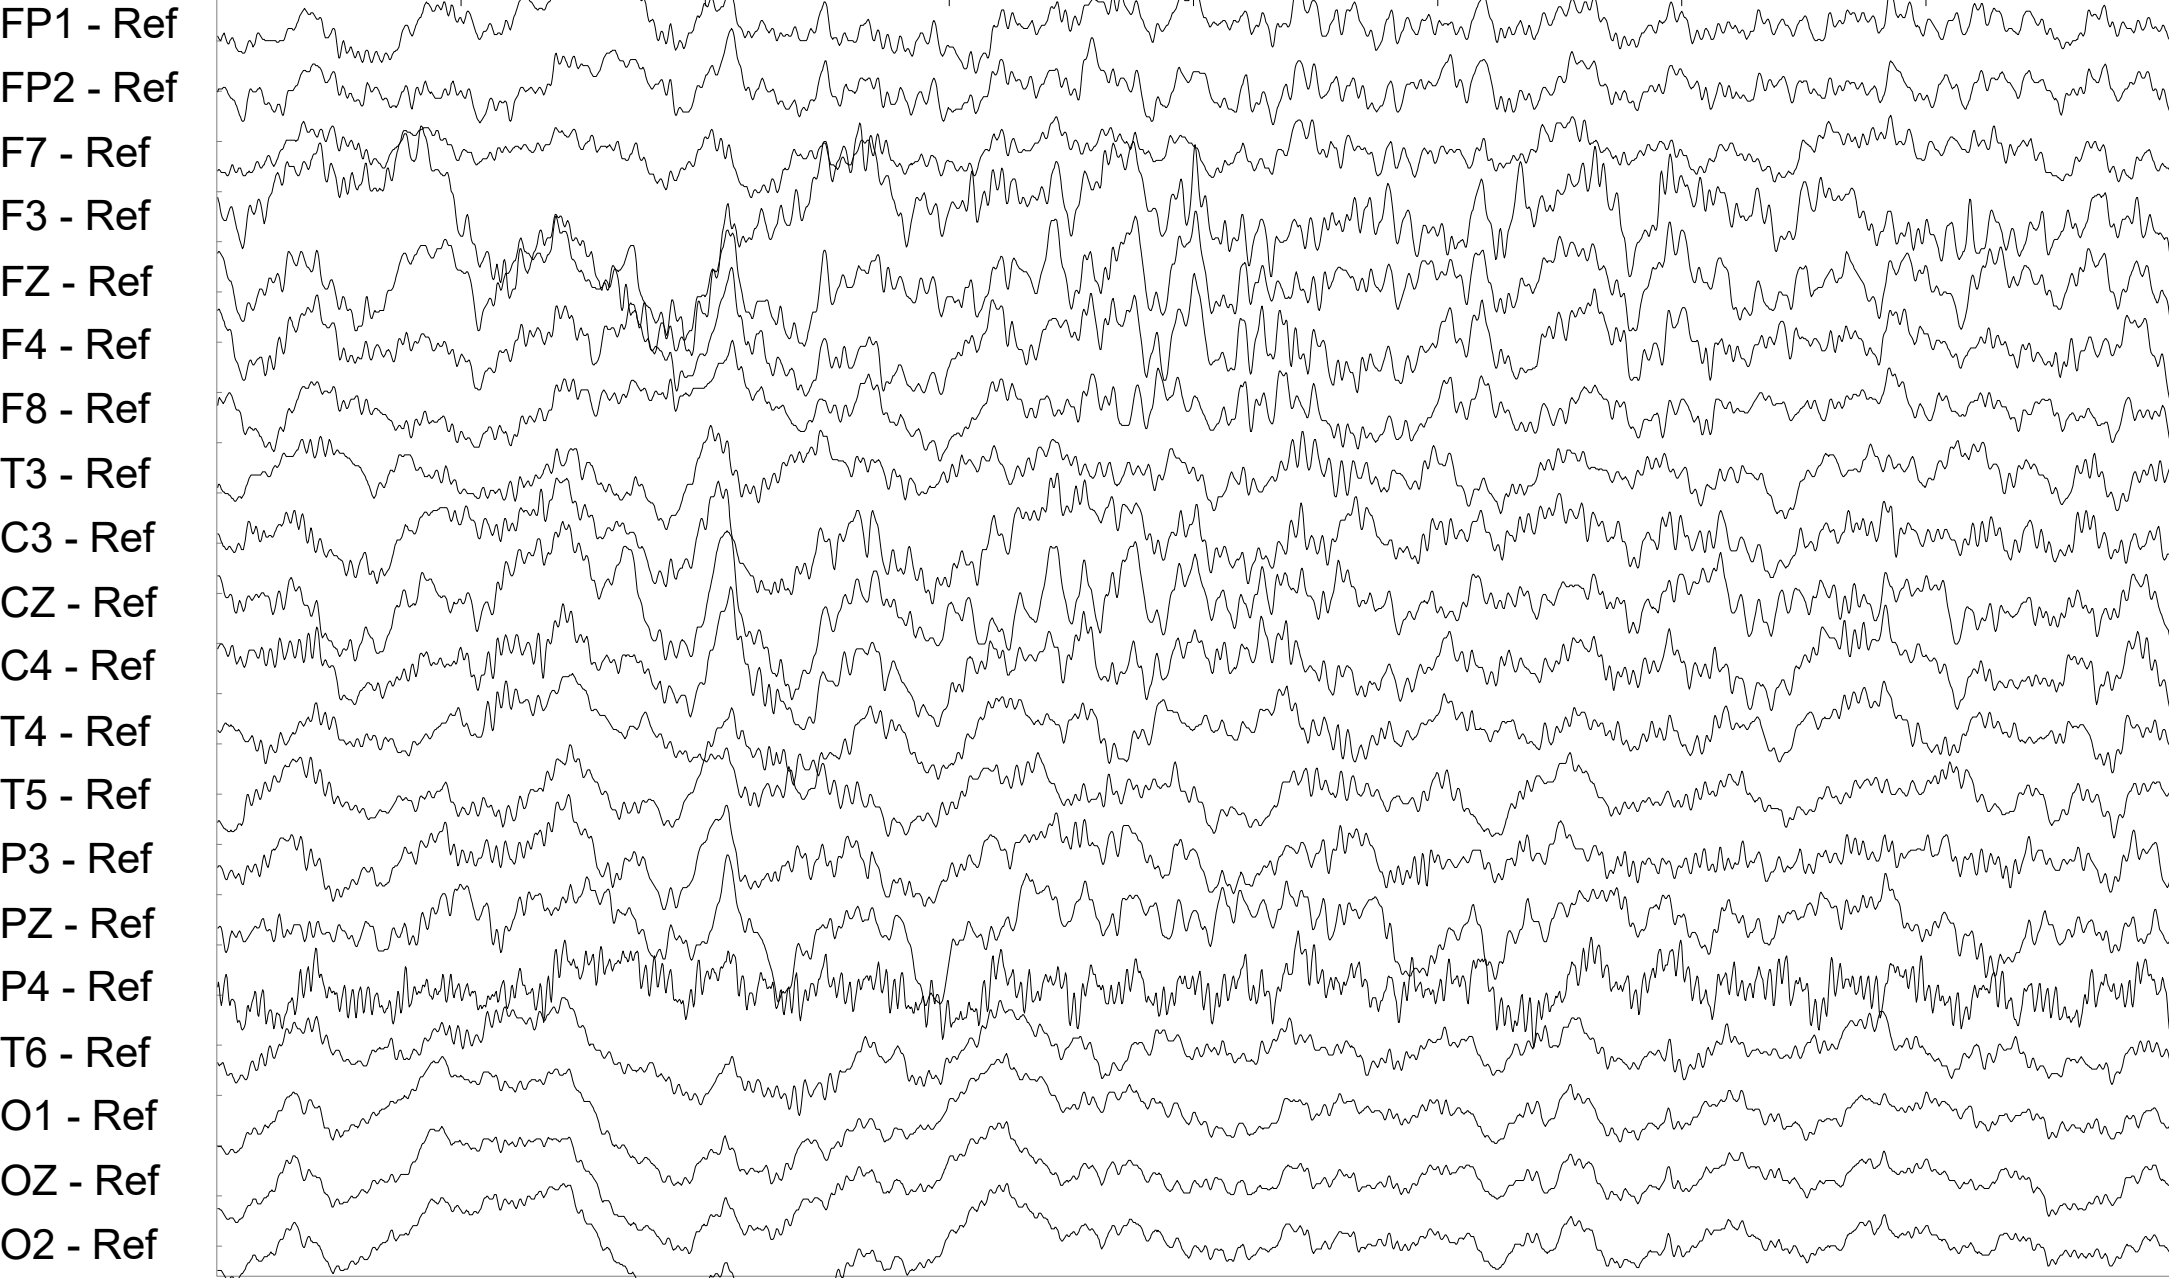

13:39:16 Sono induzido 13:39:17 Sono induzido 13:39:18 Sono induzido 13:39:19 Sono induzido 13:39:20 Sono induzido 13:39:21 Sono induzido 13:39:22 Sono induzido 13:39:23 Sono induzido

Época: 8 - Horário: 13:39:17 - Estágio: 0 (8 seg.)

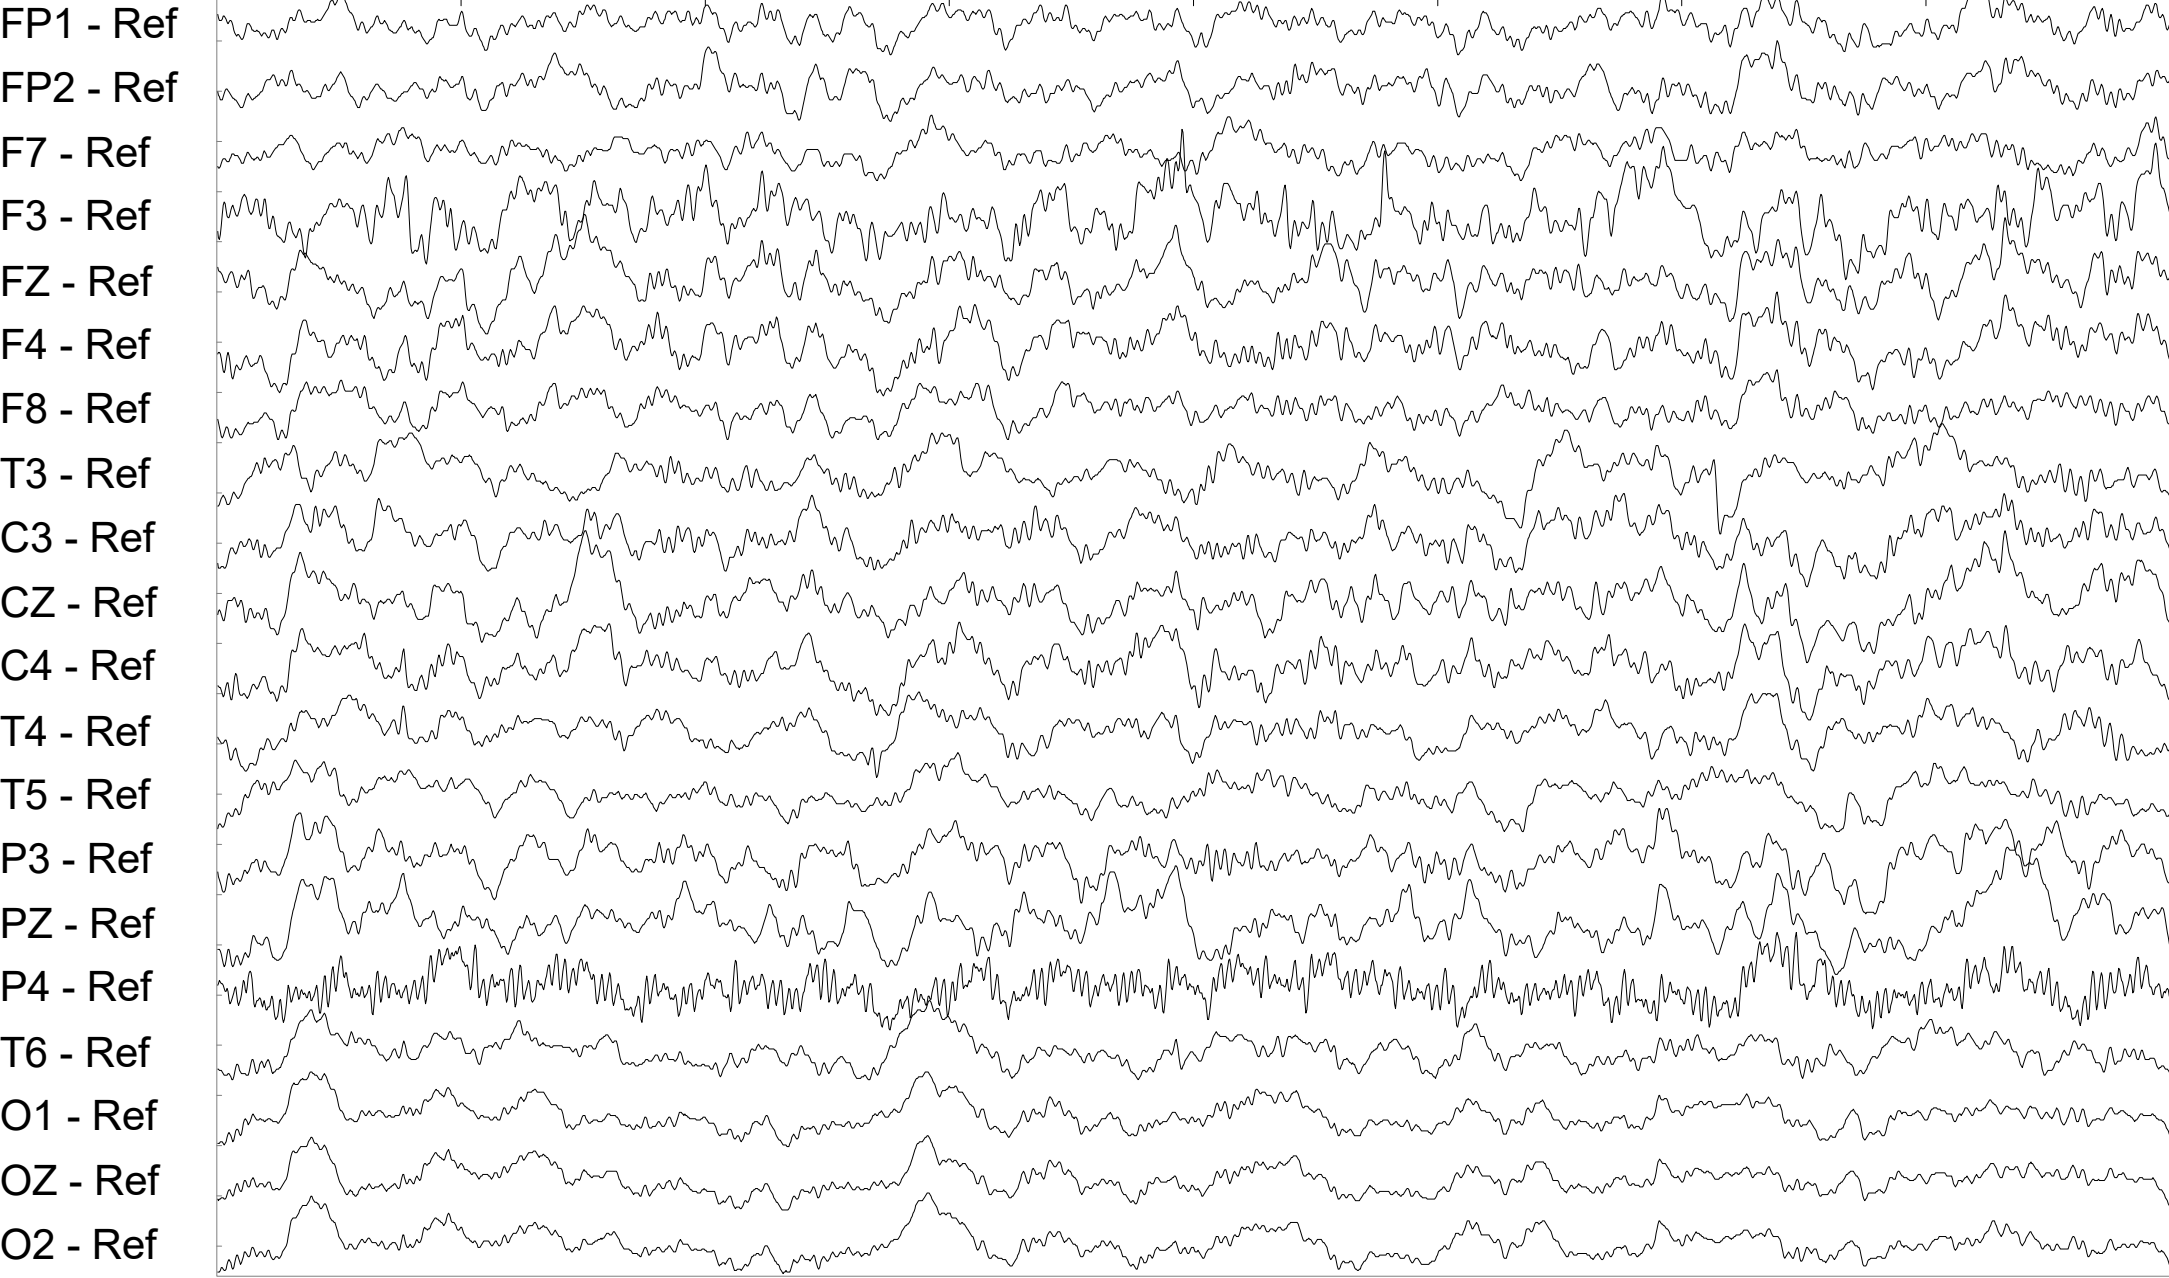

13:40:16

Sono induzido

13:40:17

Sono induzido

13:40:18

Sono induzido

13:40:19

Sono induzido

13:40:20

Sono induzido

13:40:21

Sono induzido

13:40:22

Sono induzido

13:40:23

Sono induzido

Época: 10 - Horário: 13:40:17 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref


P4 - Ref

T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref

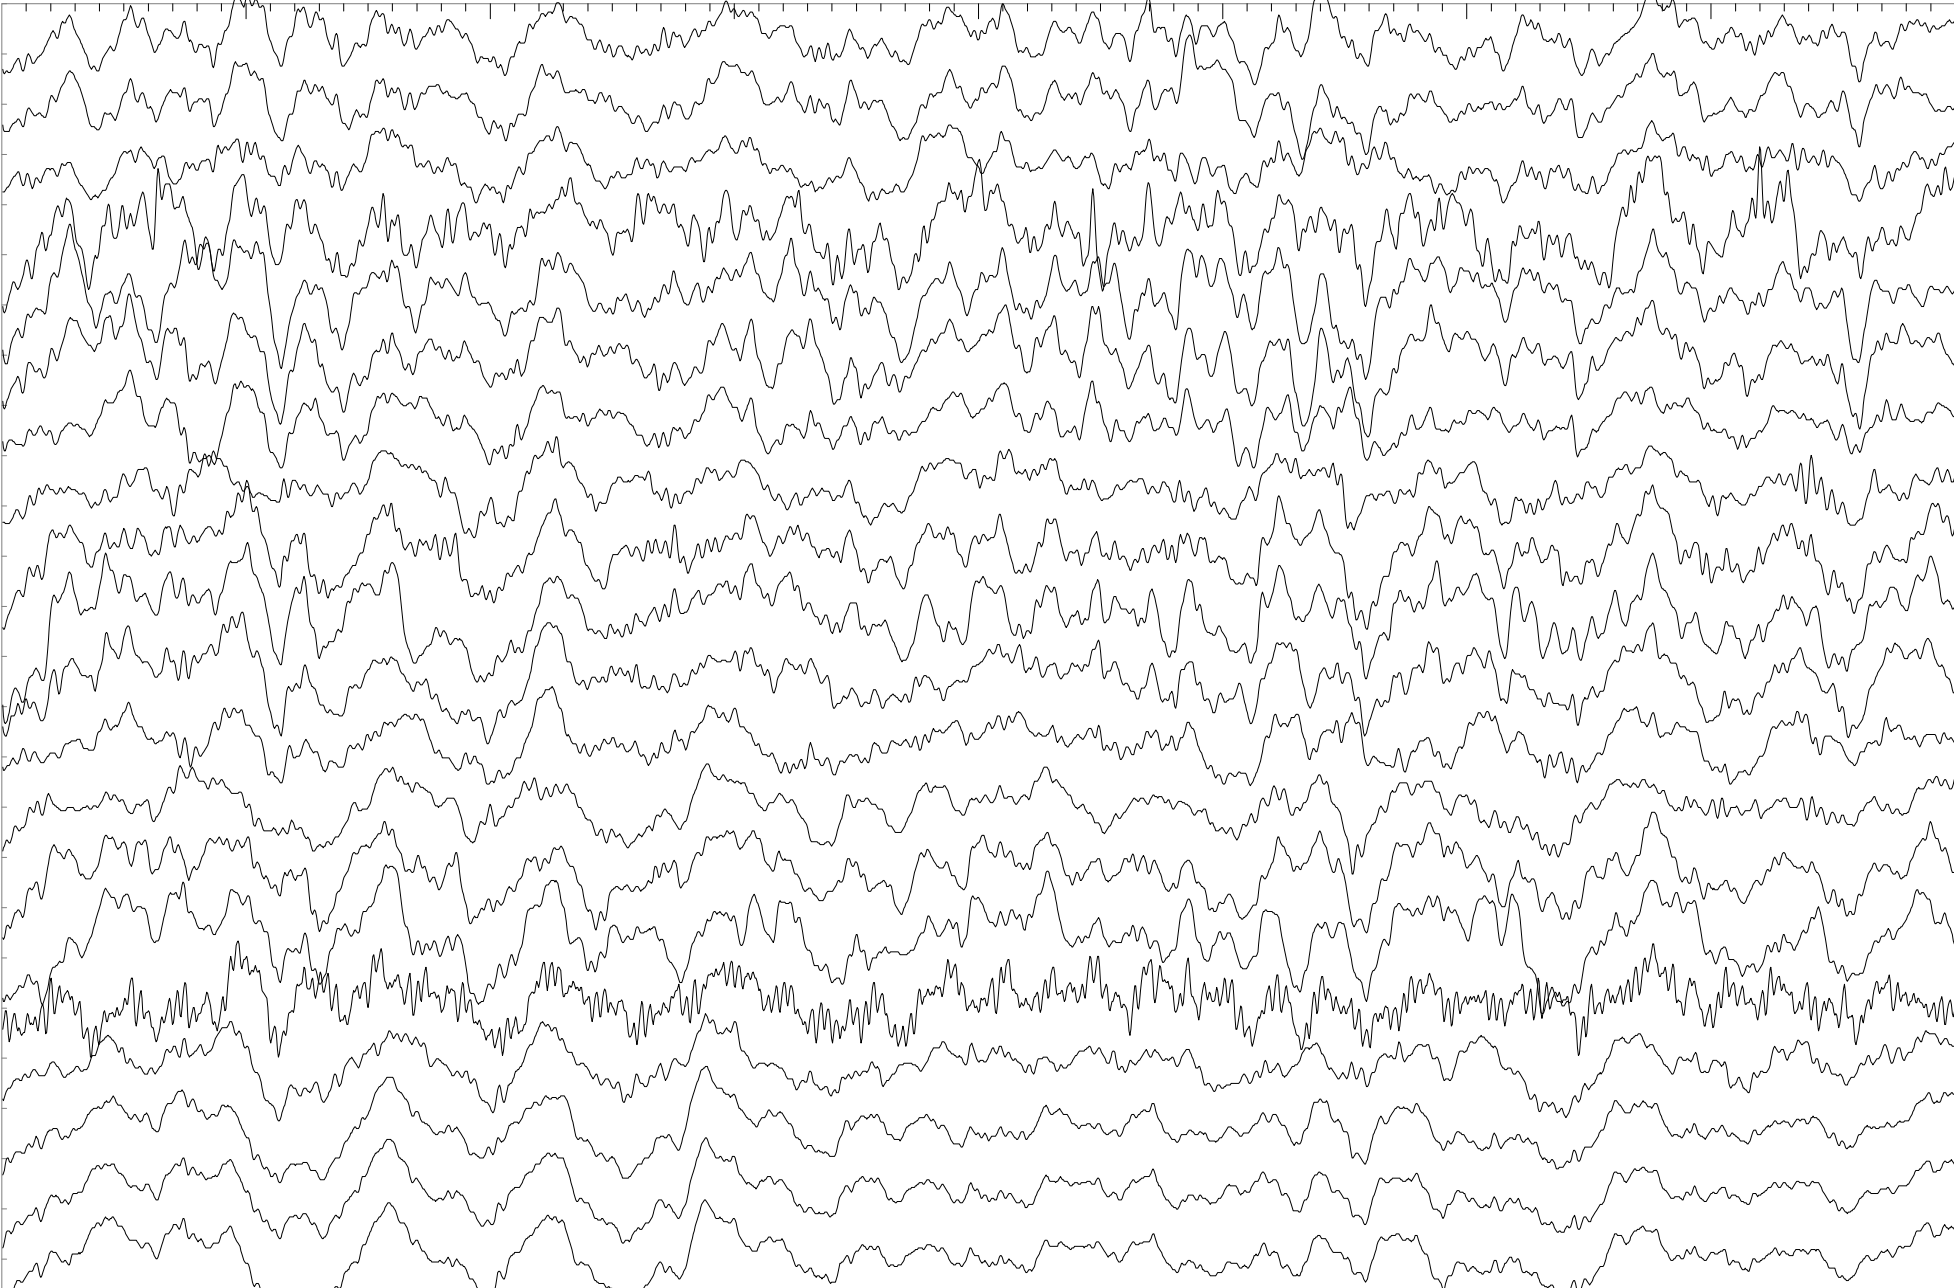

13:42:15

Sono induzido

13:42:16

Sono induzido

13:42:17

Sono induzido

13:42:18

Sono induzido

13:42:19

Sono induzido

13:42:20

Sono induzido

13:42:21

Sono induzido

13:42:22

Sono induzido

Época: 14 - Horário: 13:42:16 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref


P4 - Ref

T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref

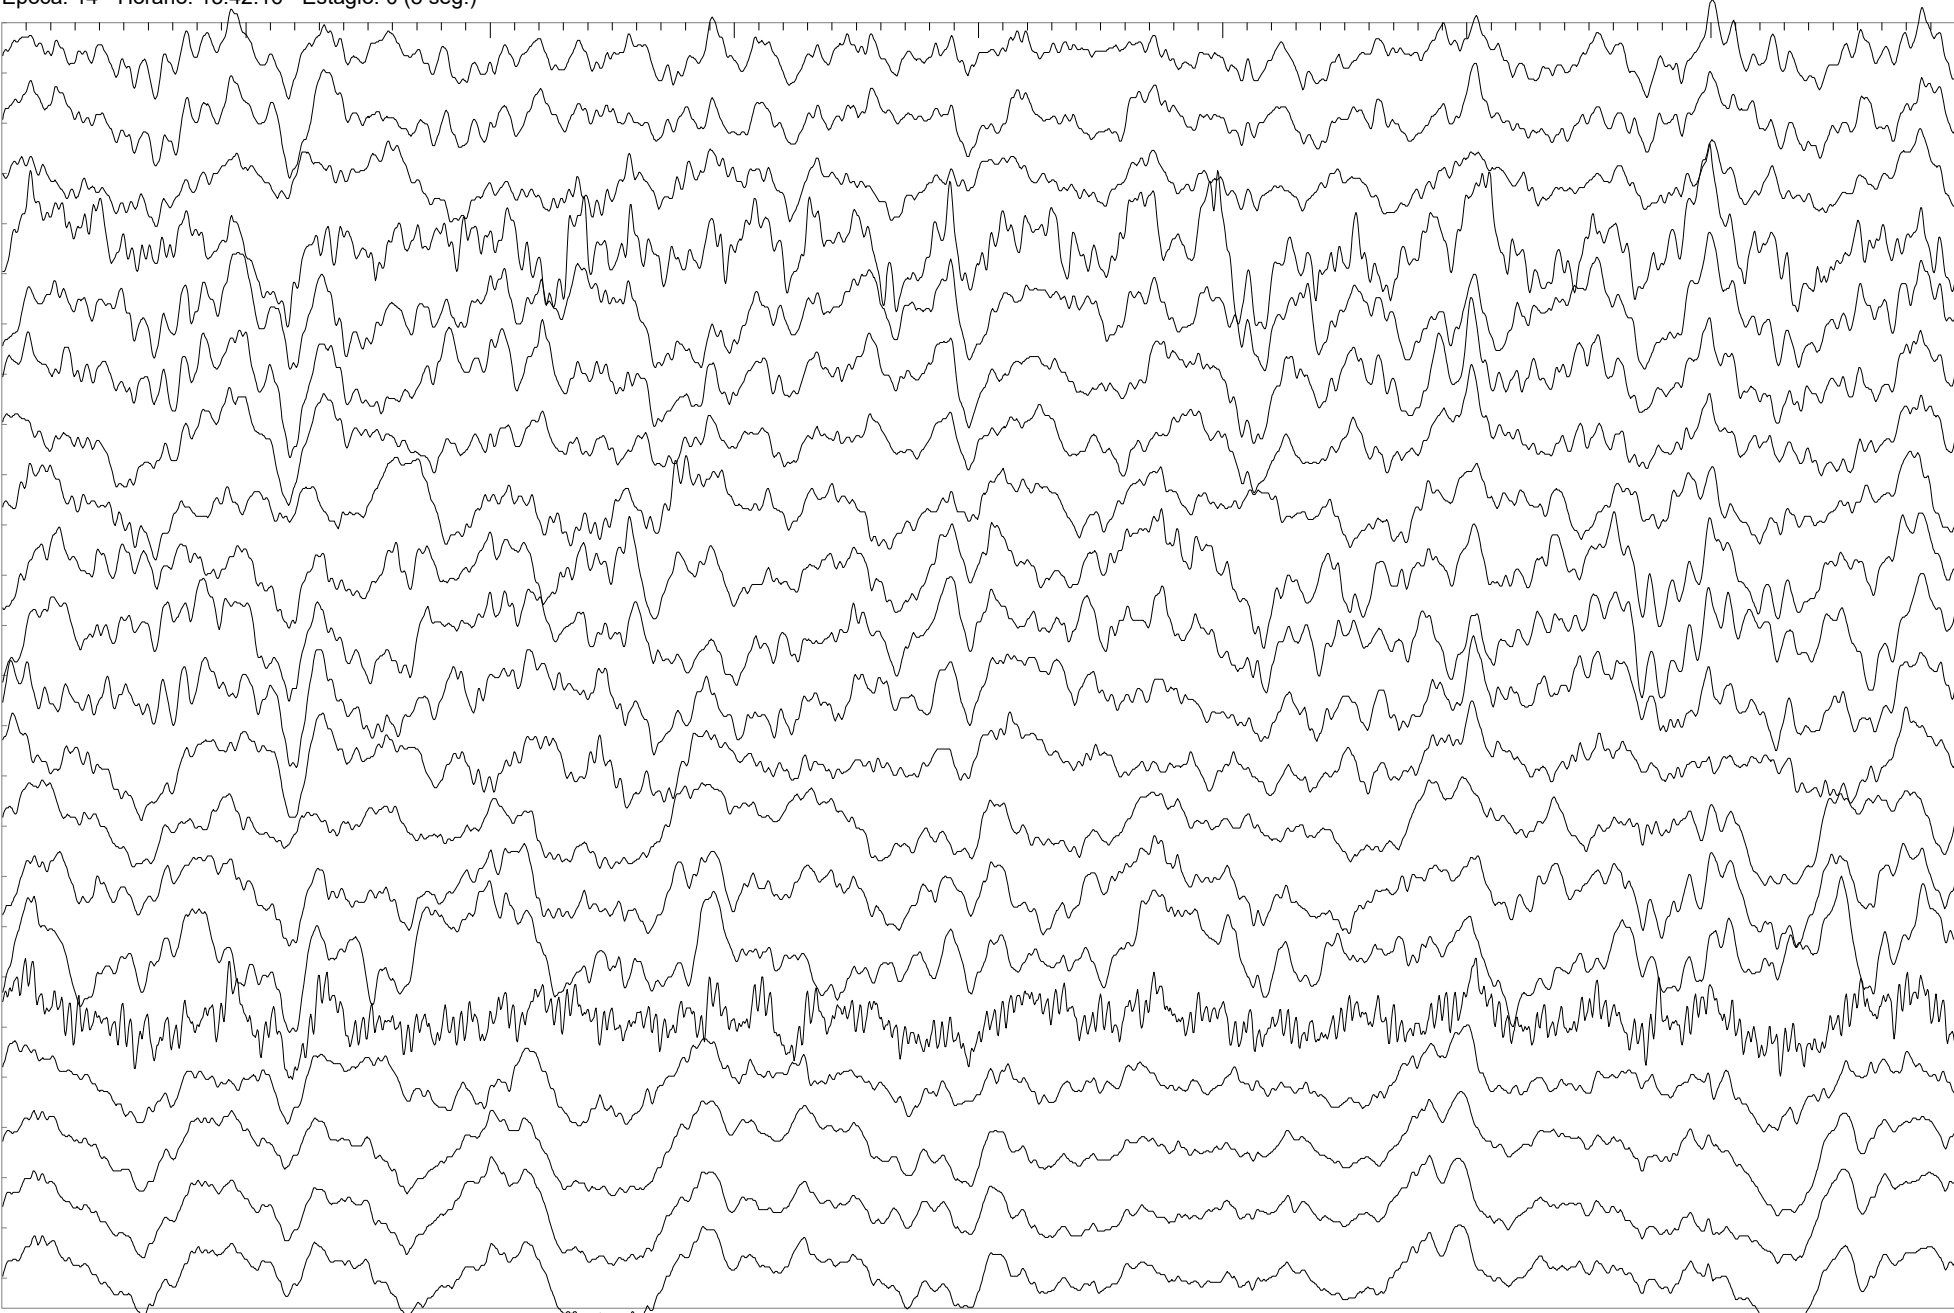

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref


P4 - Ref

T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref

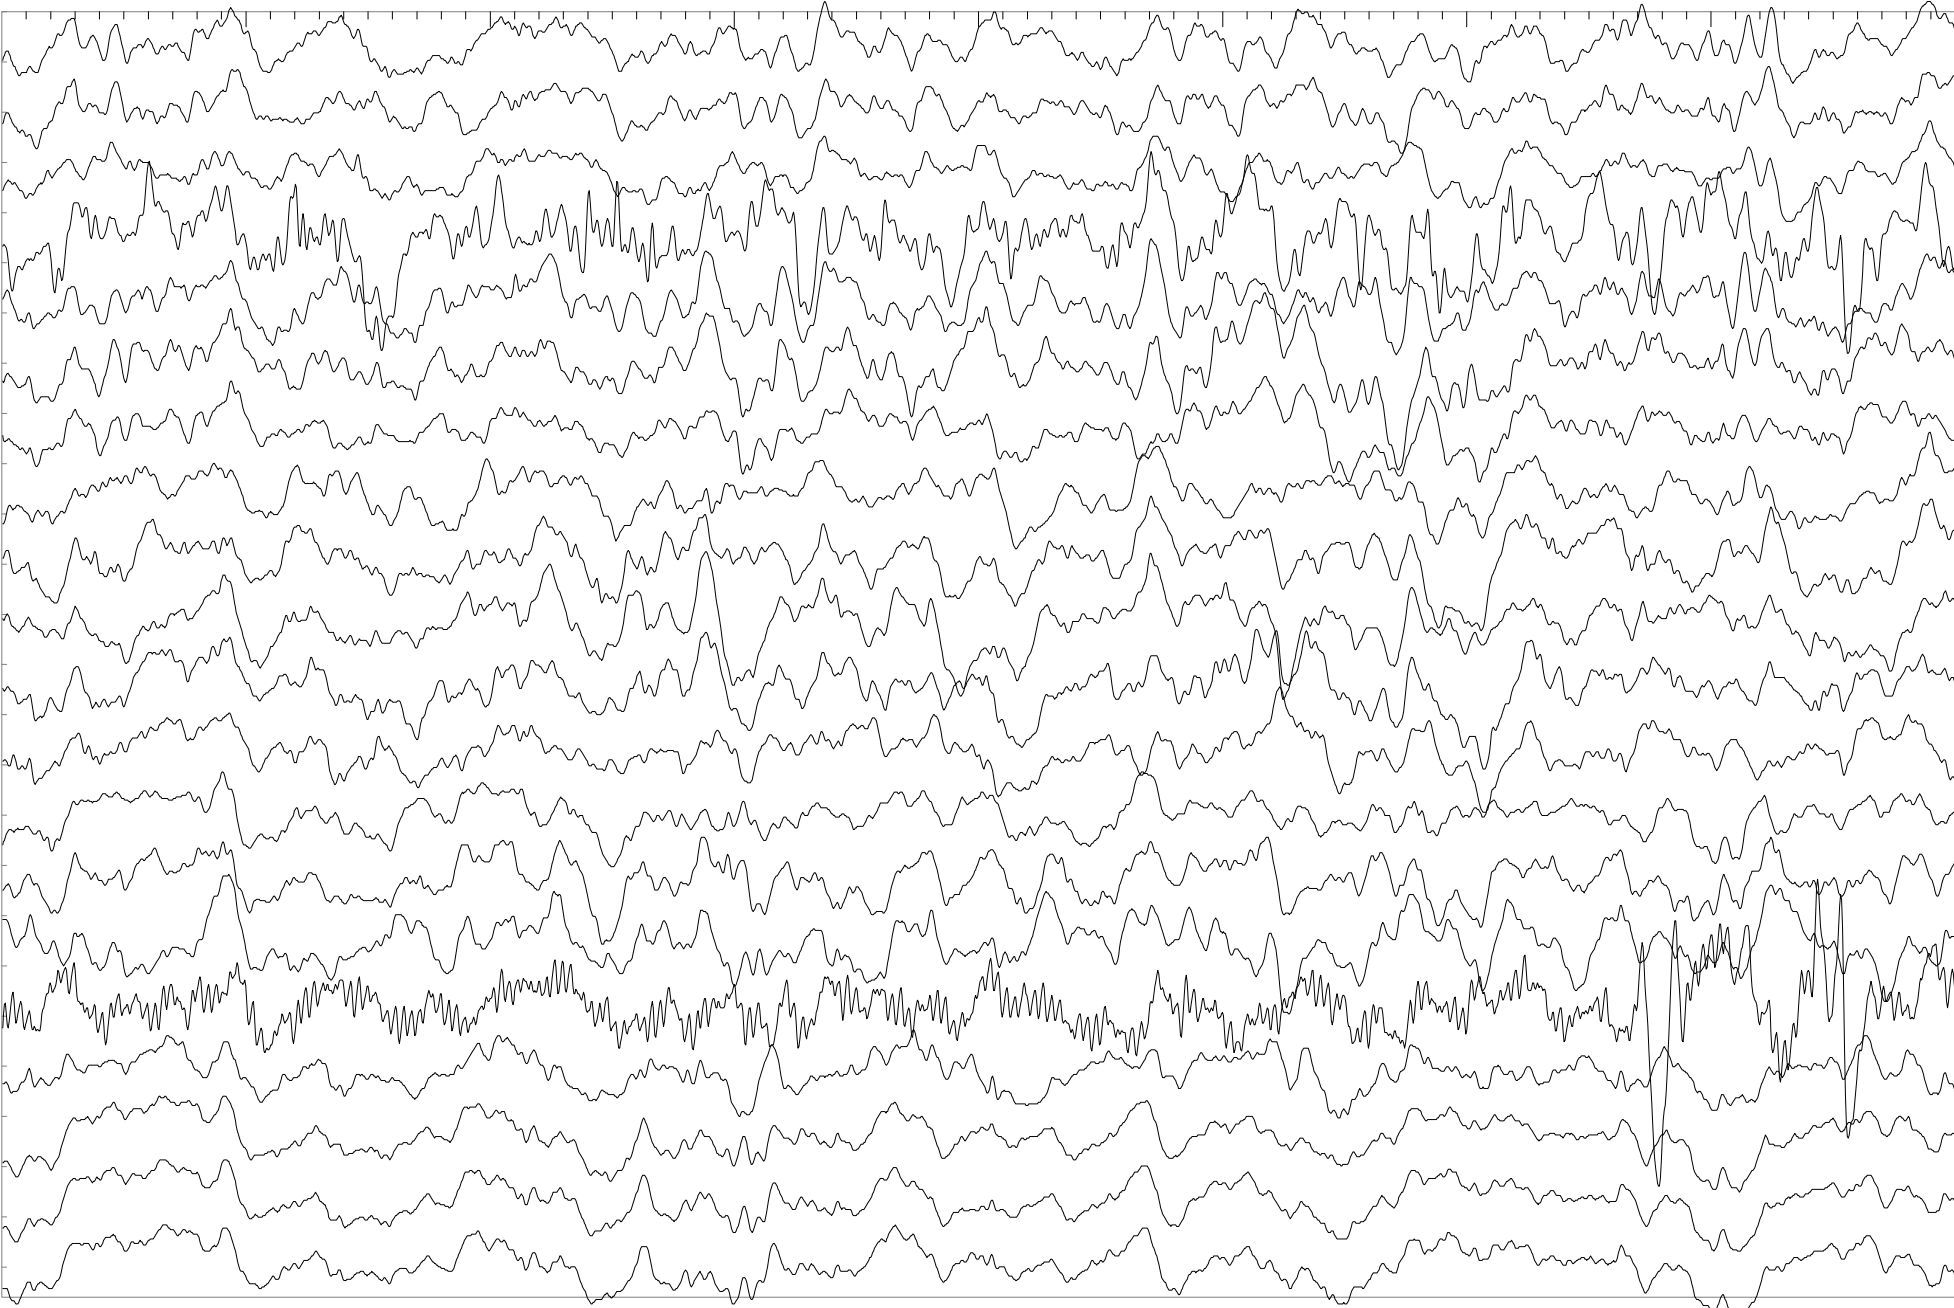

13:43:45

Sono induzido

13:43:46

Sono induzido

13:43:47

Sono induzido

13:43:48

Sono induzido

13:43:49

Sono induzido

13:43:50

Sono induzido

13:43:51

Sono induzido

13:43:52

Sono induzido

Época: 17 - Horário: 13:43:46 - Estágio: 0 (8 seg.)

FP1 - Ref

FP2 - Ref

F7 - Ref

F3 - Ref

FZ - Ref

F4 - Ref

F8 - Ref

T3 - Ref

C3 - Ref

CZ - Ref

C4 - Ref

T4 - Ref

T5 - Ref

P3 - Ref

PZ - Ref


P4 - Ref

T6 - Ref

O1 - Ref

OZ - Ref

O2 - Ref

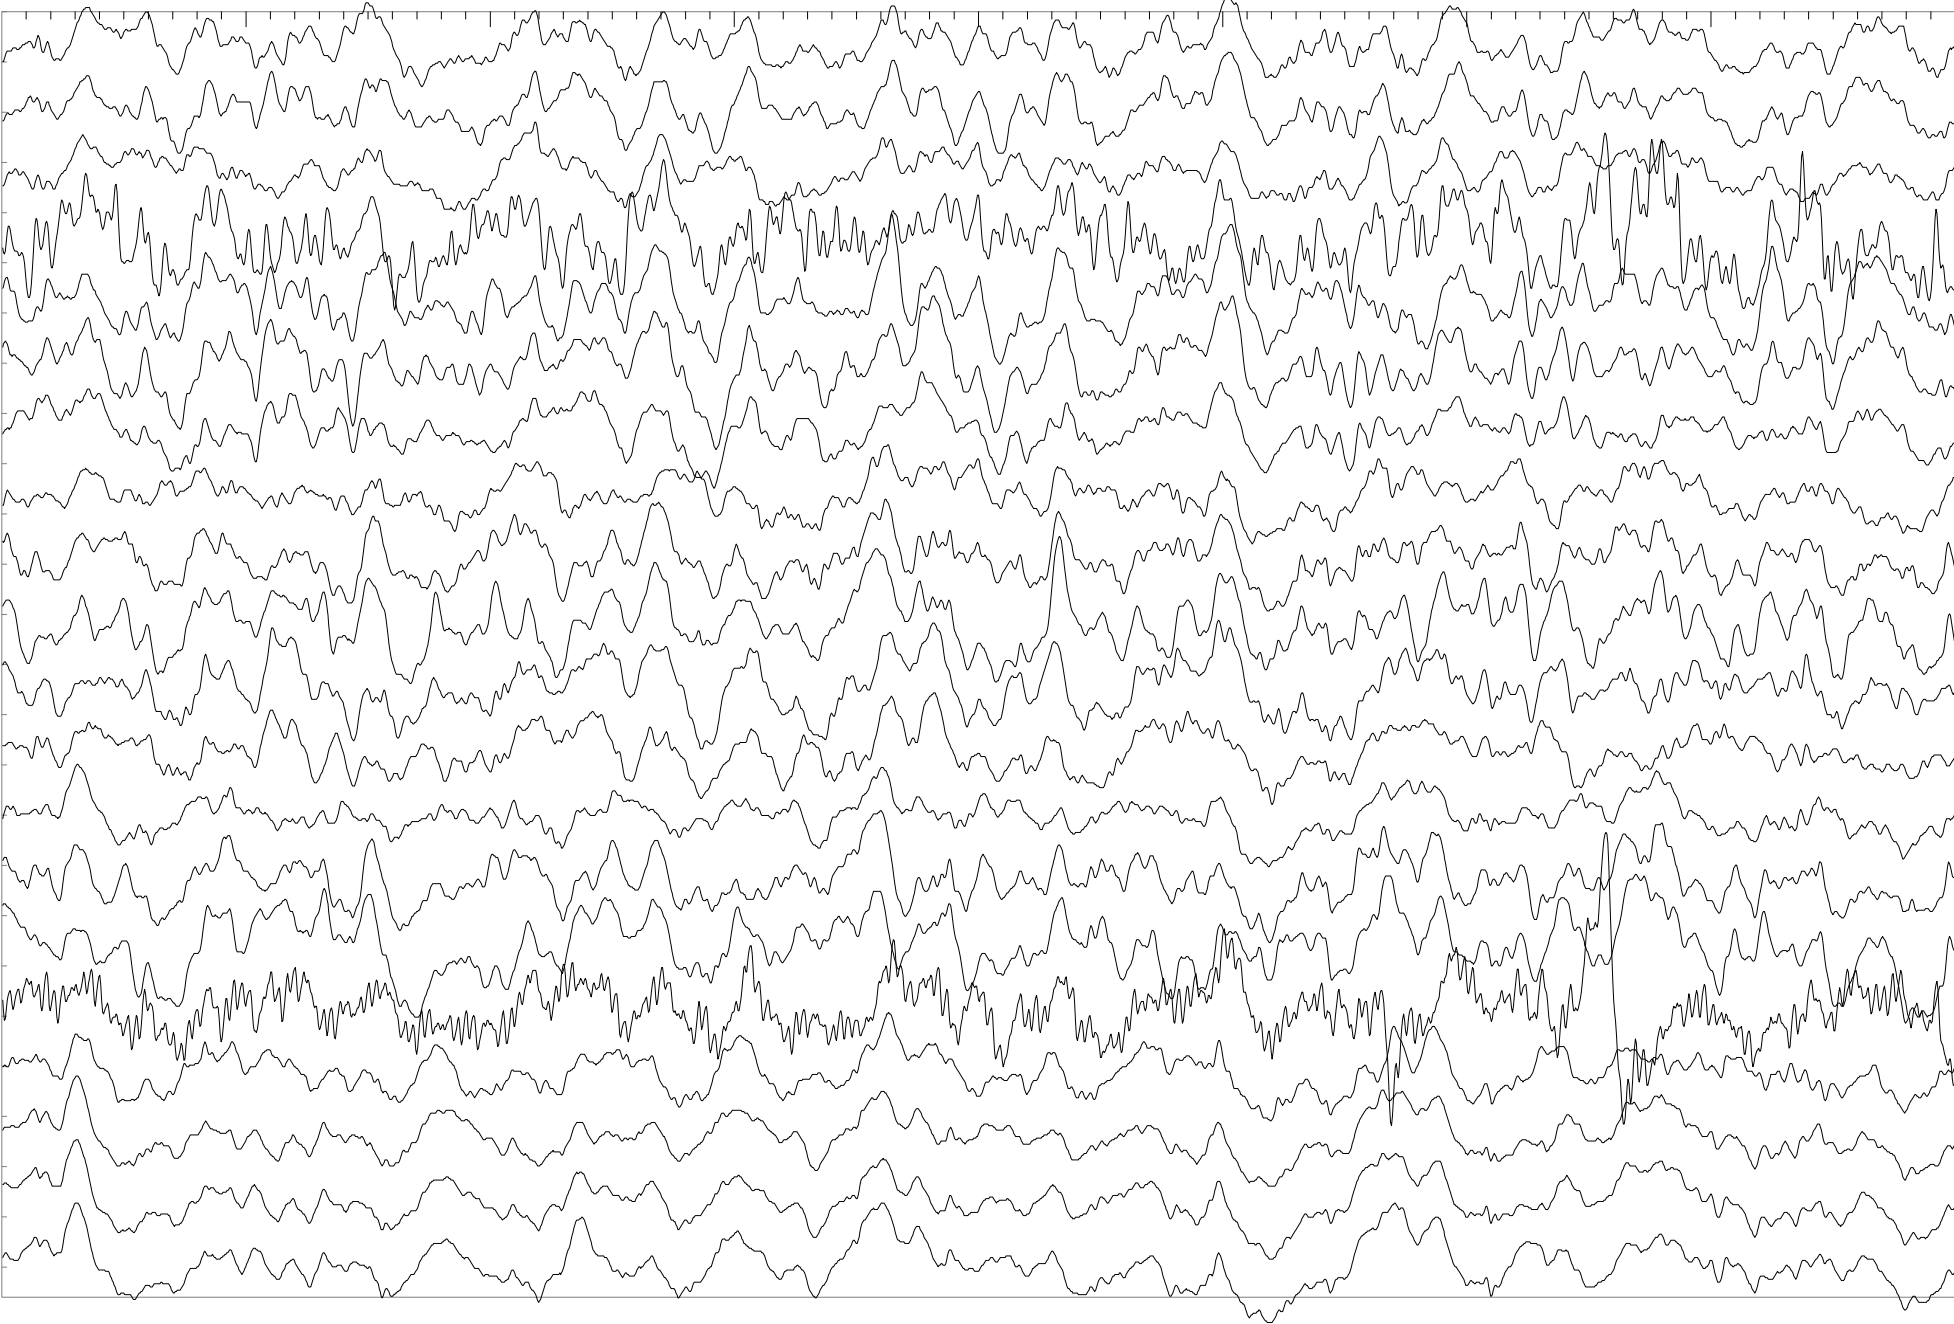

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

13:45:15

13:45:16

13:45:17

13:45:18

13:45:19

13:45:20

13:45:21

13:45:22

Sono induzido

Sono induzido

Sono induzido

Sono induzido


Sono induzido


Sono induzido


Sono induzido

Sono induzido

Época: 20 - Horário: 13:45:16 - Estágio: 0 (8 seg.)

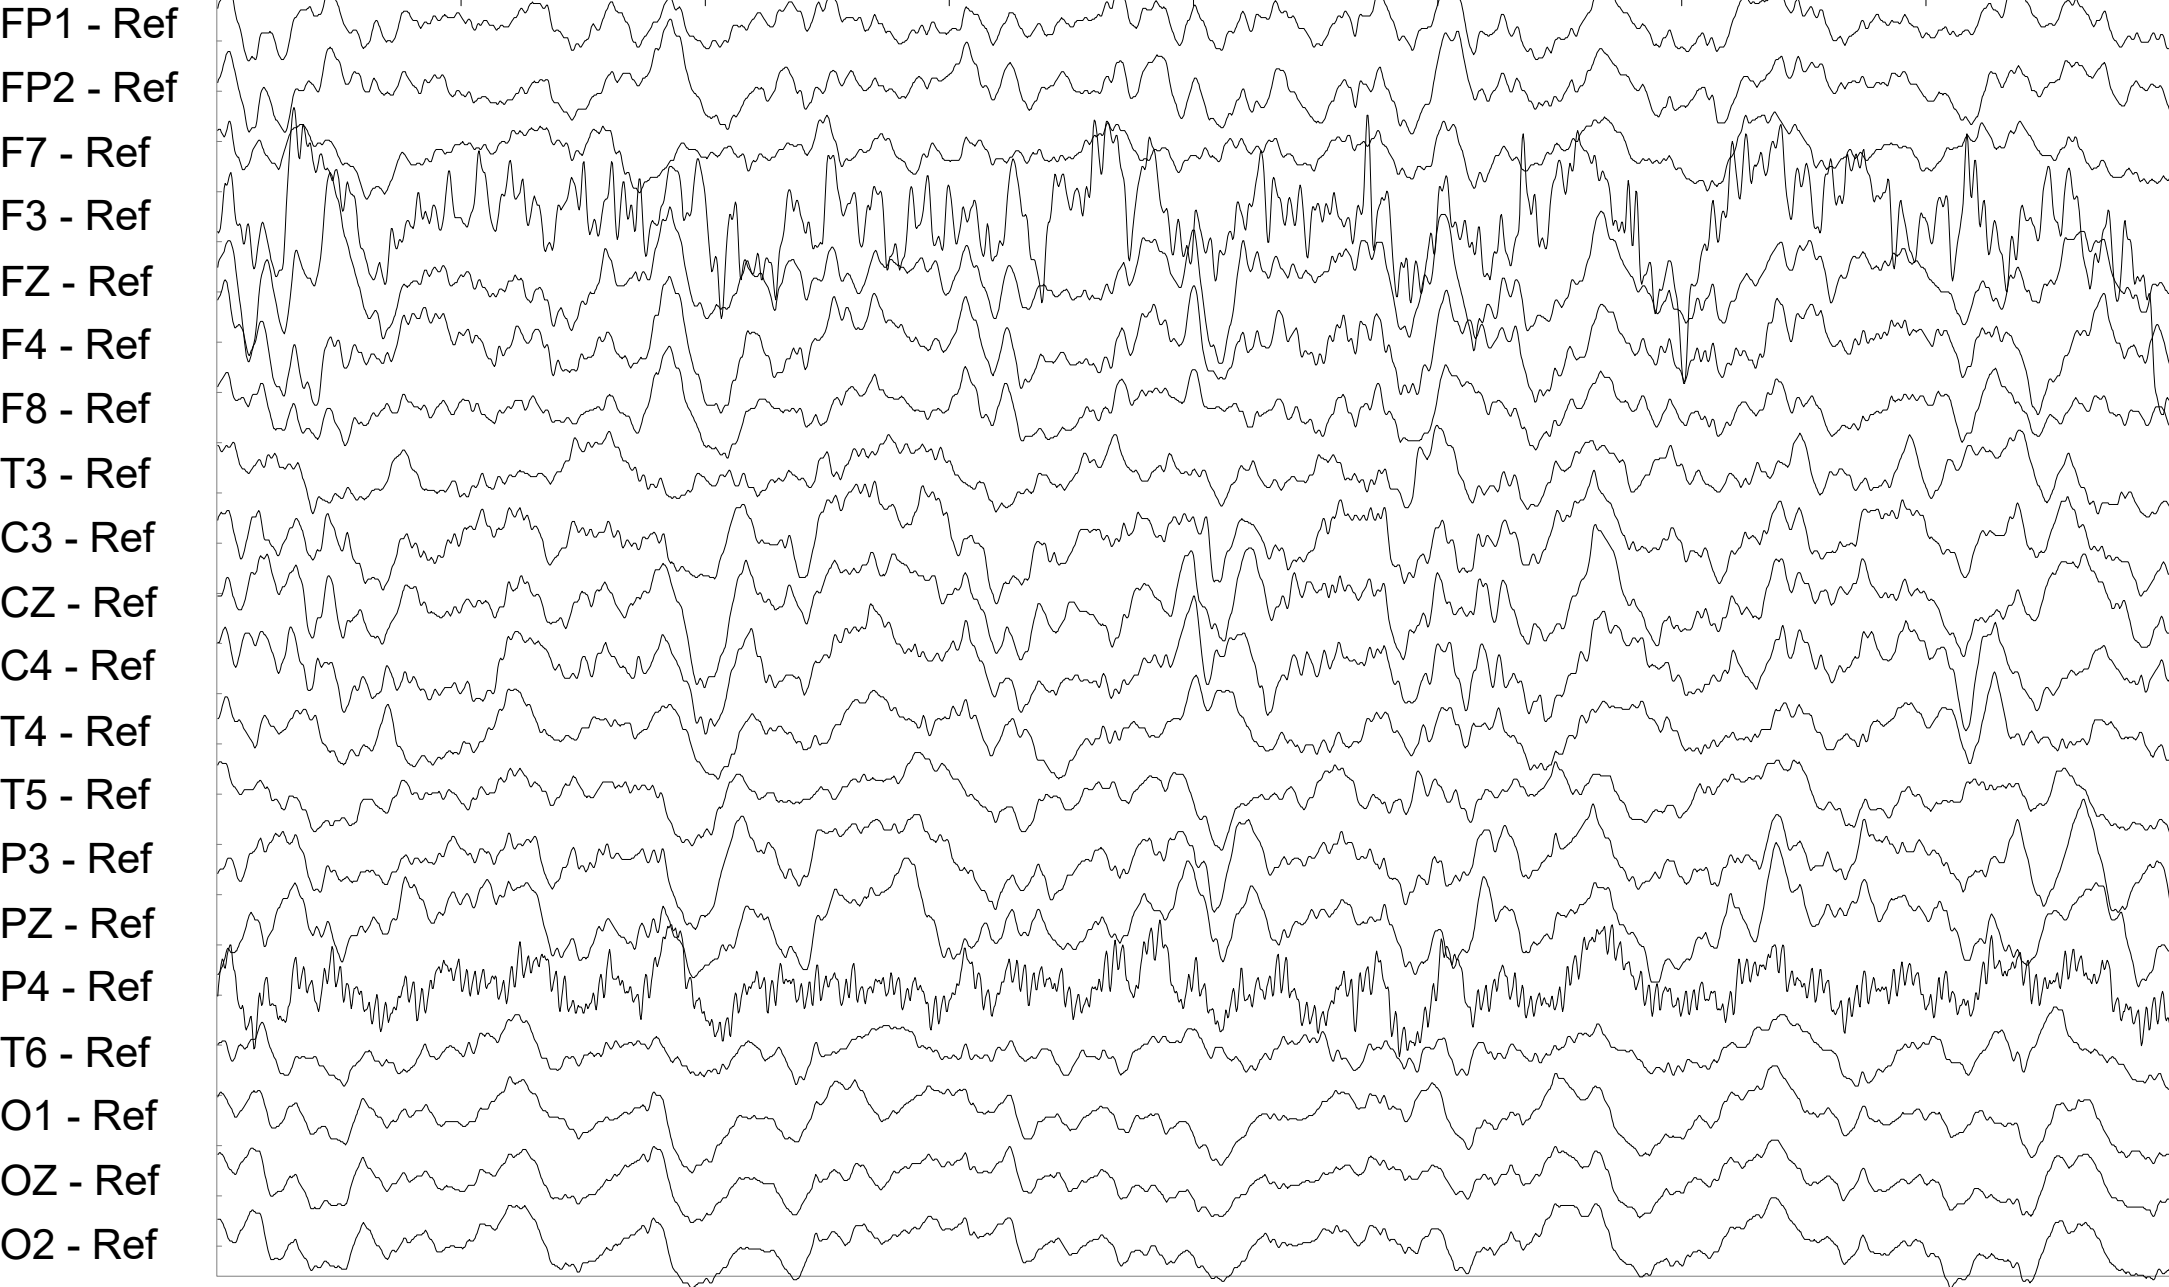

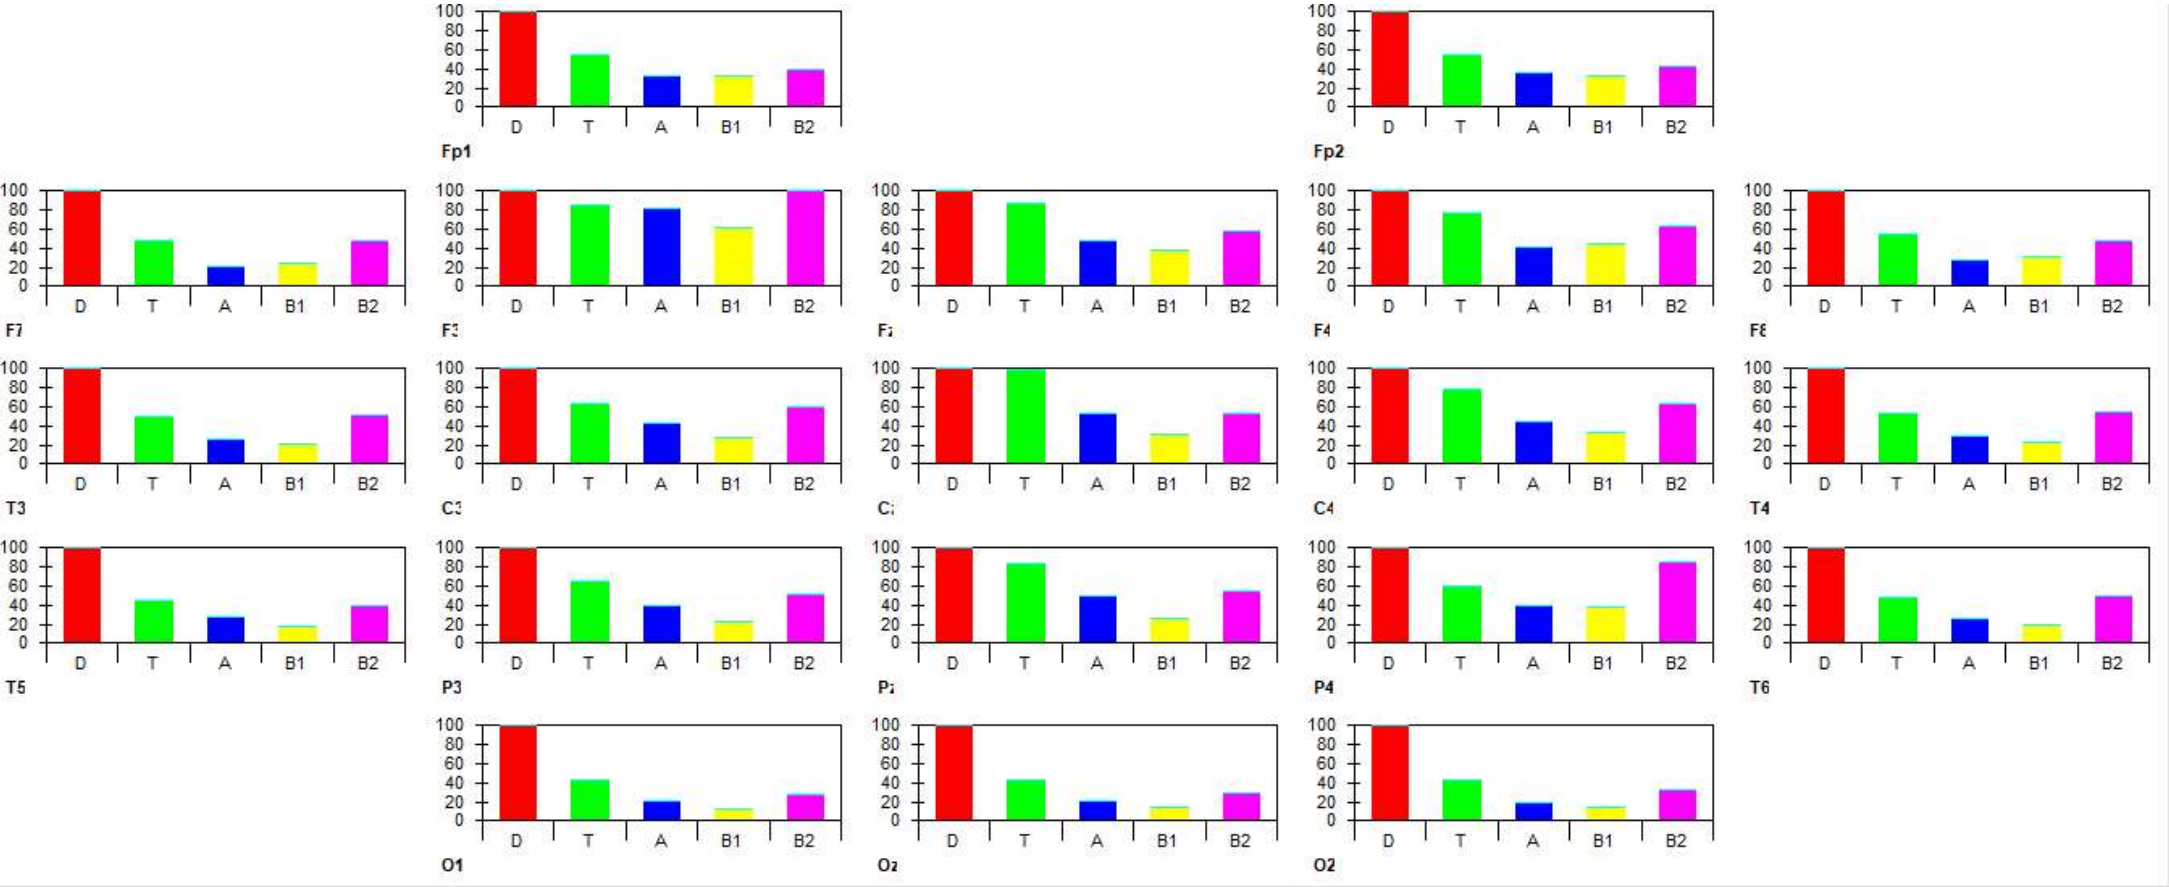

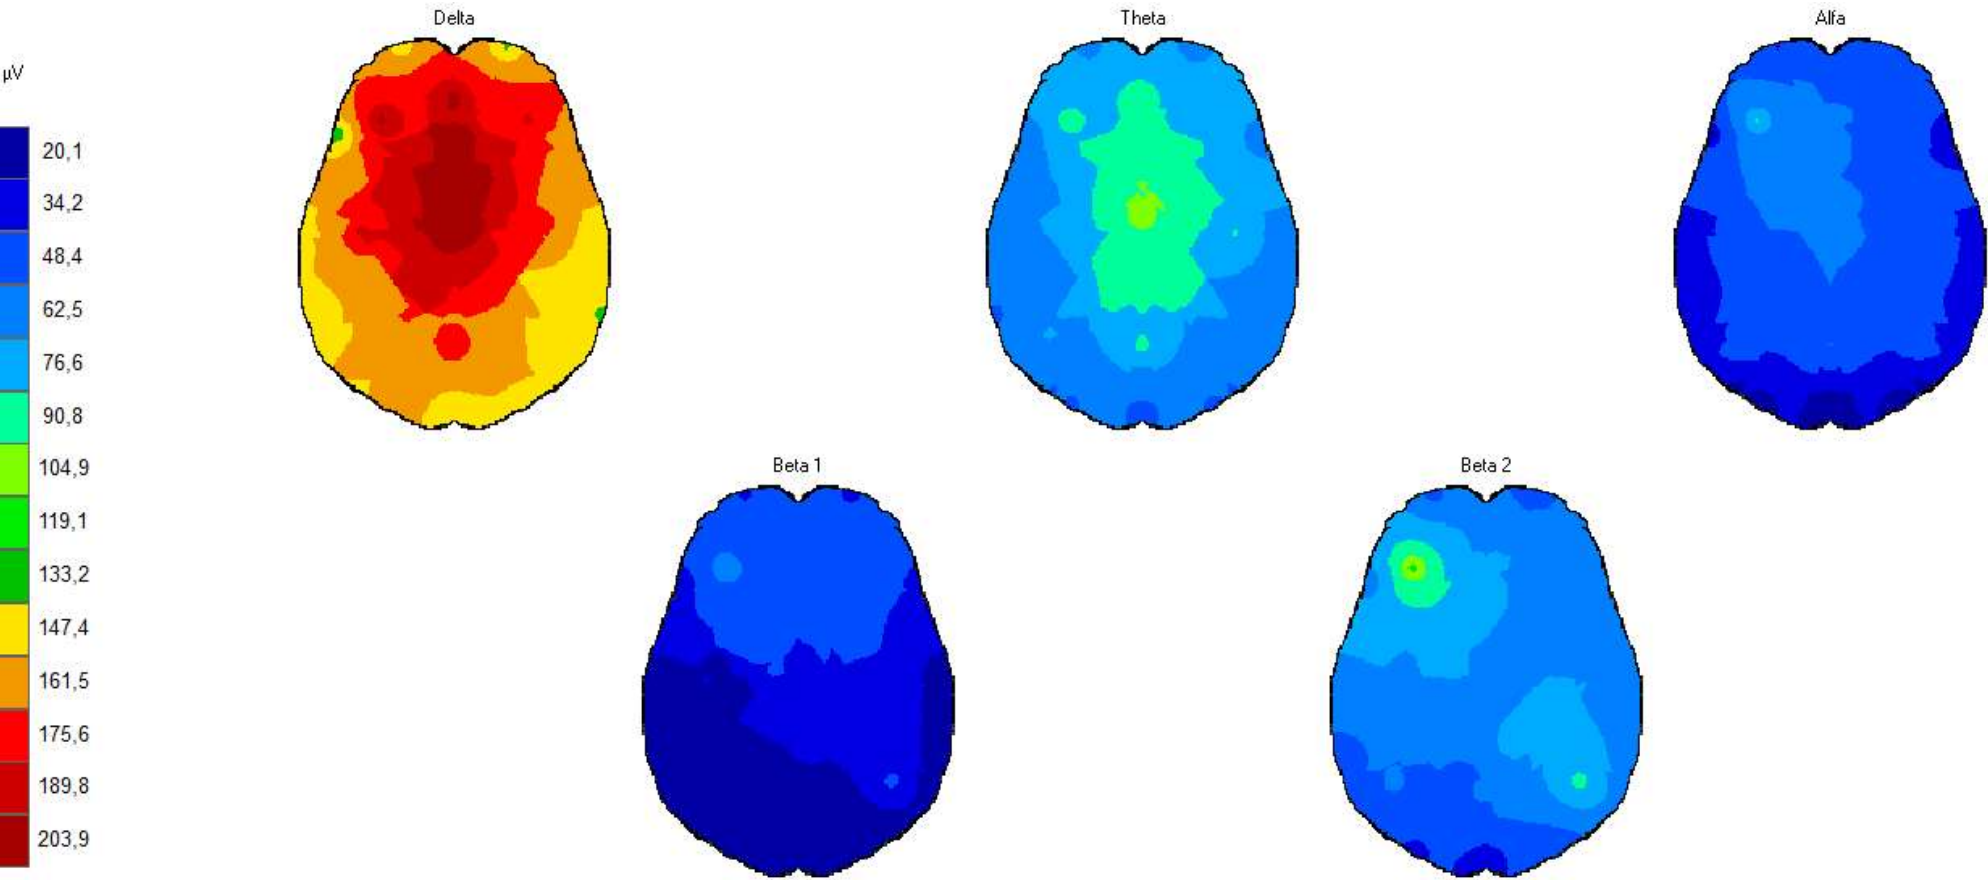

| Ep1 |        |       |      |
|-----|--------|-------|------|
|     | F.Dom. | µV    | µV % |
| D   | .5     | 135,4 | 45,8 |
| T   | 4,0    | 55,5  | 18,8 |
| A   | 12,5   | 32,8  | 11,0 |
| B1  | 13,0   | 32,2  | 10,9 |
| B2  | 18,5   | 39,8  | 13,5 |

| Ep2 |        |       |      |
|-----|--------|-------|------|
|     | F.Dom. | µV    | µV % |
| D   | .5     | 128,7 | 43,8 |
| T   | 4,5    | 54,3  | 18,5 |
| A   | 8,0    | 35,9  | 12,2 |
| B1  | 13,5   | 32,9  | 11,2 |
| B2  | 20,0   | 42,3  | 14,4 |

| F7 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 117,7 | 45,2 |
| T  | 4,5    | 48,1  | 18,5 |
| A  | 9,0    | 21,8  | 8,4  |
| B1 | 16,0   | 24,4  | 9,4  |
| B2 | 20,0   | 48,1  | 18,5 |

| F3 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 199,1 | 36,5 |
| T  | 5,0    | 86,1  | 15,8 |
| A  | 9,0    | 82,1  | 15,1 |
| B1 | 13,0   | 61,3  | 11,2 |
| B2 | 19,0   | 116,4 | 21,4 |

| Fz |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 198,1 | 46,2 |
| T  | 4,0    | 87,5  | 20,4 |
| A  | 9,0    | 47,4  | 11,1 |
| B1 | 13,0   | 37,3  | 8,7  |
| B2 | 20,5   | 58,1  | 13,6 |

| F4 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | 1,0    | 180,8 | 44,6 |
| T  | 4,5    | 78,5  | 18,9 |
| A  | 9,0    | 40,9  | 10,1 |
| B1 | 13,5   | 44,1  | 10,9 |
| B2 | 16,5   | 63,0  | 15,5 |

| F8 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 148,5 | 47,9 |
| T  | 4,0    | 54,5  | 17,8 |
| A  | 9,5    | 27,5  | 8,9  |
| B1 | 13,5   | 31,1  | 10,0 |
| B2 | 20,0   | 48,5  | 15,6 |

| T3 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | 1,5    | 141,0 | 48,7 |
| T  | 4,0    | 49,2  | 17,0 |
| A  | 8,0    | 27,0  | 9,3  |
| B1 | 15,0   | 21,0  | 7,3  |
| B2 | 24,0   | 51,7  | 17,8 |

| C3 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 180,8 | 48,1 |
| T  | 4,0    | 64,0  | 17,0 |
| A  | 9,5    | 43,4  | 11,5 |
| B1 | 13,0   | 27,5  | 7,3  |
| B2 | 18,5   | 60,8  | 16,1 |

| Cz |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 211,2 | 47,1 |
| T  | 4,0    | 98,3  | 21,9 |
| A  | 9,0    | 53,5  | 11,9 |
| B1 | 13,0   | 31,9  | 7,1  |
| B2 | 18,5   | 53,8  | 12,0 |

| C4 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 162,1 | 42,5 |
| T  | 4,0    | 78,0  | 20,5 |
| A  | 8,0    | 44,9  | 11,8 |
| B1 | 13,5   | 33,2  | 8,7  |
| B2 | 18,5   | 63,0  | 16,5 |

| T4 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 136,8 | 46,7 |
| T  | 4,0    | 53,1  | 17,9 |
| A  | 8,0    | 29,0  | 9,8  |
| B1 | 13,0   | 22,1  | 7,4  |
| B2 | 20,5   | 54,2  | 18,2 |

| T5 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 132,0 | 50,5 |
| T  | 4,5    | 44,3  | 16,9 |
| A  | 10,5   | 27,6  | 10,6 |
| B1 | 13,5   | 18,3  | 7,0  |
| B2 | 19,0   | 39,2  | 15,0 |

| P3 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 150,2 | 45,6 |
| T  | 4,0    | 64,5  | 19,8 |
| A  | 9,0    | 39,1  | 11,9 |
| B1 | 14,0   | 23,3  | 7,1  |
| B2 | 19,0   | 52,2  | 15,8 |

| Pz |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 174,5 | 44,8 |
| T  | 4,0    | 84,2  | 21,8 |
| A  | 8,5    | 50,3  | 12,9 |
| B1 | 13,5   | 26,5  | 6,8  |
| B2 | 21,0   | 54,4  | 13,9 |

| P4 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | 1,5    | 145,4 | 39,3 |
| T  | 4,0    | 80,8  | 18,4 |
| A  | 9,0    | 39,7  | 10,7 |
| B1 | 13,5   | 38,1  | 10,3 |
| B2 | 27,5   | 86,1  | 23,3 |

| T6 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 129,1 | 47,2 |
| T  | 4,5    | 48,5  | 17,7 |
| A  | 8,0    | 26,5  | 9,7  |
| B1 | 13,5   | 20,2  | 7,4  |
| B2 | 27,0   | 49,1  | 18,0 |

| O1 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 149,5 | 50,5 |
| T  | 4,0    | 43,3  | 16,9 |
| A  | 8,5    | 21,2  | 8,3  |
| B1 | 14,5   | 13,1  | 5,1  |
| B2 | 19,0   | 28,4  | 11,1 |

| Oz |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 136,1 | 58,1 |
| T  | 4,5    | 42,3  | 17,4 |
| A  | 8,0    | 20,4  | 8,4  |
| B1 | 14,5   | 13,5  | 5,8  |
| B2 | 19,5   | 30,2  | 12,4 |

| O2 |        |       |      |
|----|--------|-------|------|
|    | F.Dom. | µV    | µV % |
| D  | .5     | 142,9 | 56,5 |
| T  | 4,5    | 43,4  | 17,1 |
| A  | 8,0    | 20,0  | 7,9  |
| B1 | 14,5   | 13,7  | 5,4  |
| B2 | 21,0   | 33,0  | 13,0 |

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

|     | Delta  |       |      | Theta  |      |      | Alfa   |      |      | Beta 1 |      |      | Beta 2 |       |      |
|-----|--------|-------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|-------|------|
|     | F.Dom. | µV    | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV    | µV % |
| FP1 | .5     | 135,4 | 45,8 | 4,0    | 55,5 | 18,8 | 12,5   | 32,6 | 11,0 | 13,0   | 32,2 | 10,9 | 18,5   | 39,8  | 13,5 |
| FP2 | .5     | 128,7 | 43,8 | 4,5    | 54,3 | 18,5 | 8,0    | 35,9 | 12,2 | 13,5   | 32,9 | 11,2 | 20,0   | 42,3  | 14,4 |
| F7  | .5     | 117,7 | 45,2 | 4,5    | 48,1 | 18,5 | 9,0    | 21,8 | 8,4  | 16,0   | 24,4 | 9,4  | 20,0   | 48,1  | 18,5 |
| F3  | .5     | 199,1 | 36,5 | 5,0    | 86,1 | 15,8 | 9,0    | 82,1 | 15,1 | 13,0   | 61,3 | 11,2 | 19,0   | 116,4 | 21,4 |
| FZ  | .5     | 198,1 | 46,2 | 4,0    | 87,5 | 20,4 | 9,0    | 47,4 | 11,1 | 13,0   | 37,3 | 8,7  | 20,5   | 58,1  | 13,6 |
| F4  | 1,0    | 180,6 | 44,6 | 4,5    | 76,5 | 18,9 | 9,0    | 40,9 | 10,1 | 13,5   | 44,1 | 10,9 | 18,5   | 63,0  | 15,5 |
| F8  | .5     | 148,5 | 47,9 | 4,0    | 54,5 | 17,6 | 9,5    | 27,5 | 8,9  | 13,5   | 31,1 | 10,0 | 20,0   | 48,5  | 15,6 |
| T3  | 1,5    | 141,0 | 48,7 | 4,0    | 49,2 | 17,0 | 8,0    | 27,0 | 9,3  | 15,0   | 21,0 | 7,3  | 24,0   | 51,7  | 17,8 |
| C3  | .5     | 180,8 | 48,1 | 4,0    | 64,0 | 17,0 | 9,5    | 43,4 | 11,5 | 13,0   | 27,5 | 7,3  | 18,5   | 60,6  | 16,1 |
| CZ  | .5     | 211,2 | 47,1 | 4,0    | 98,3 | 21,9 | 9,0    | 53,5 | 11,9 | 13,0   | 31,9 | 7,1  | 18,5   | 53,6  | 12,0 |
| C4  | .5     | 162,1 | 42,5 | 4,0    | 78,0 | 20,5 | 8,0    | 44,9 | 11,8 | 13,5   | 33,2 | 8,7  | 18,5   | 63,0  | 16,5 |
| T4  | .5     | 138,8 | 46,7 | 4,0    | 53,1 | 17,9 | 8,0    | 29,0 | 9,8  | 13,0   | 22,1 | 7,4  | 20,5   | 54,2  | 18,2 |
| T5  | .5     | 132,0 | 50,5 | 4,5    | 44,3 | 16,9 | 10,5   | 27,6 | 10,6 | 13,5   | 18,3 | 7,0  | 19,0   | 39,2  | 15,0 |
| P3  | .5     | 150,2 | 45,6 | 4,0    | 64,5 | 19,6 | 9,0    | 39,1 | 11,9 | 14,0   | 23,3 | 7,1  | 19,0   | 52,2  | 15,8 |
| PZ  | .5     | 174,5 | 44,8 | 4,0    | 84,2 | 21,6 | 8,5    | 50,3 | 12,9 | 13,5   | 26,5 | 6,8  | 21,0   | 54,4  | 13,9 |
| P4  | 1,5    | 145,4 | 39,3 | 4,0    | 60,8 | 16,4 | 9,0    | 39,7 | 10,7 | 13,5   | 38,1 | 10,3 | 27,5   | 86,1  | 23,3 |
| T6  | .5     | 129,1 | 47,2 | 4,5    | 48,5 | 17,7 | 8,0    | 26,5 | 9,7  | 13,5   | 20,2 | 7,4  | 27,0   | 49,1  | 18,0 |
| O1  | .5     | 149,5 | 58,5 | 4,0    | 43,3 | 16,9 | 8,5    | 21,2 | 8,3  | 14,5   | 13,1 | 5,1  | 19,0   | 28,4  | 11,1 |
| OZ  | .5     | 136,1 | 56,1 | 4,5    | 42,3 | 17,4 | 8,0    | 20,4 | 8,4  | 14,5   | 13,5 | 5,6  | 19,5   | 30,2  | 12,4 |
| O2  | .5     | 142,9 | 56,5 | 4,5    | 43,4 | 17,1 | 8,0    | 20,0 | 7,9  | 14,5   | 13,7 | 5,4  | 21,0   | 33,0  | 13,0 |

NEUROCLINIC

Informe o nome do médico

|     | Delta  |       |      | Theta  |      |      | Alfa   |      |      | Beta 1 |      |      | Beta 2 |       |      |
|-----|--------|-------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|-------|------|
|     | F.Dom. | µV    | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV   | µV % | F.Dom. | µV    | µV % |
| FP1 | ,5     | 135,4 | 45,8 | 4,0    | 55,5 | 18,8 | 12,5   | 32,6 | 11,0 | 13,0   | 32,2 | 10,9 | 18,5   | 39,8  | 13,5 |
| FP2 | ,5     | 128,7 | 43,8 | 4,5    | 54,3 | 18,5 | 8,0    | 35,9 | 12,2 | 13,5   | 32,9 | 11,2 | 20,0   | 42,3  | 14,4 |
| F7  | ,5     | 117,7 | 45,2 | 4,5    | 48,1 | 18,5 | 9,0    | 21,8 | 8,4  | 16,0   | 24,4 | 9,4  | 20,0   | 48,1  | 18,5 |
| F3  | ,5     | 199,1 | 36,5 | 5,0    | 86,1 | 15,8 | 9,0    | 82,1 | 15,1 | 13,0   | 61,3 | 11,2 | 19,0   | 116,4 | 21,4 |
| FZ  | ,5     | 198,1 | 46,2 | 4,0    | 87,5 | 20,4 | 9,0    | 47,4 | 11,1 | 13,0   | 37,3 | 8,7  | 20,5   | 58,1  | 13,6 |
| F4  | 1,0    | 180,6 | 44,6 | 4,5    | 76,5 | 18,9 | 9,0    | 40,9 | 10,1 | 13,5   | 44,1 | 10,9 | 18,5   | 63,0  | 15,5 |
| F8  | ,5     | 148,5 | 47,9 | 4,0    | 54,5 | 17,6 | 9,5    | 27,5 | 8,9  | 13,5   | 31,1 | 10,0 | 20,0   | 48,5  | 15,6 |
| T3  | 1,5    | 141,0 | 48,7 | 4,0    | 49,2 | 17,0 | 8,0    | 27,0 | 9,3  | 15,0   | 21,0 | 7,3  | 24,0   | 51,7  | 17,8 |
| C3  | ,5     | 180,8 | 48,1 | 4,0    | 64,0 | 17,0 | 9,5    | 43,4 | 11,5 | 13,0   | 27,5 | 7,3  | 18,5   | 60,6  | 16,1 |
| CZ  | ,5     | 211,2 | 47,1 | 4,0    | 98,3 | 21,9 | 9,0    | 53,5 | 11,9 | 13,0   | 31,9 | 7,1  | 18,5   | 53,6  | 12,0 |
| C4  | ,5     | 162,1 | 42,5 | 4,0    | 78,0 | 20,5 | 8,0    | 44,9 | 11,8 | 13,5   | 33,2 | 8,7  | 18,5   | 63,0  | 16,5 |
| T4  | ,5     | 138,8 | 46,7 | 4,0    | 53,1 | 17,9 | 8,0    | 29,0 | 9,8  | 13,0   | 22,1 | 7,4  | 20,5   | 54,2  | 18,2 |
| T5  | ,5     | 132,0 | 50,5 | 4,5    | 44,3 | 16,9 | 10,5   | 27,6 | 10,6 | 13,5   | 18,3 | 7,0  | 19,0   | 39,2  | 15,0 |
| P3  | ,5     | 150,2 | 45,6 | 4,0    | 64,5 | 19,6 | 9,0    | 39,1 | 11,9 | 14,0   | 23,3 | 7,1  | 19,0   | 52,2  | 15,8 |
| PZ  | ,5     | 174,5 | 44,8 | 4,0    | 84,2 | 21,6 | 8,5    | 50,3 | 12,9 | 13,5   | 26,5 | 6,8  | 21,0   | 54,4  | 13,9 |
| P4  | 1,5    | 145,4 | 39,3 | 4,0    | 60,8 | 16,4 | 9,0    | 39,7 | 10,7 | 13,5   | 38,1 | 10,3 | 27,5   | 86,1  | 23,3 |
| T6  | ,5     | 129,1 | 47,2 | 4,5    | 48,5 | 17,7 | 8,0    | 26,5 | 9,7  | 13,5   | 20,2 | 7,4  | 27,0   | 49,1  | 18,0 |
| O1  | ,5     | 149,5 | 58,5 | 4,0    | 43,3 | 16,9 | 8,5    | 21,2 | 8,3  | 14,5   | 13,1 | 5,1  | 19,0   | 28,4  | 11,1 |
| OZ  | ,5     | 136,1 | 56,1 | 4,5    | 42,3 | 17,4 | 8,0    | 20,4 | 8,4  | 14,5   | 13,5 | 5,6  | 19,5   | 30,2  | 12,4 |
| O2  | ,5     | 142,9 | 56,5 | 4,5    | 43,4 | 17,1 | 8,0    | 20,0 | 7,9  | 14,5   | 13,7 | 5,4  | 21,0   | 33,0  | 13,0 |

Relação de modos de gravação e eventos

| <u>Época</u> | <u>Horário</u> | <u>Duração</u> | <u>Descrição</u> |
|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 1            | 13:35:46       | 10:00          | Sono induzido    |