[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

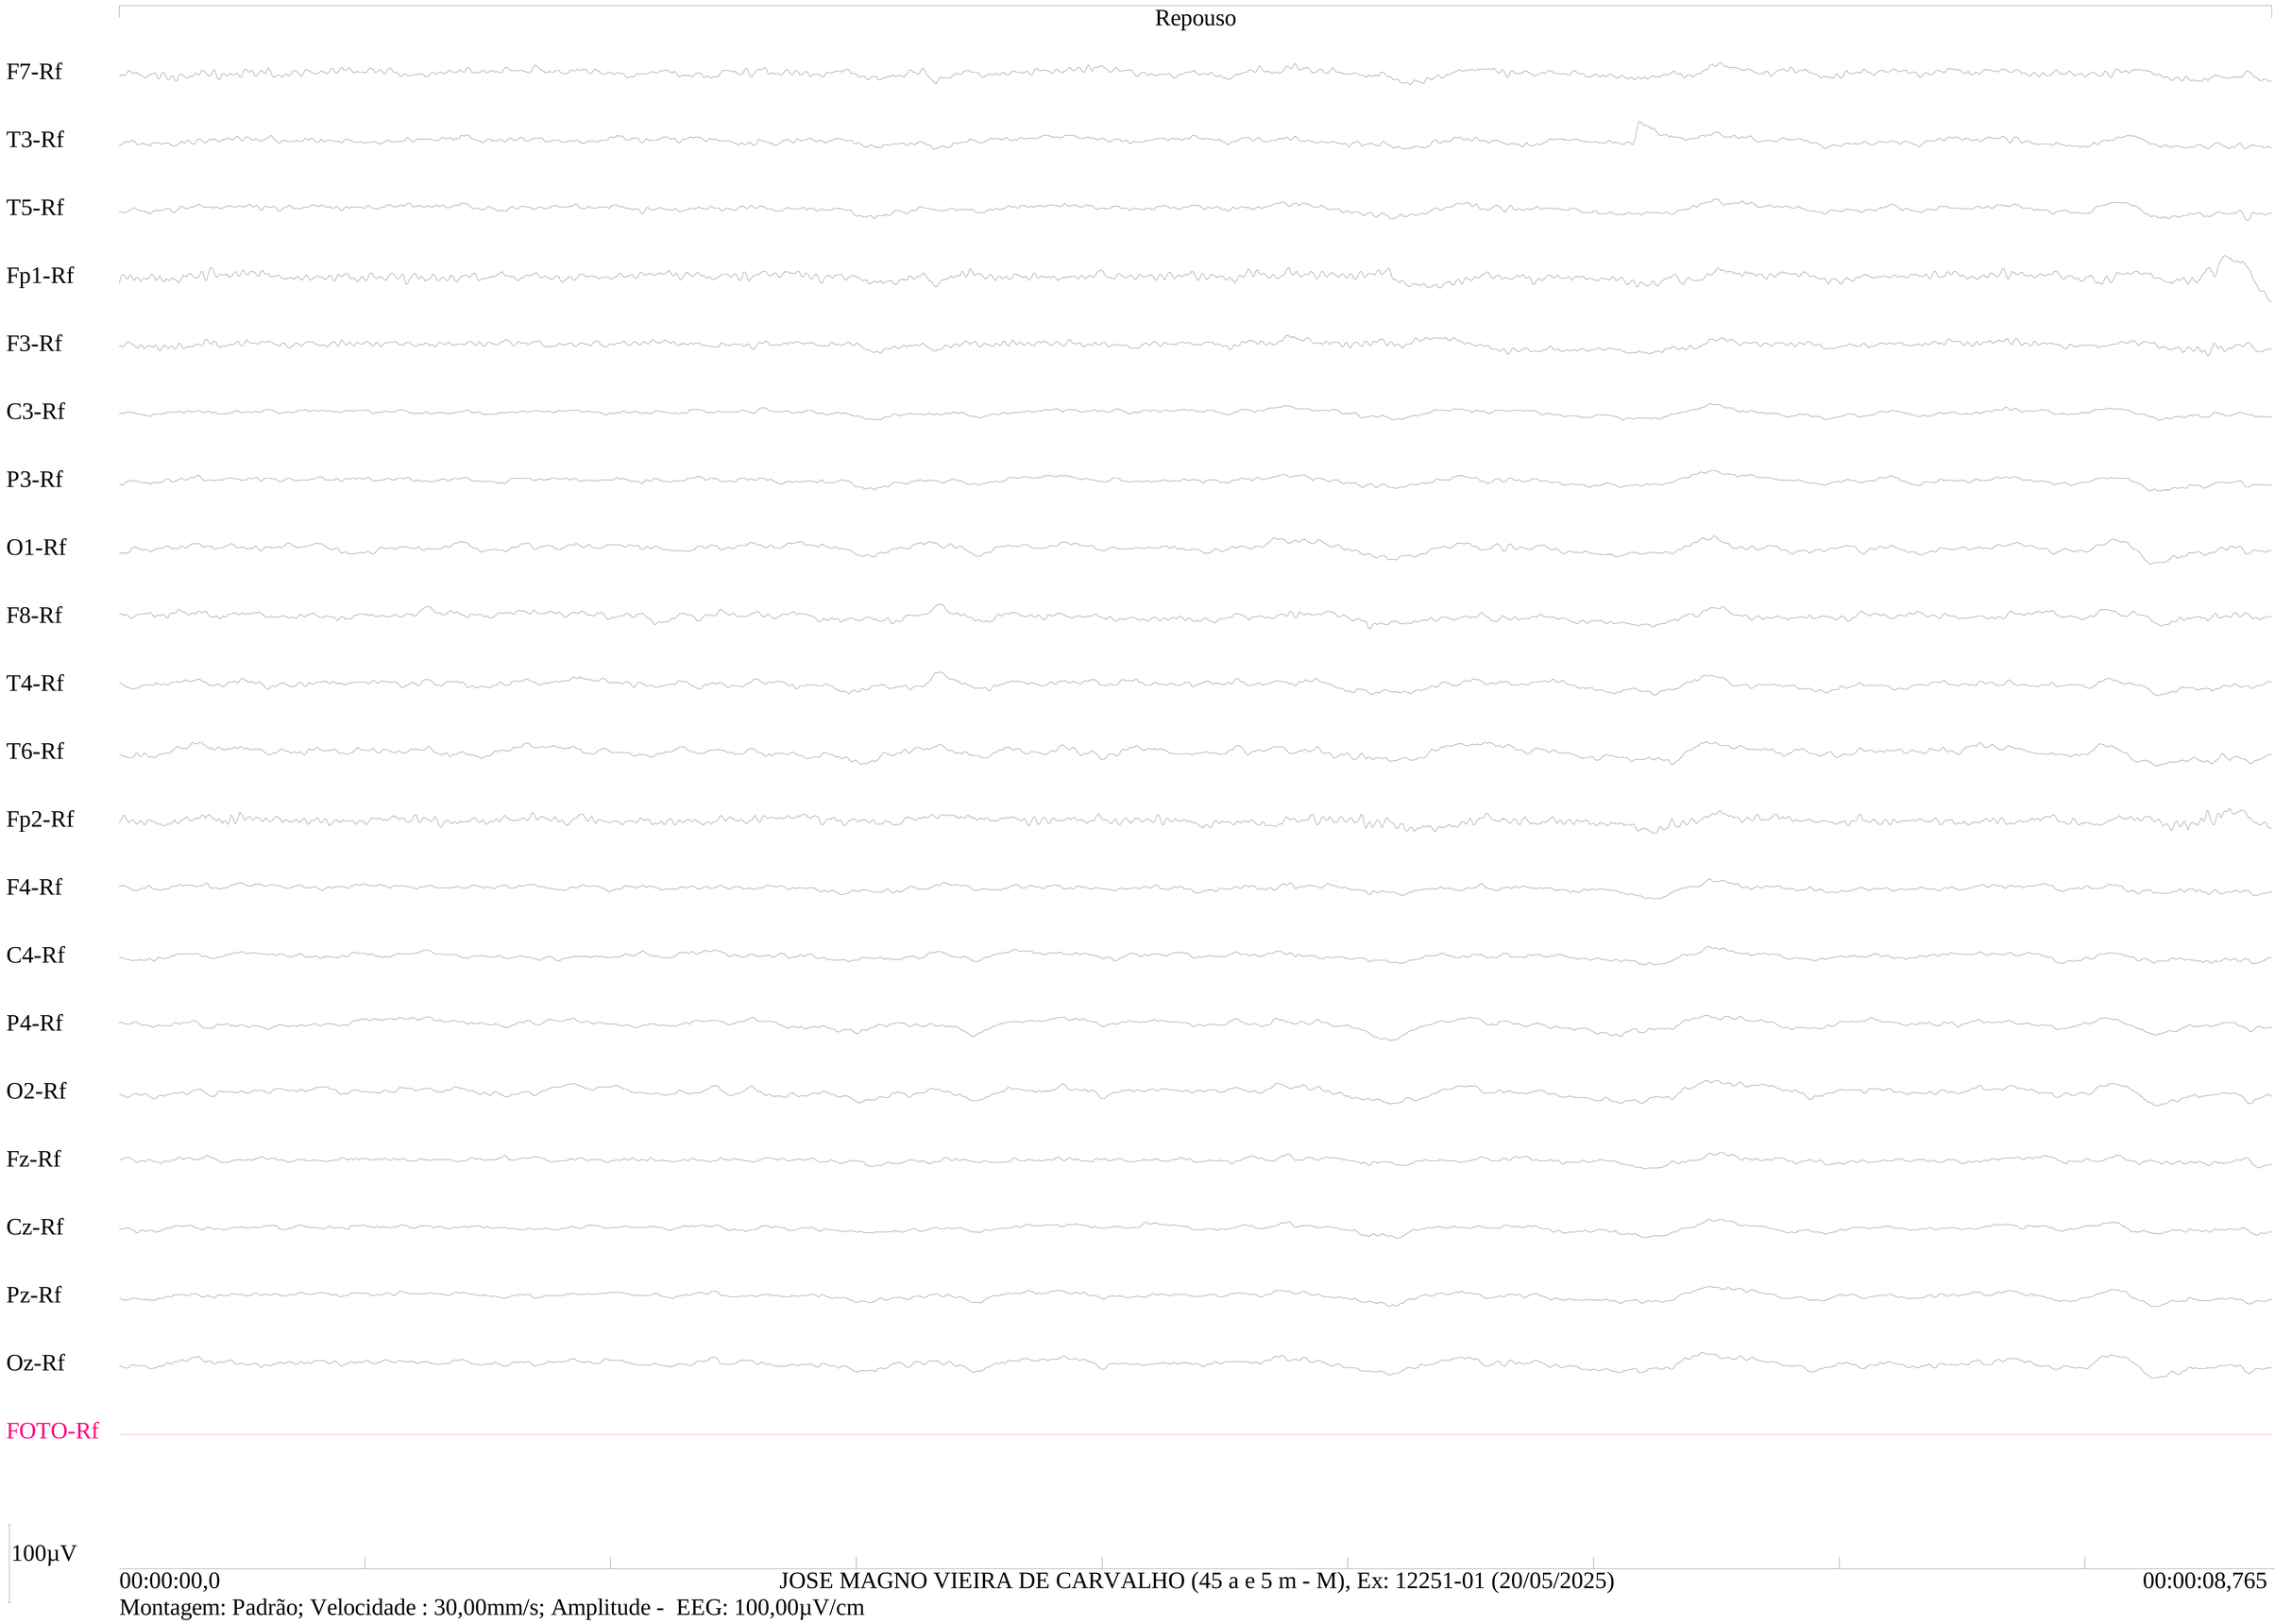

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

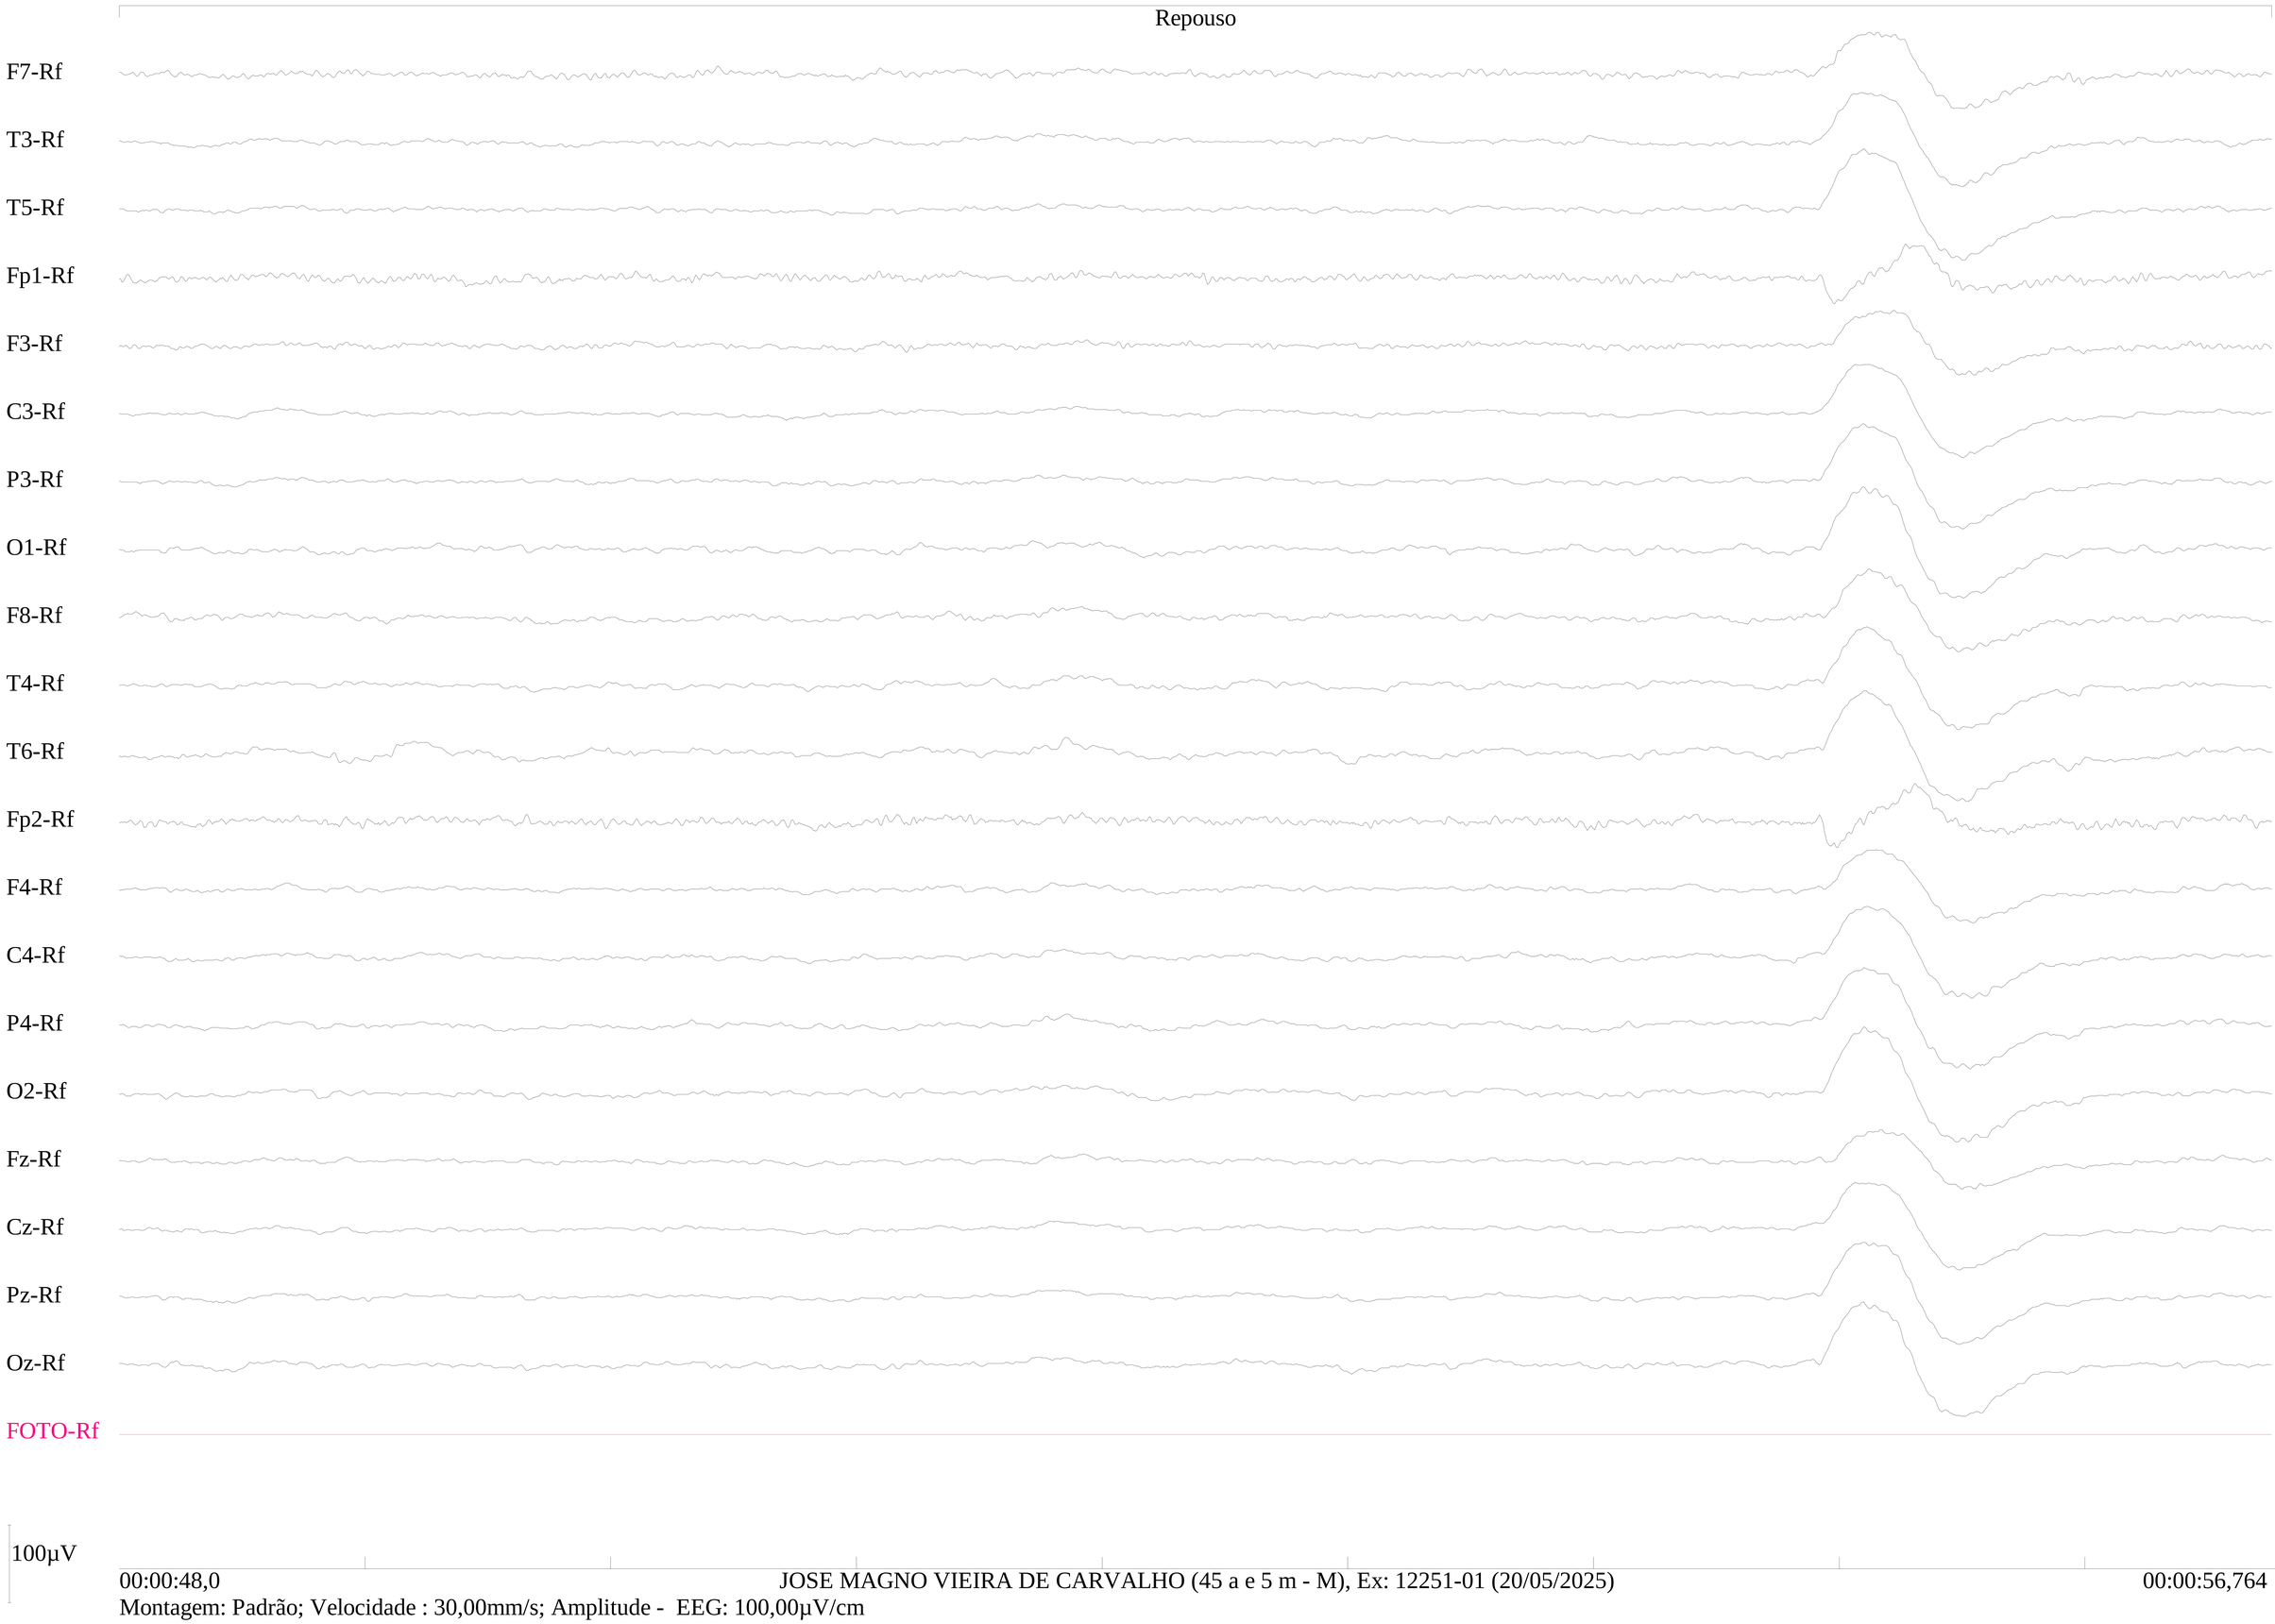

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

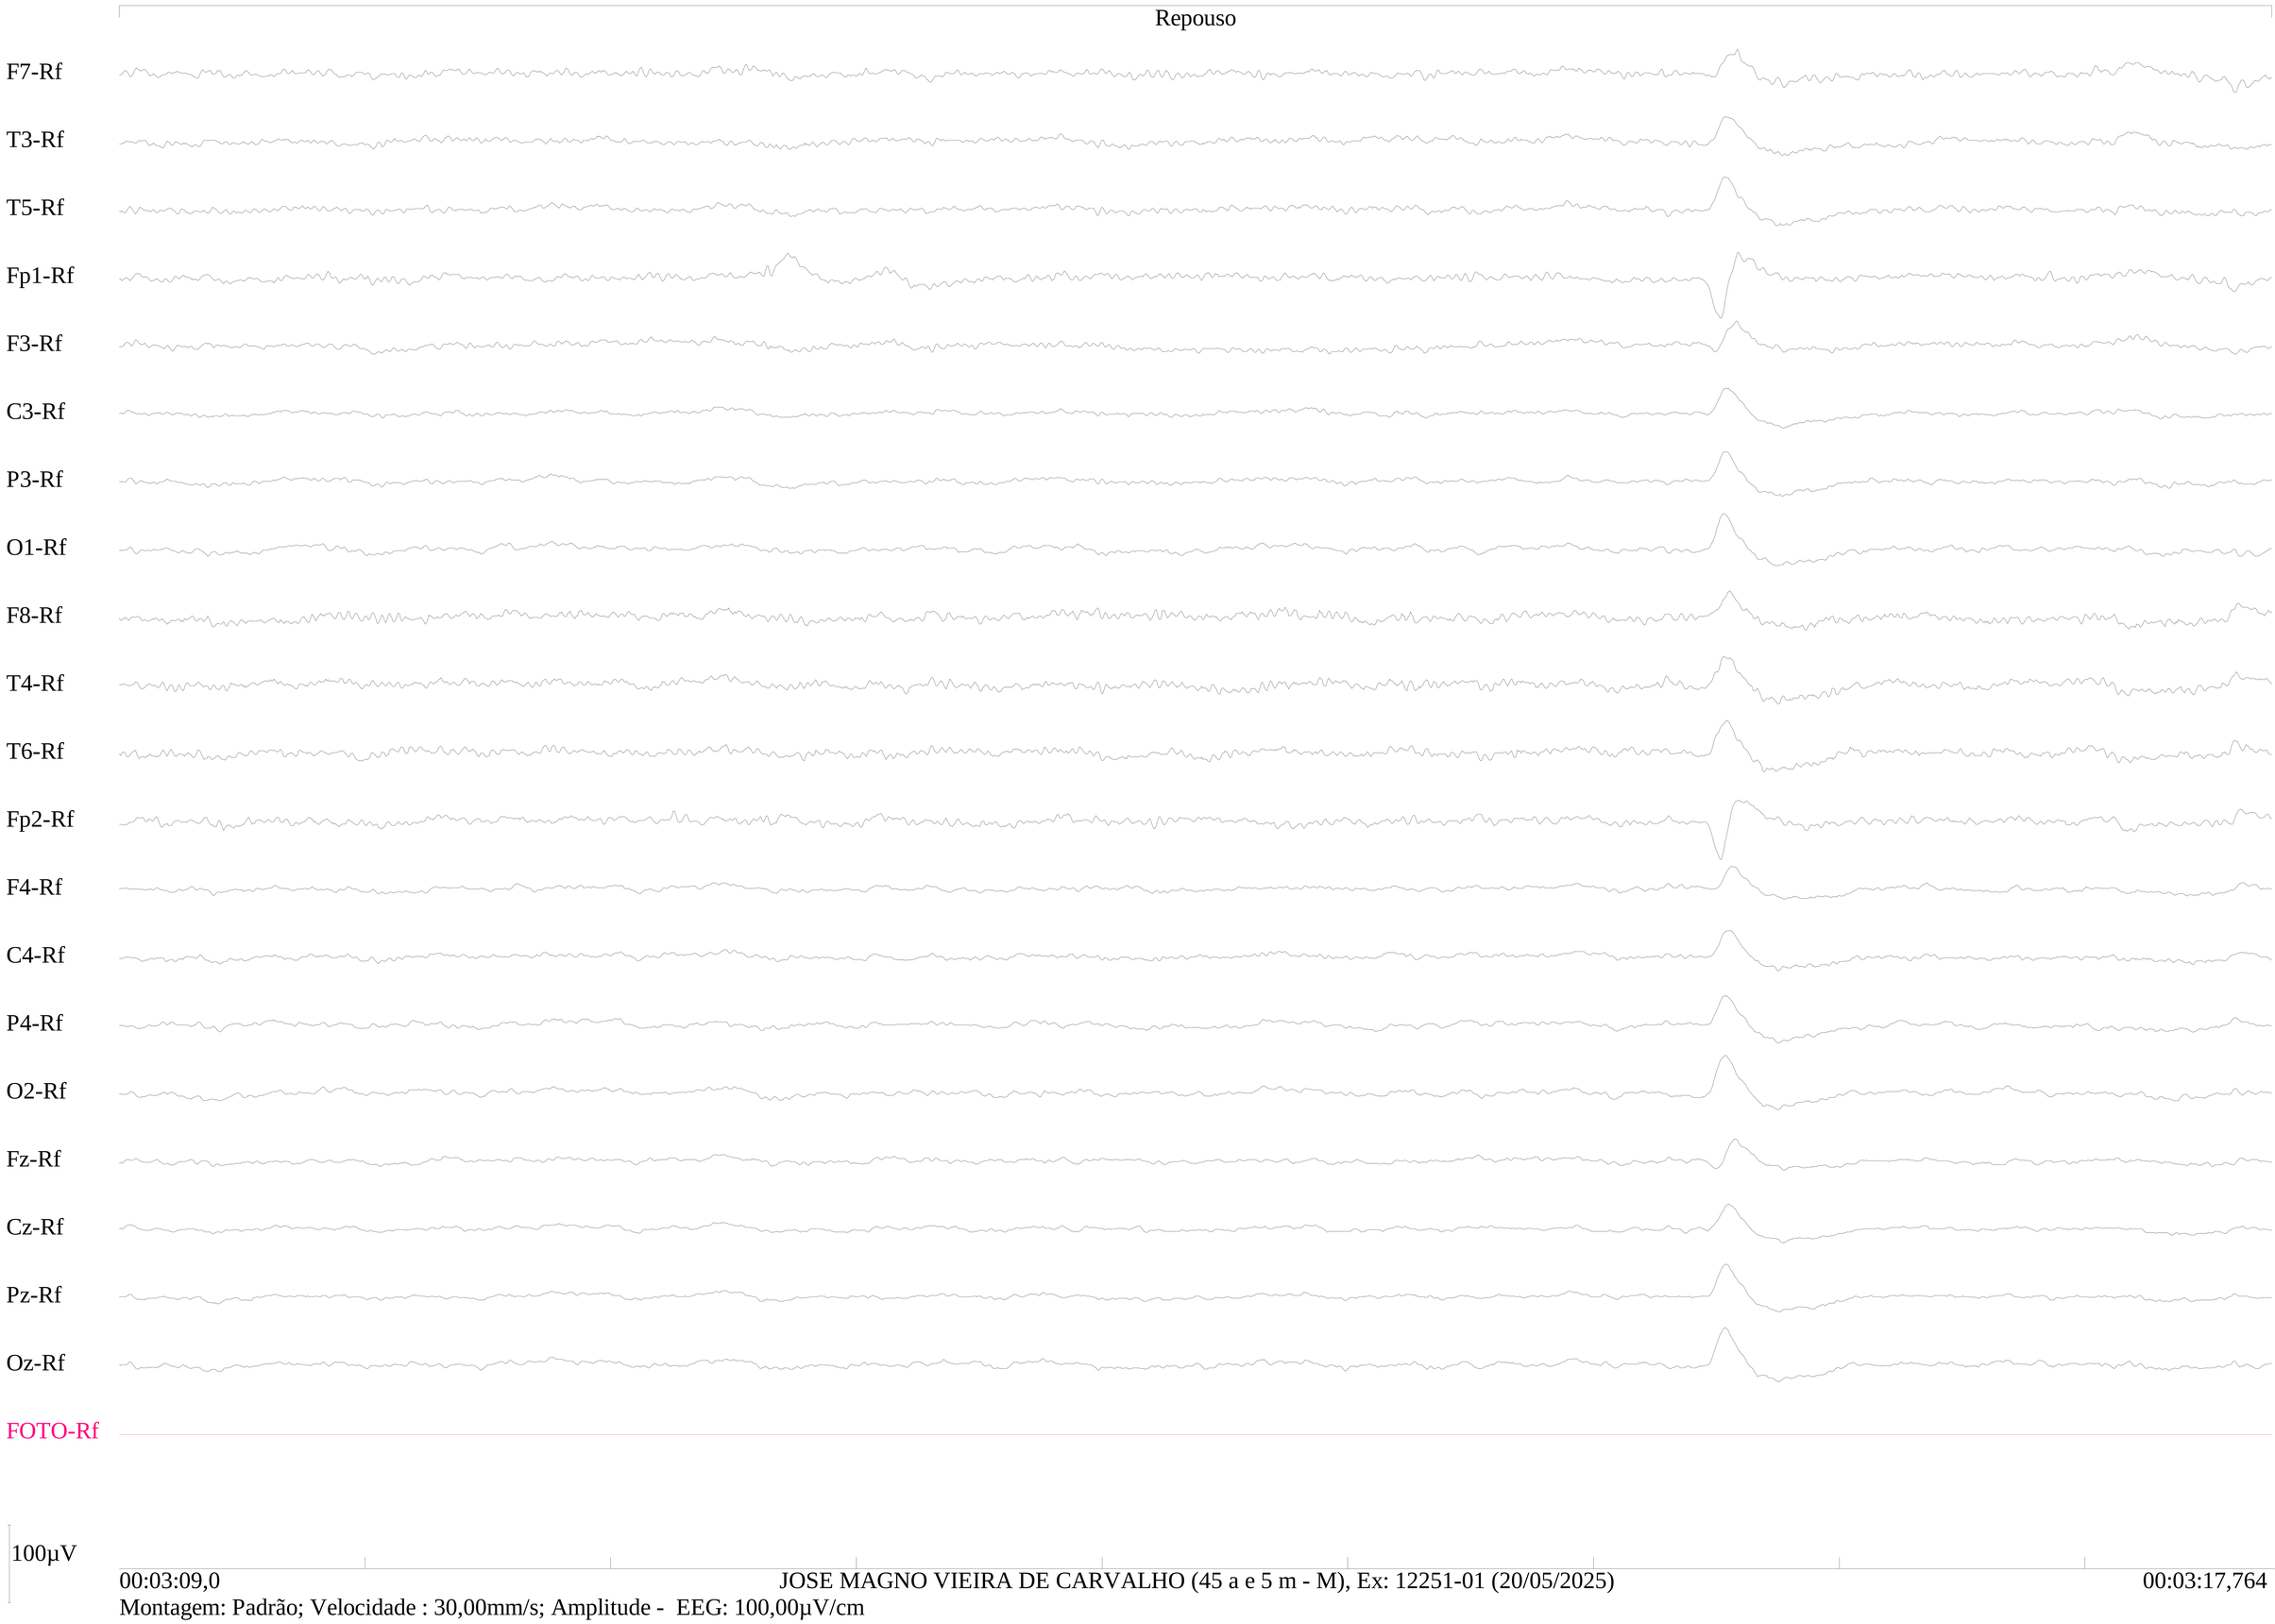

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

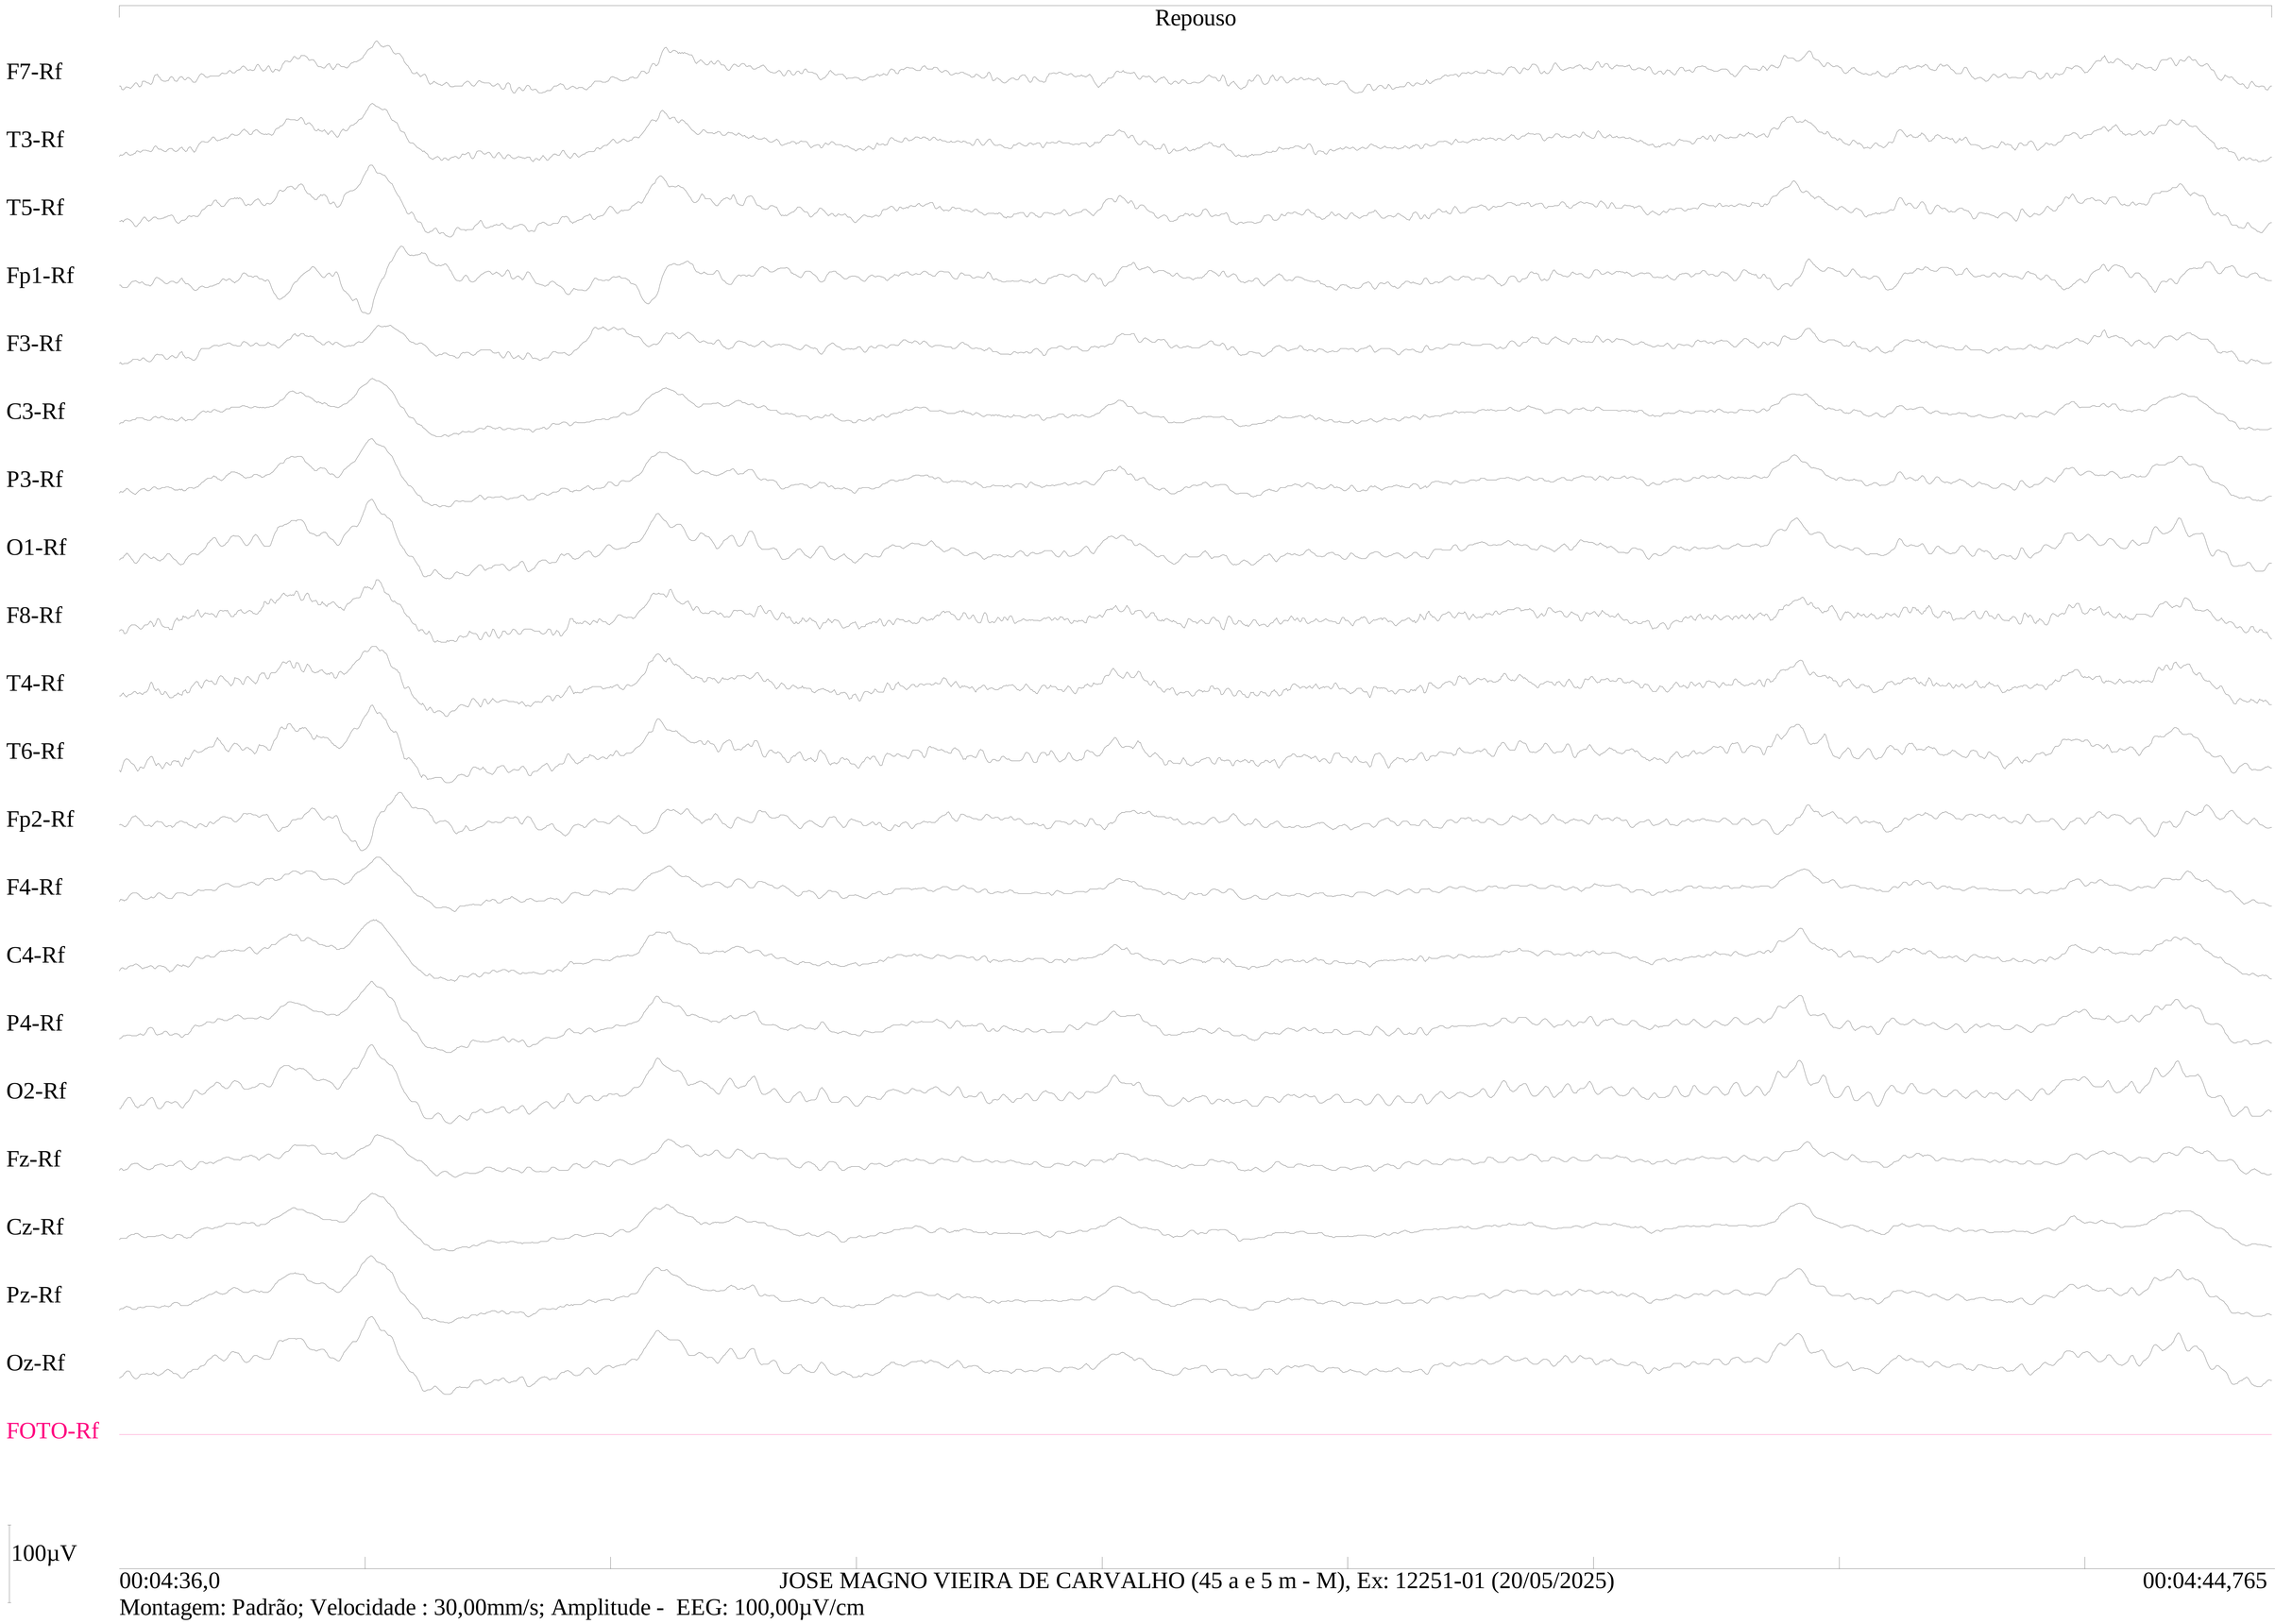

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

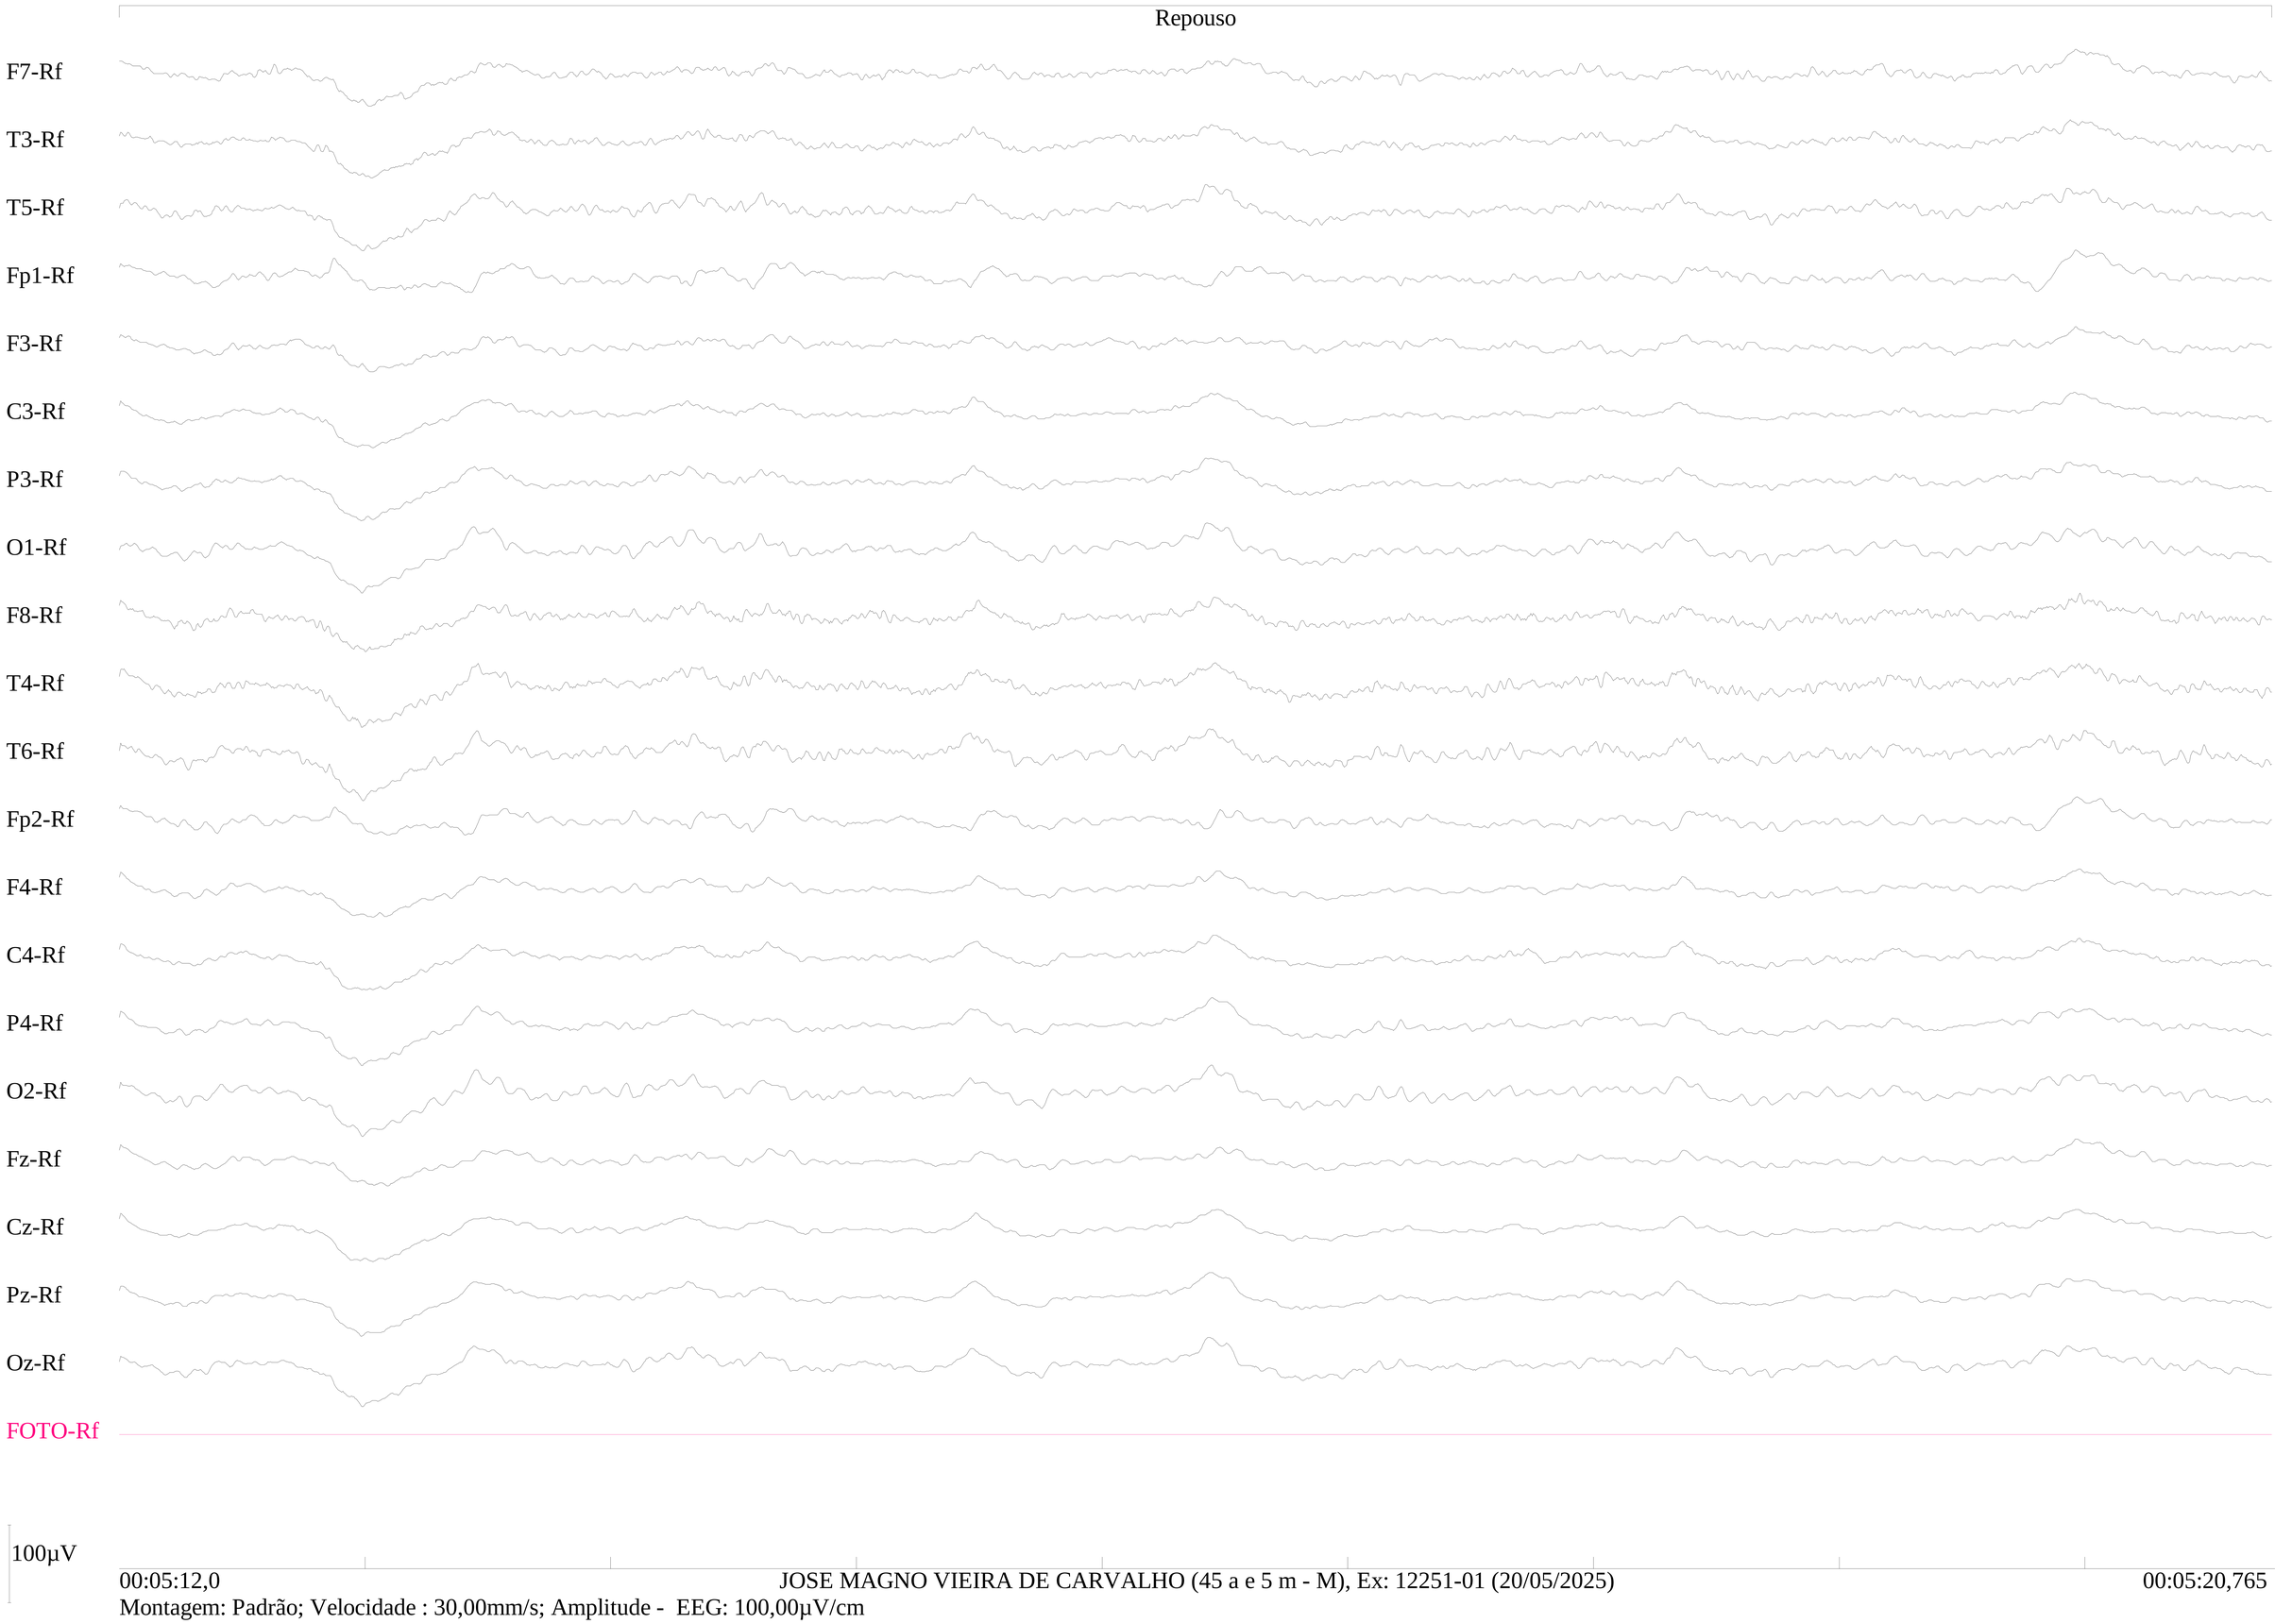

JOSE MAGNO VIEIRA DE CARVALHO (45 a e 5 m - M), Ex: 12251-01 (20/05/2025)

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

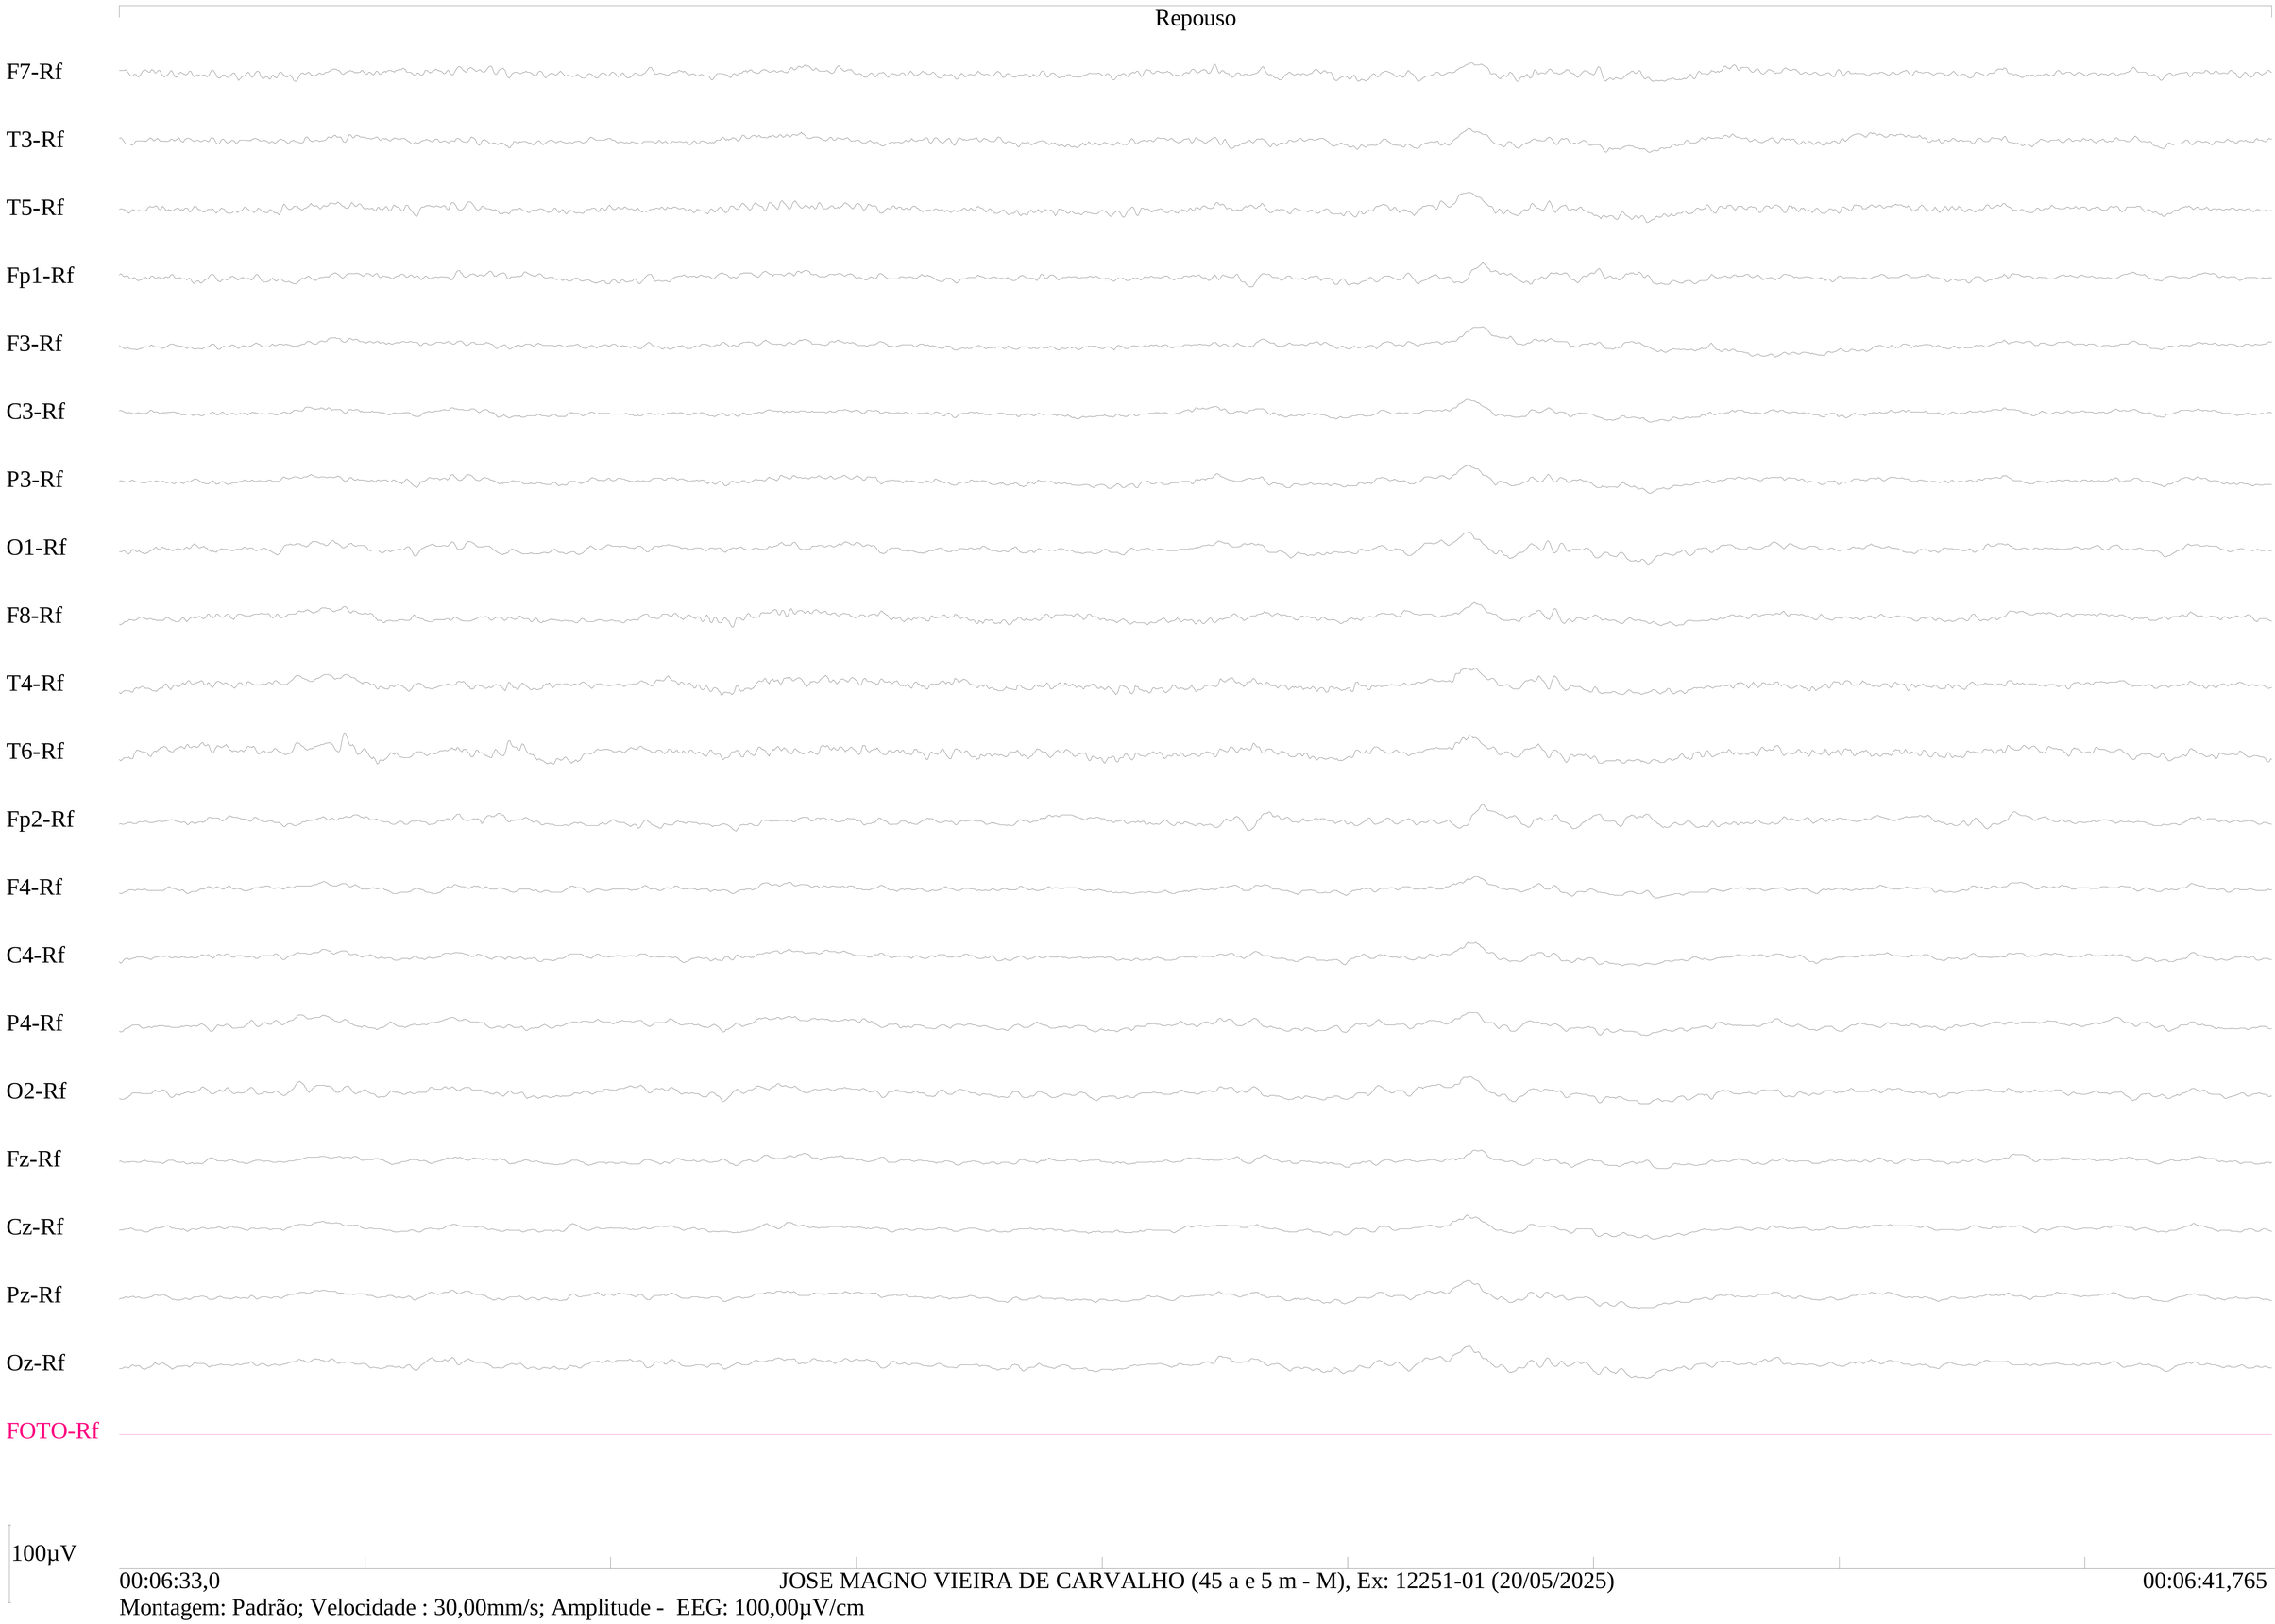

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

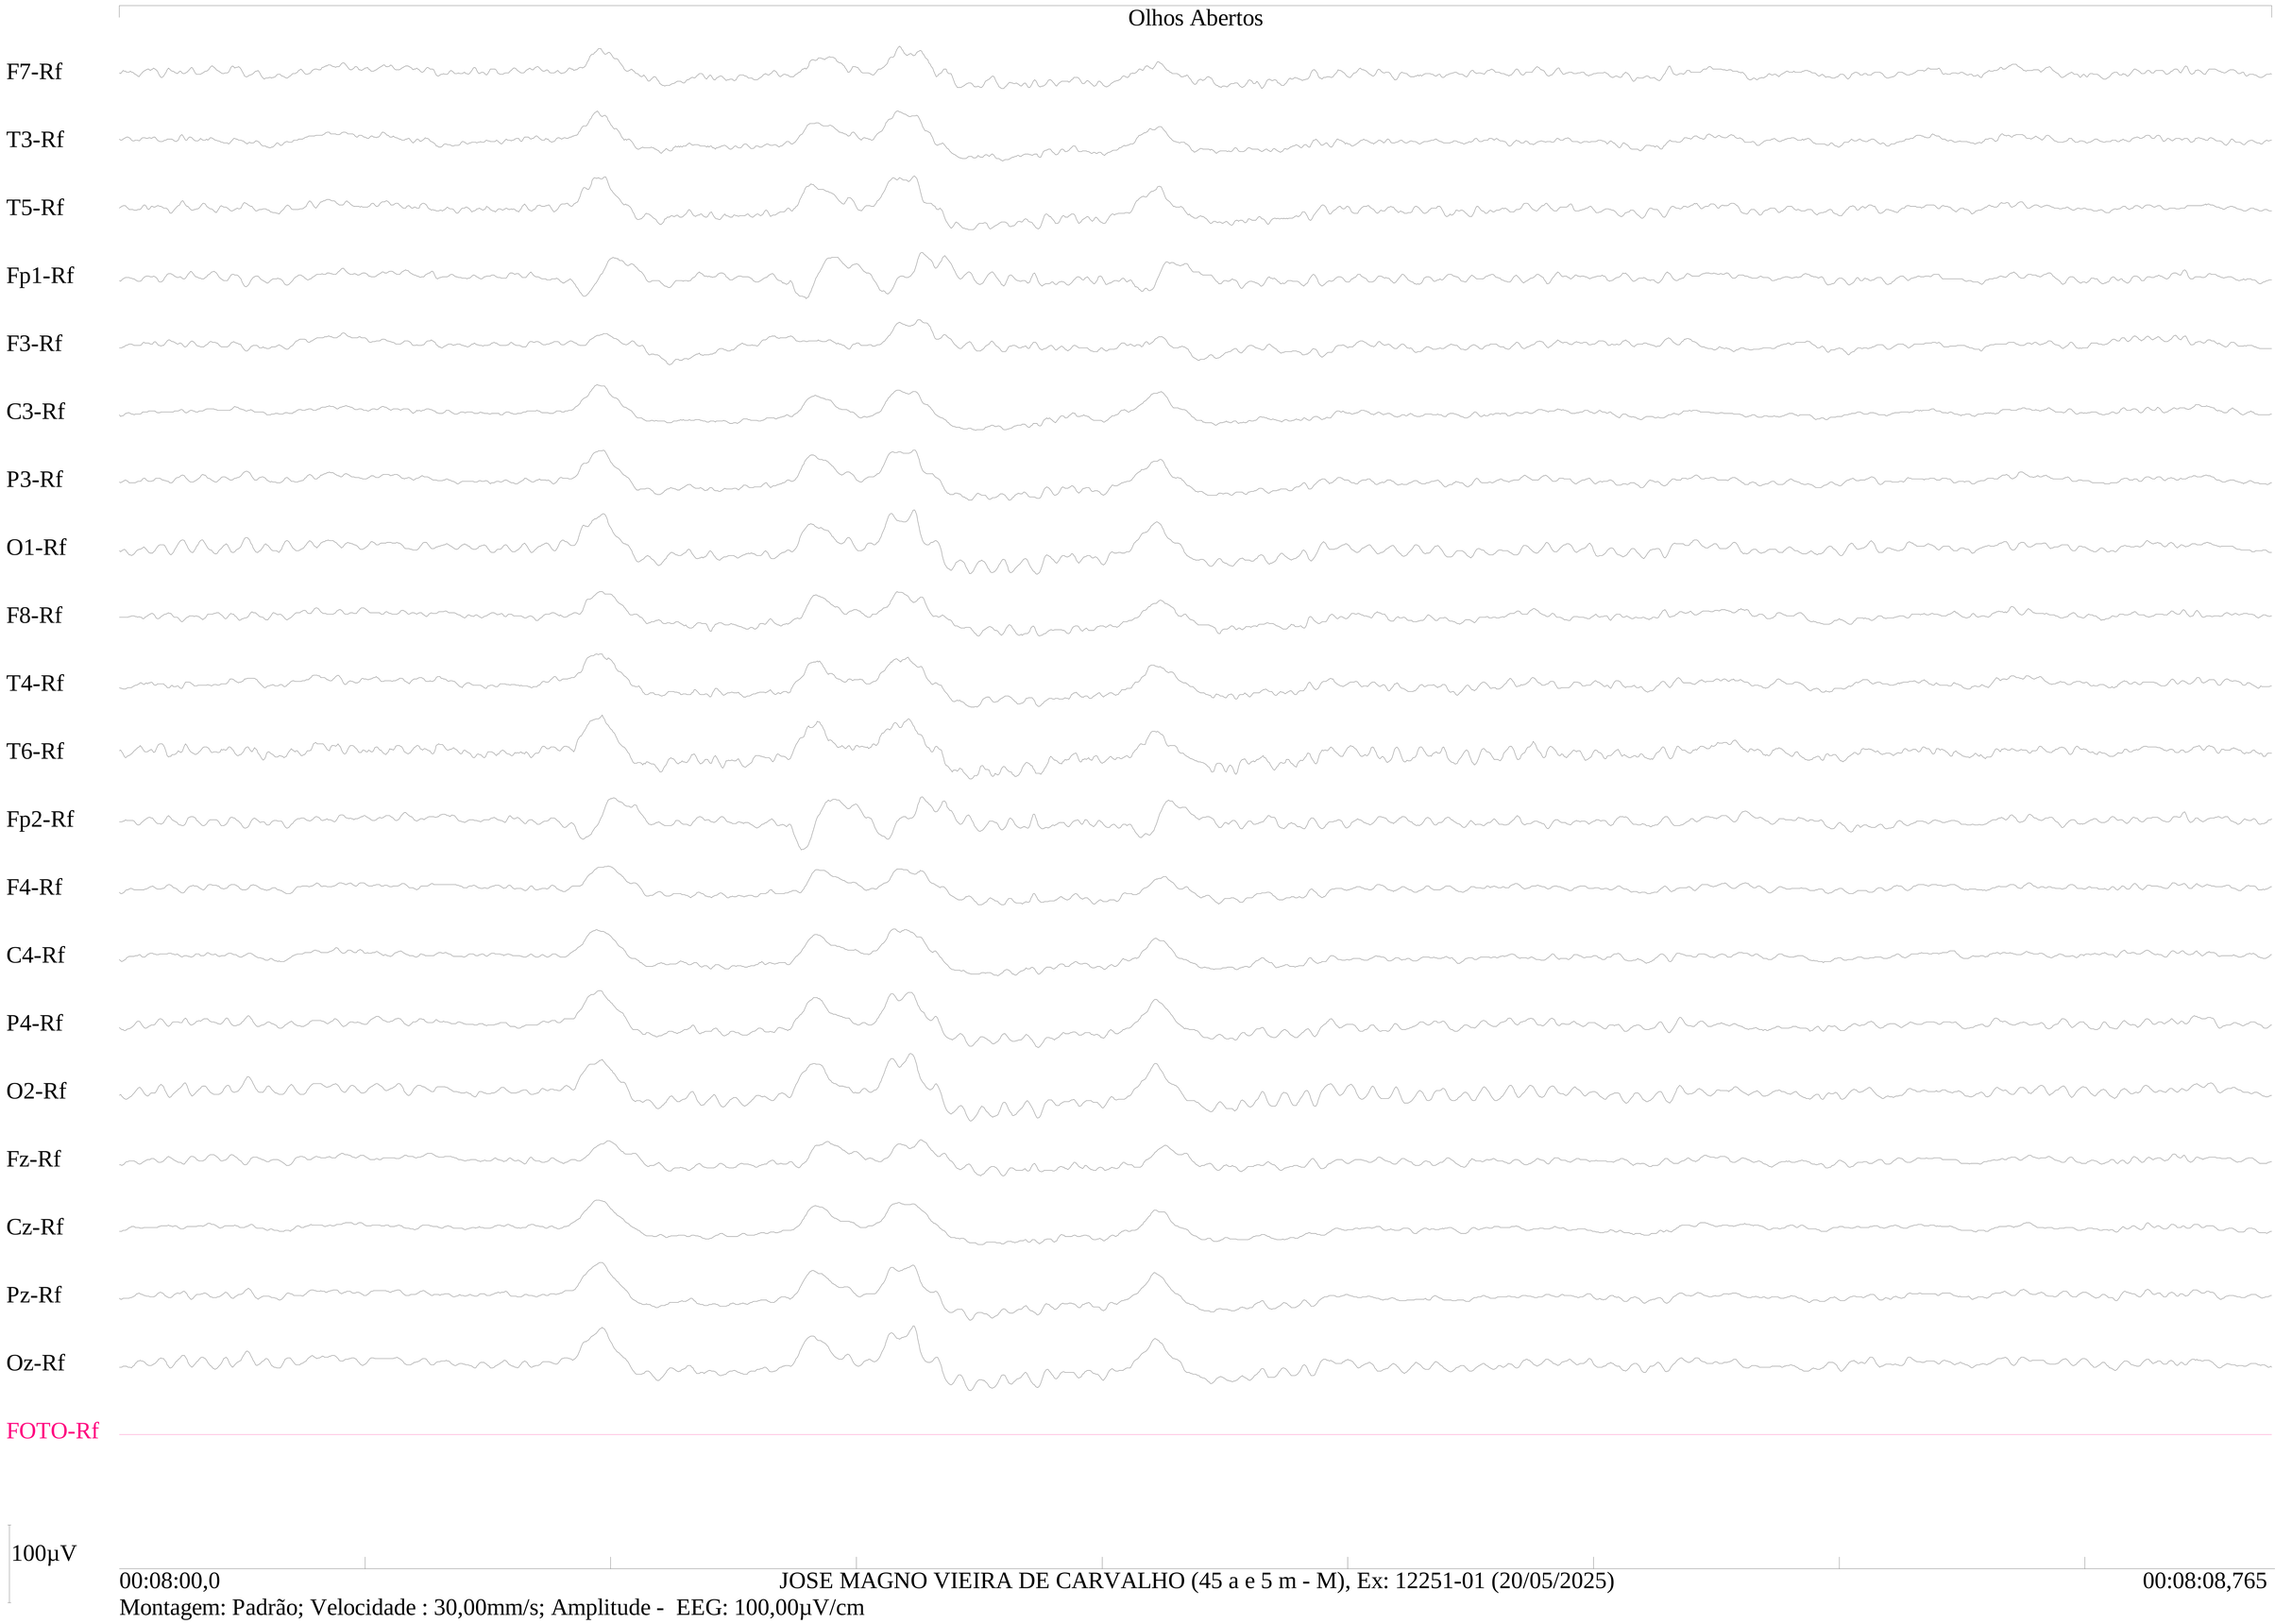

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

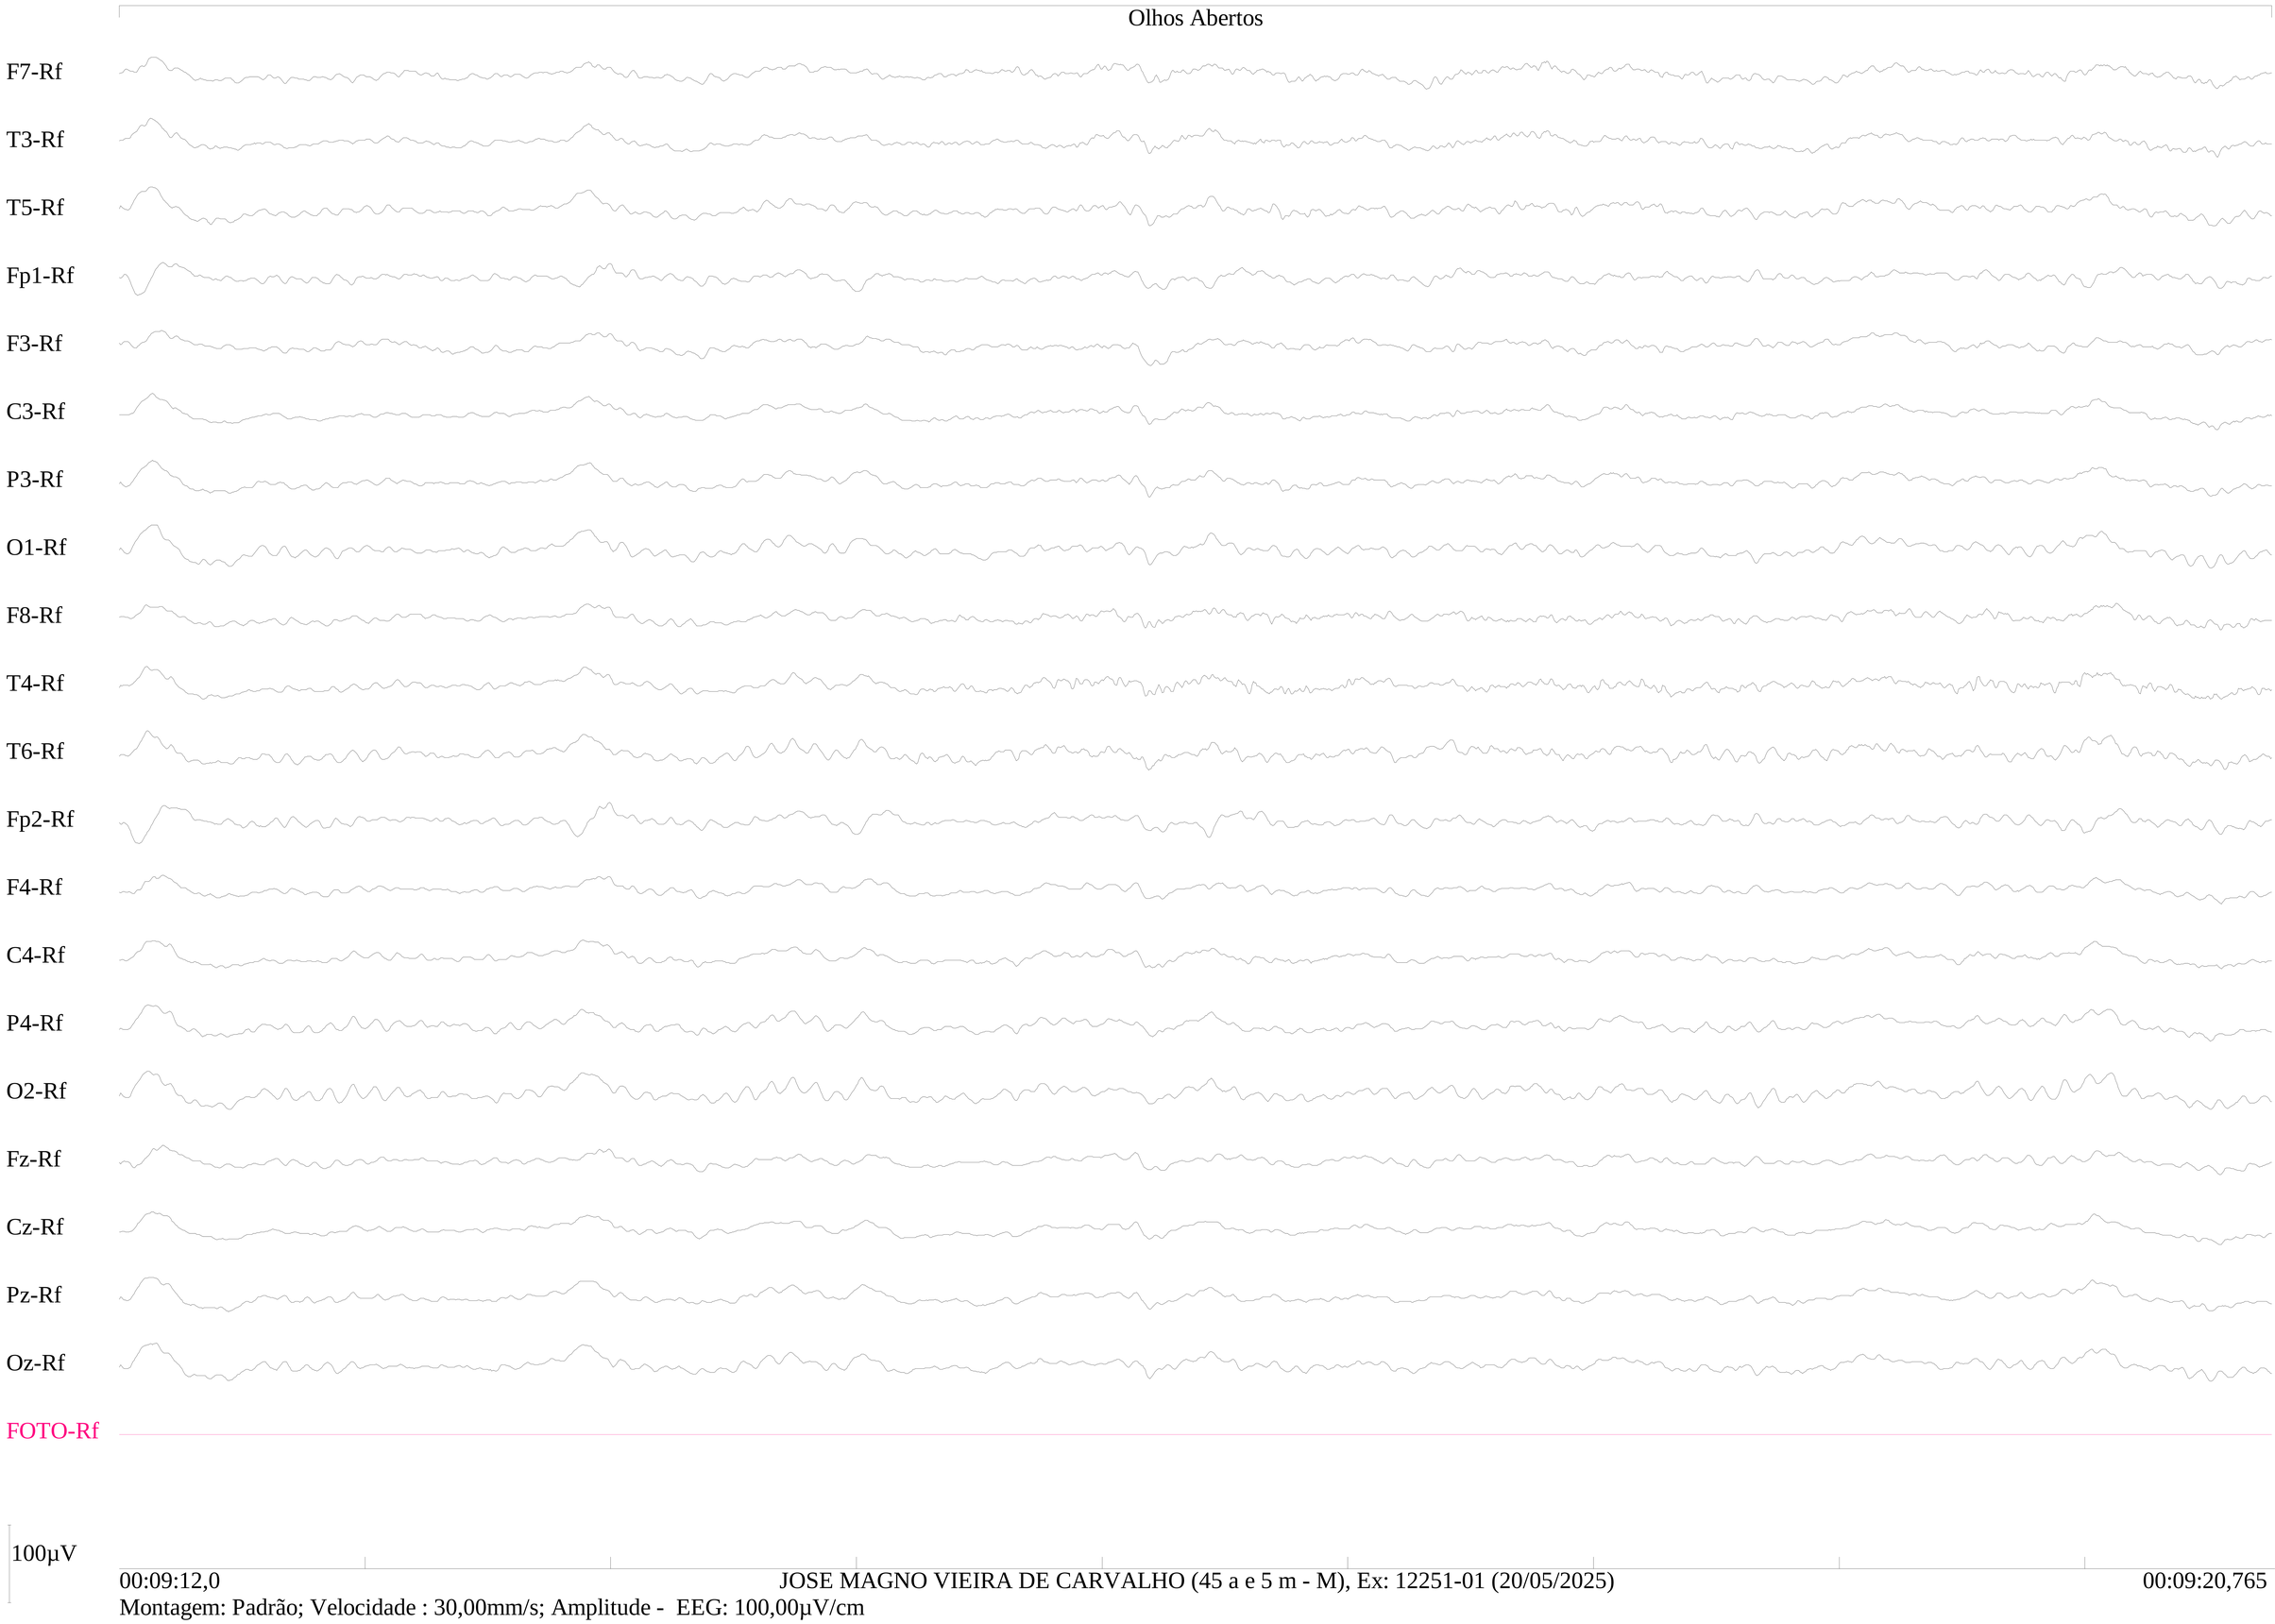

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

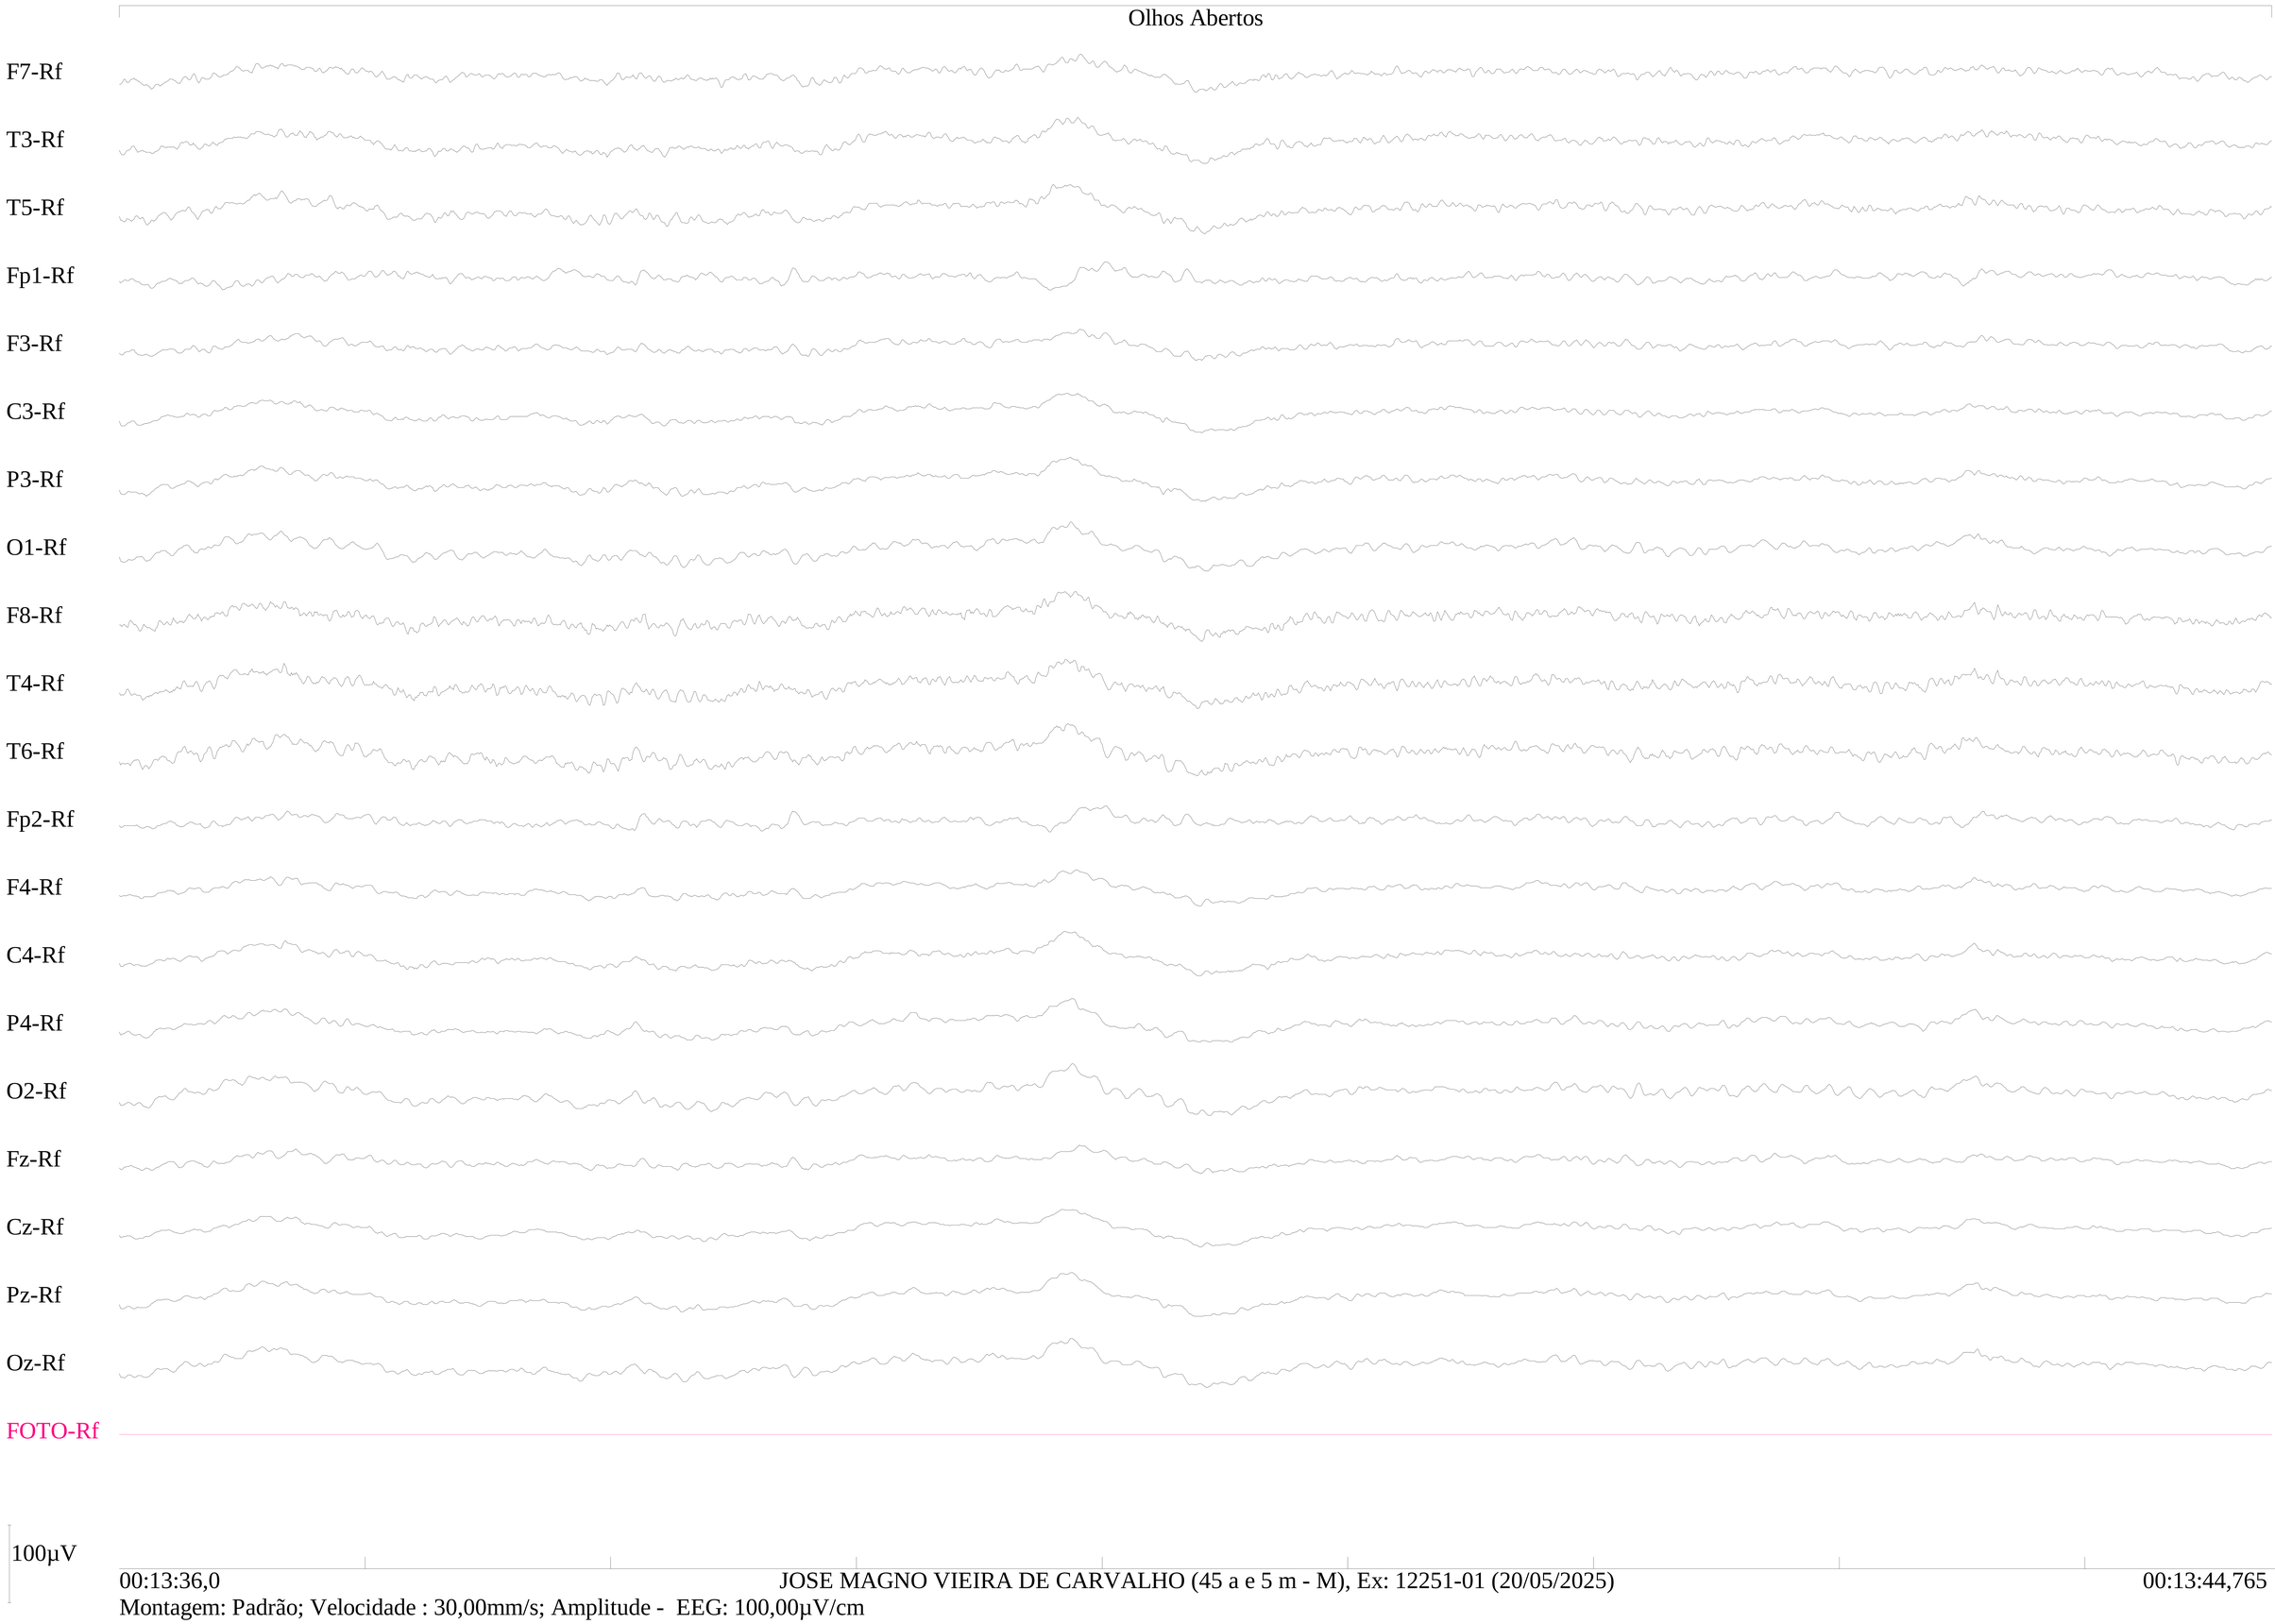

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

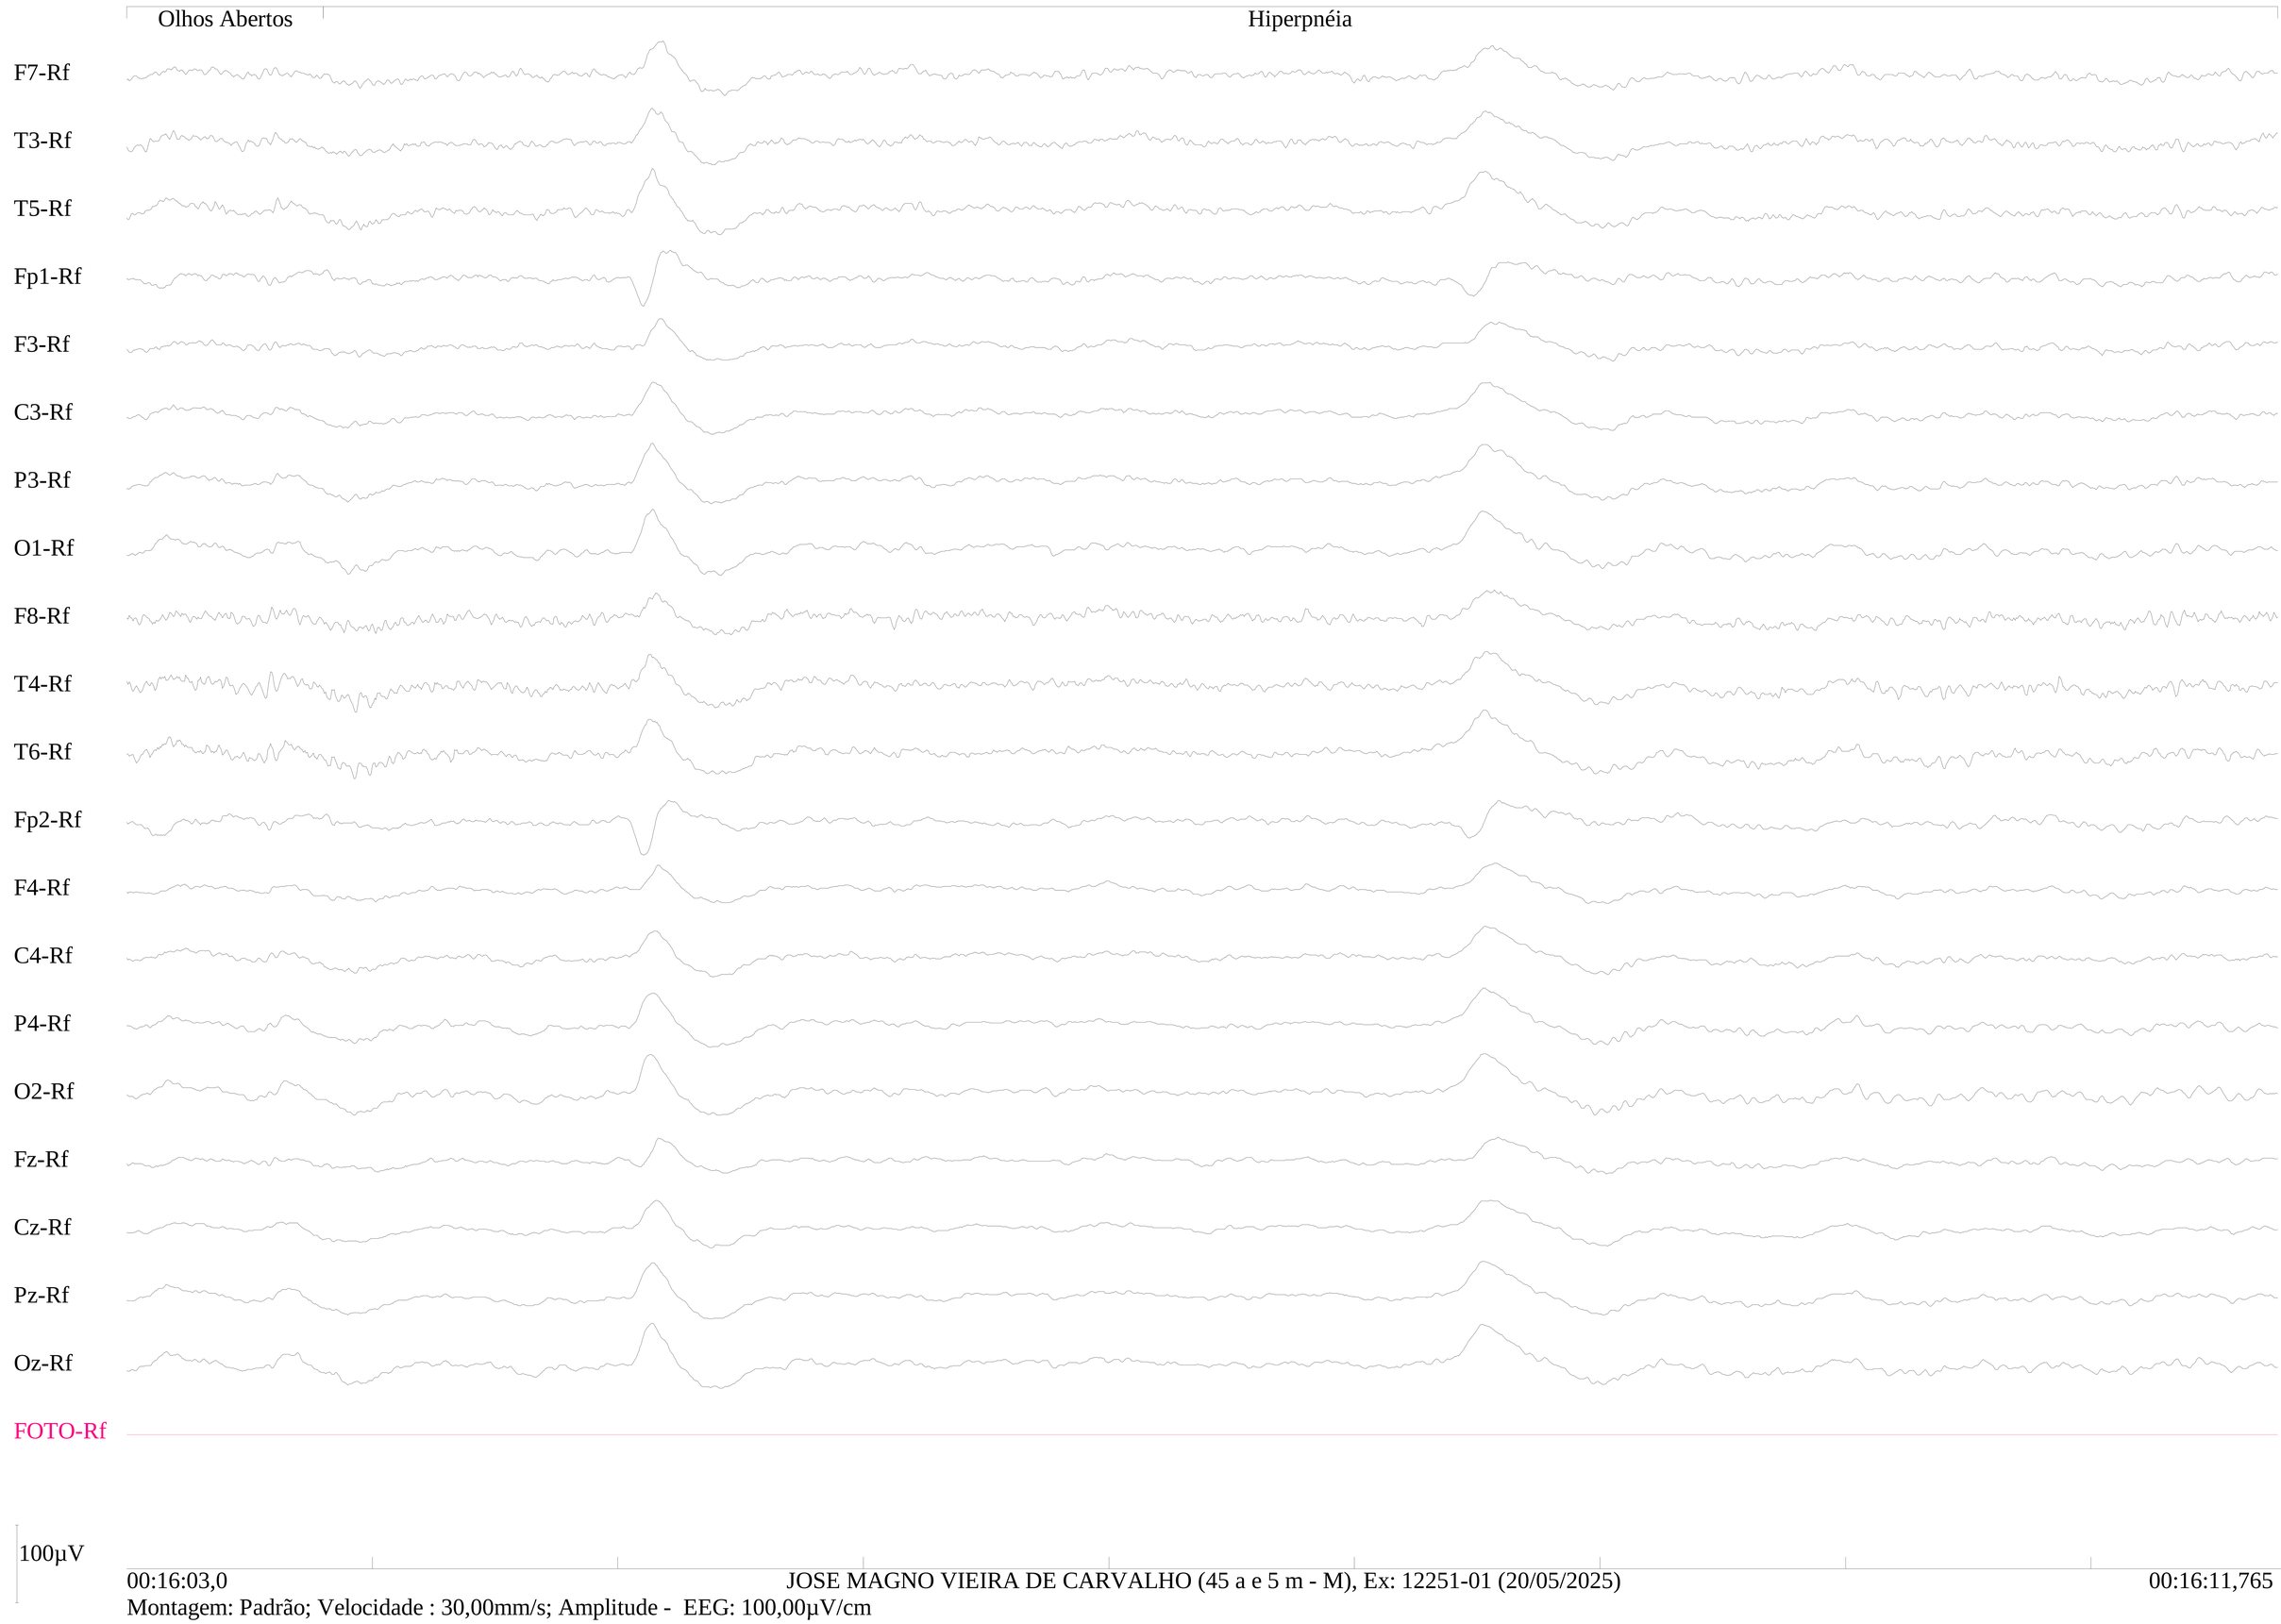

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

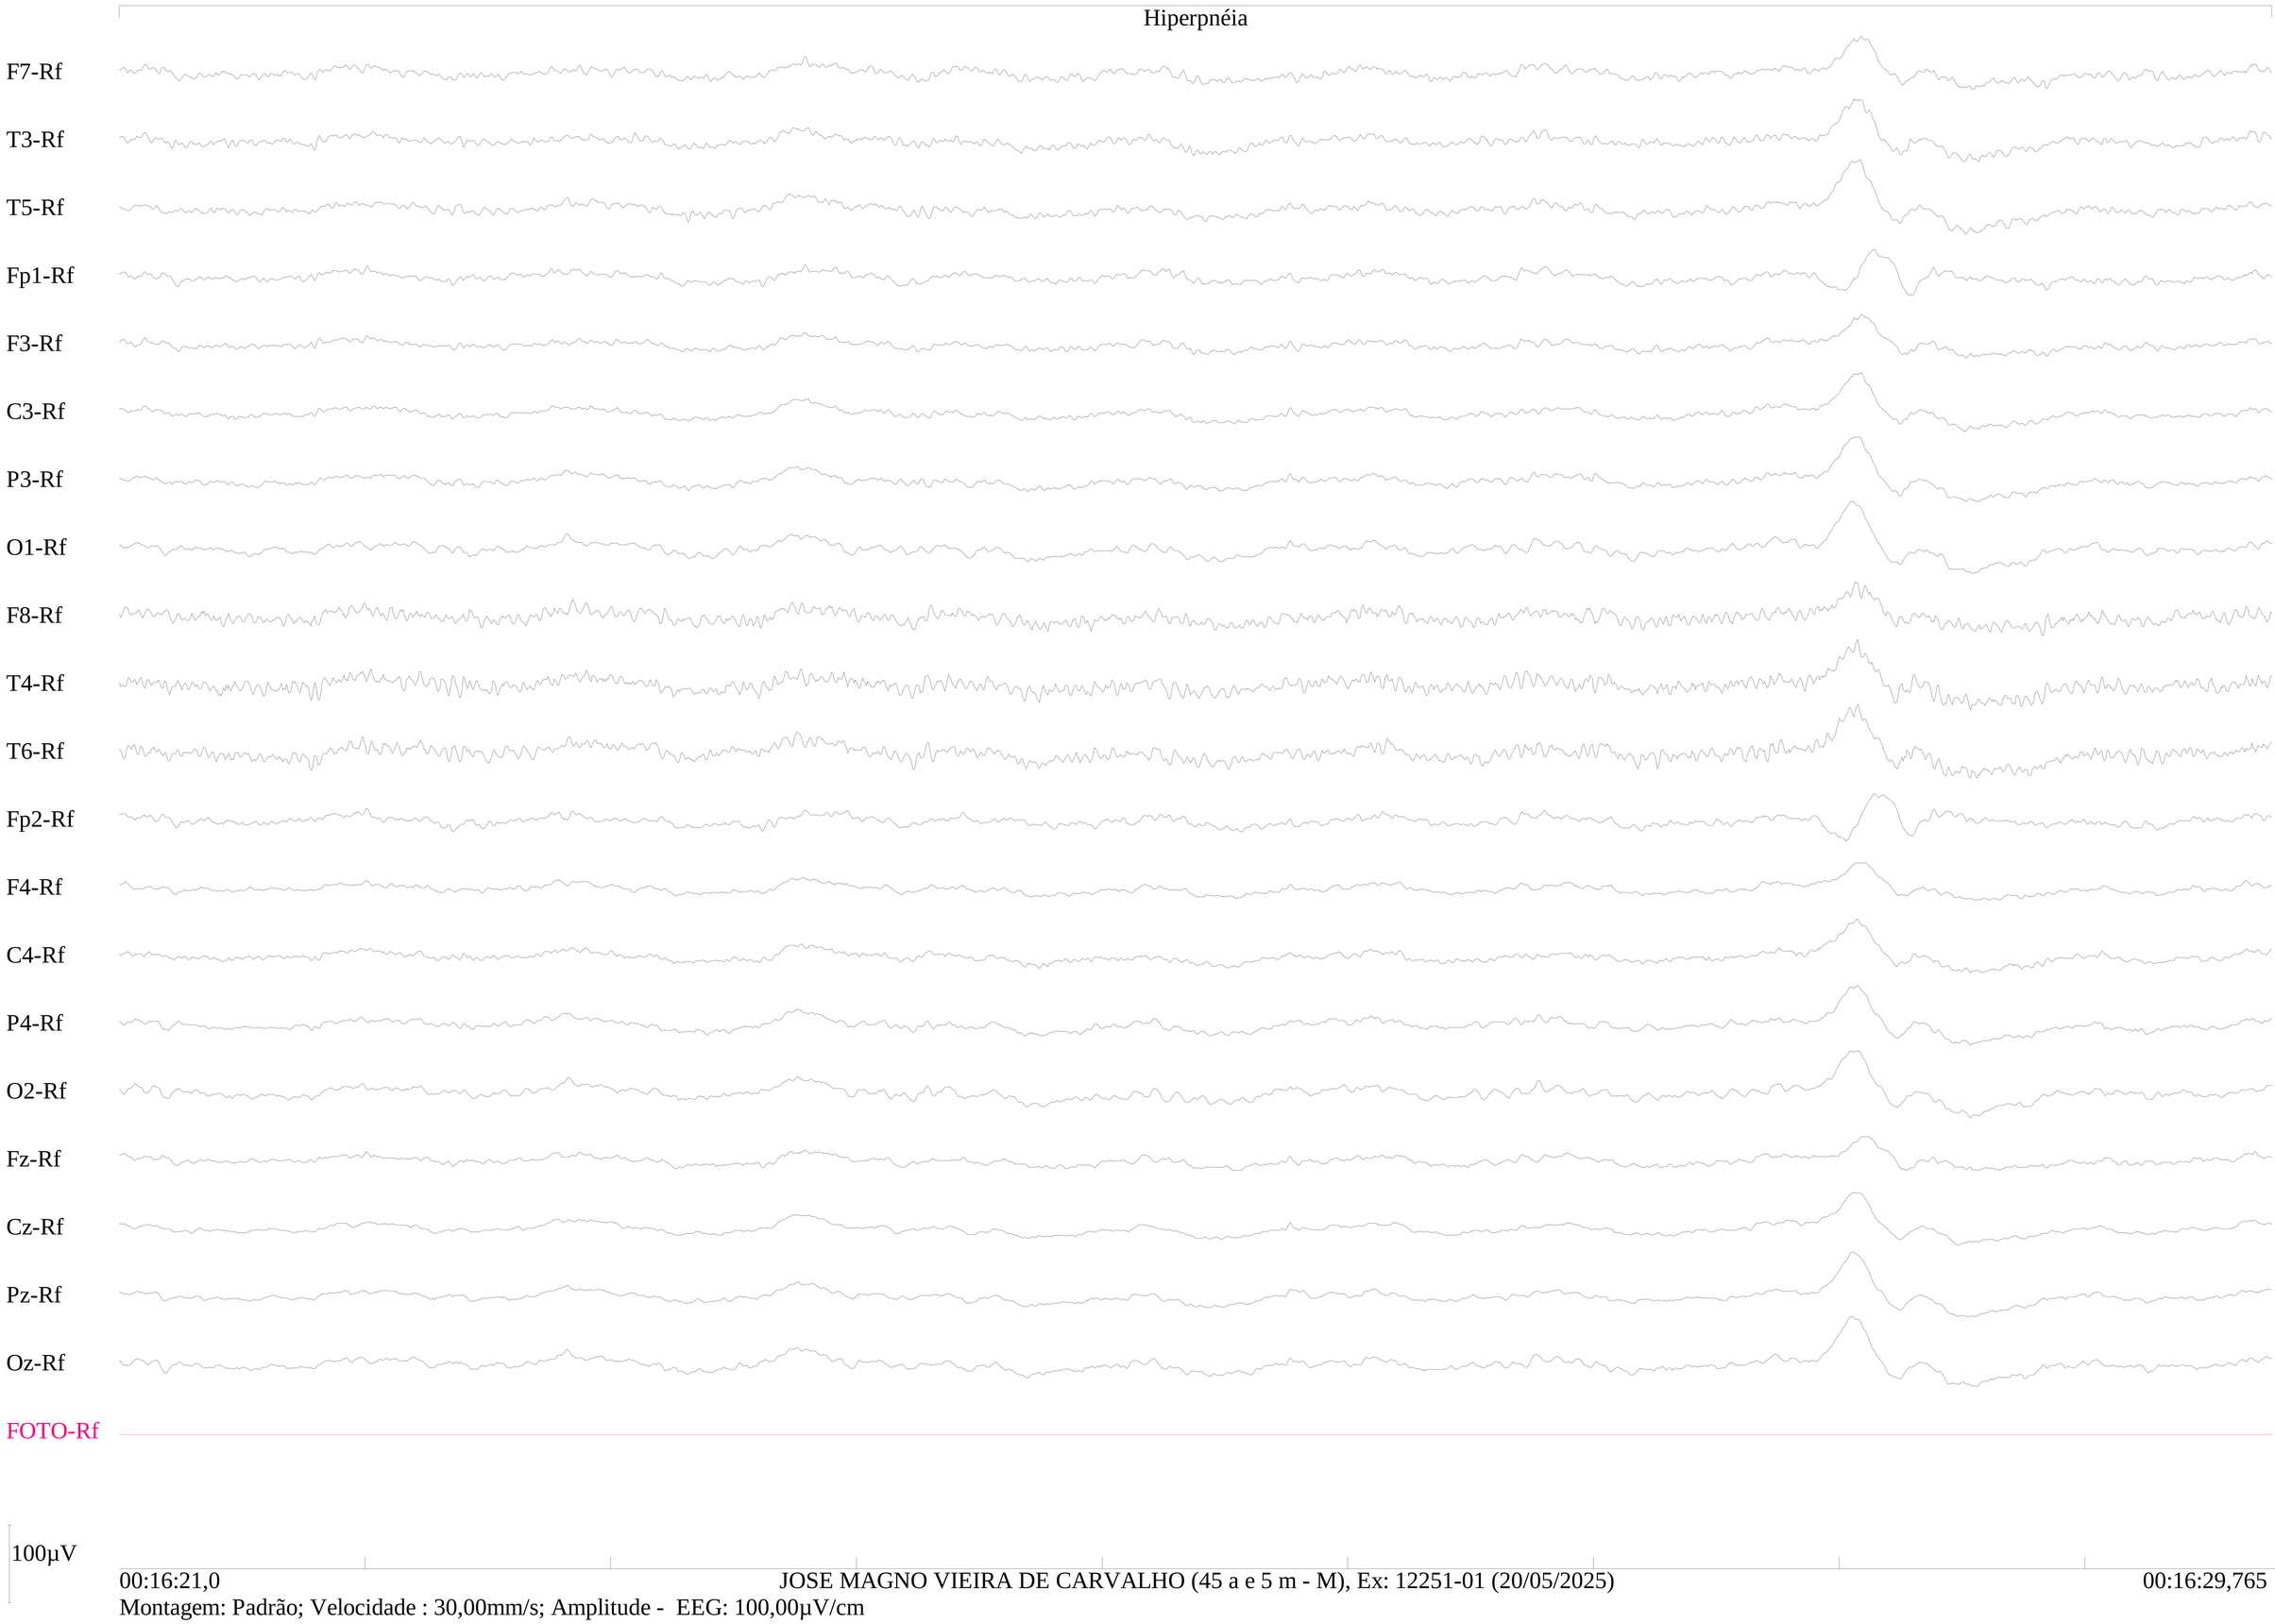

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

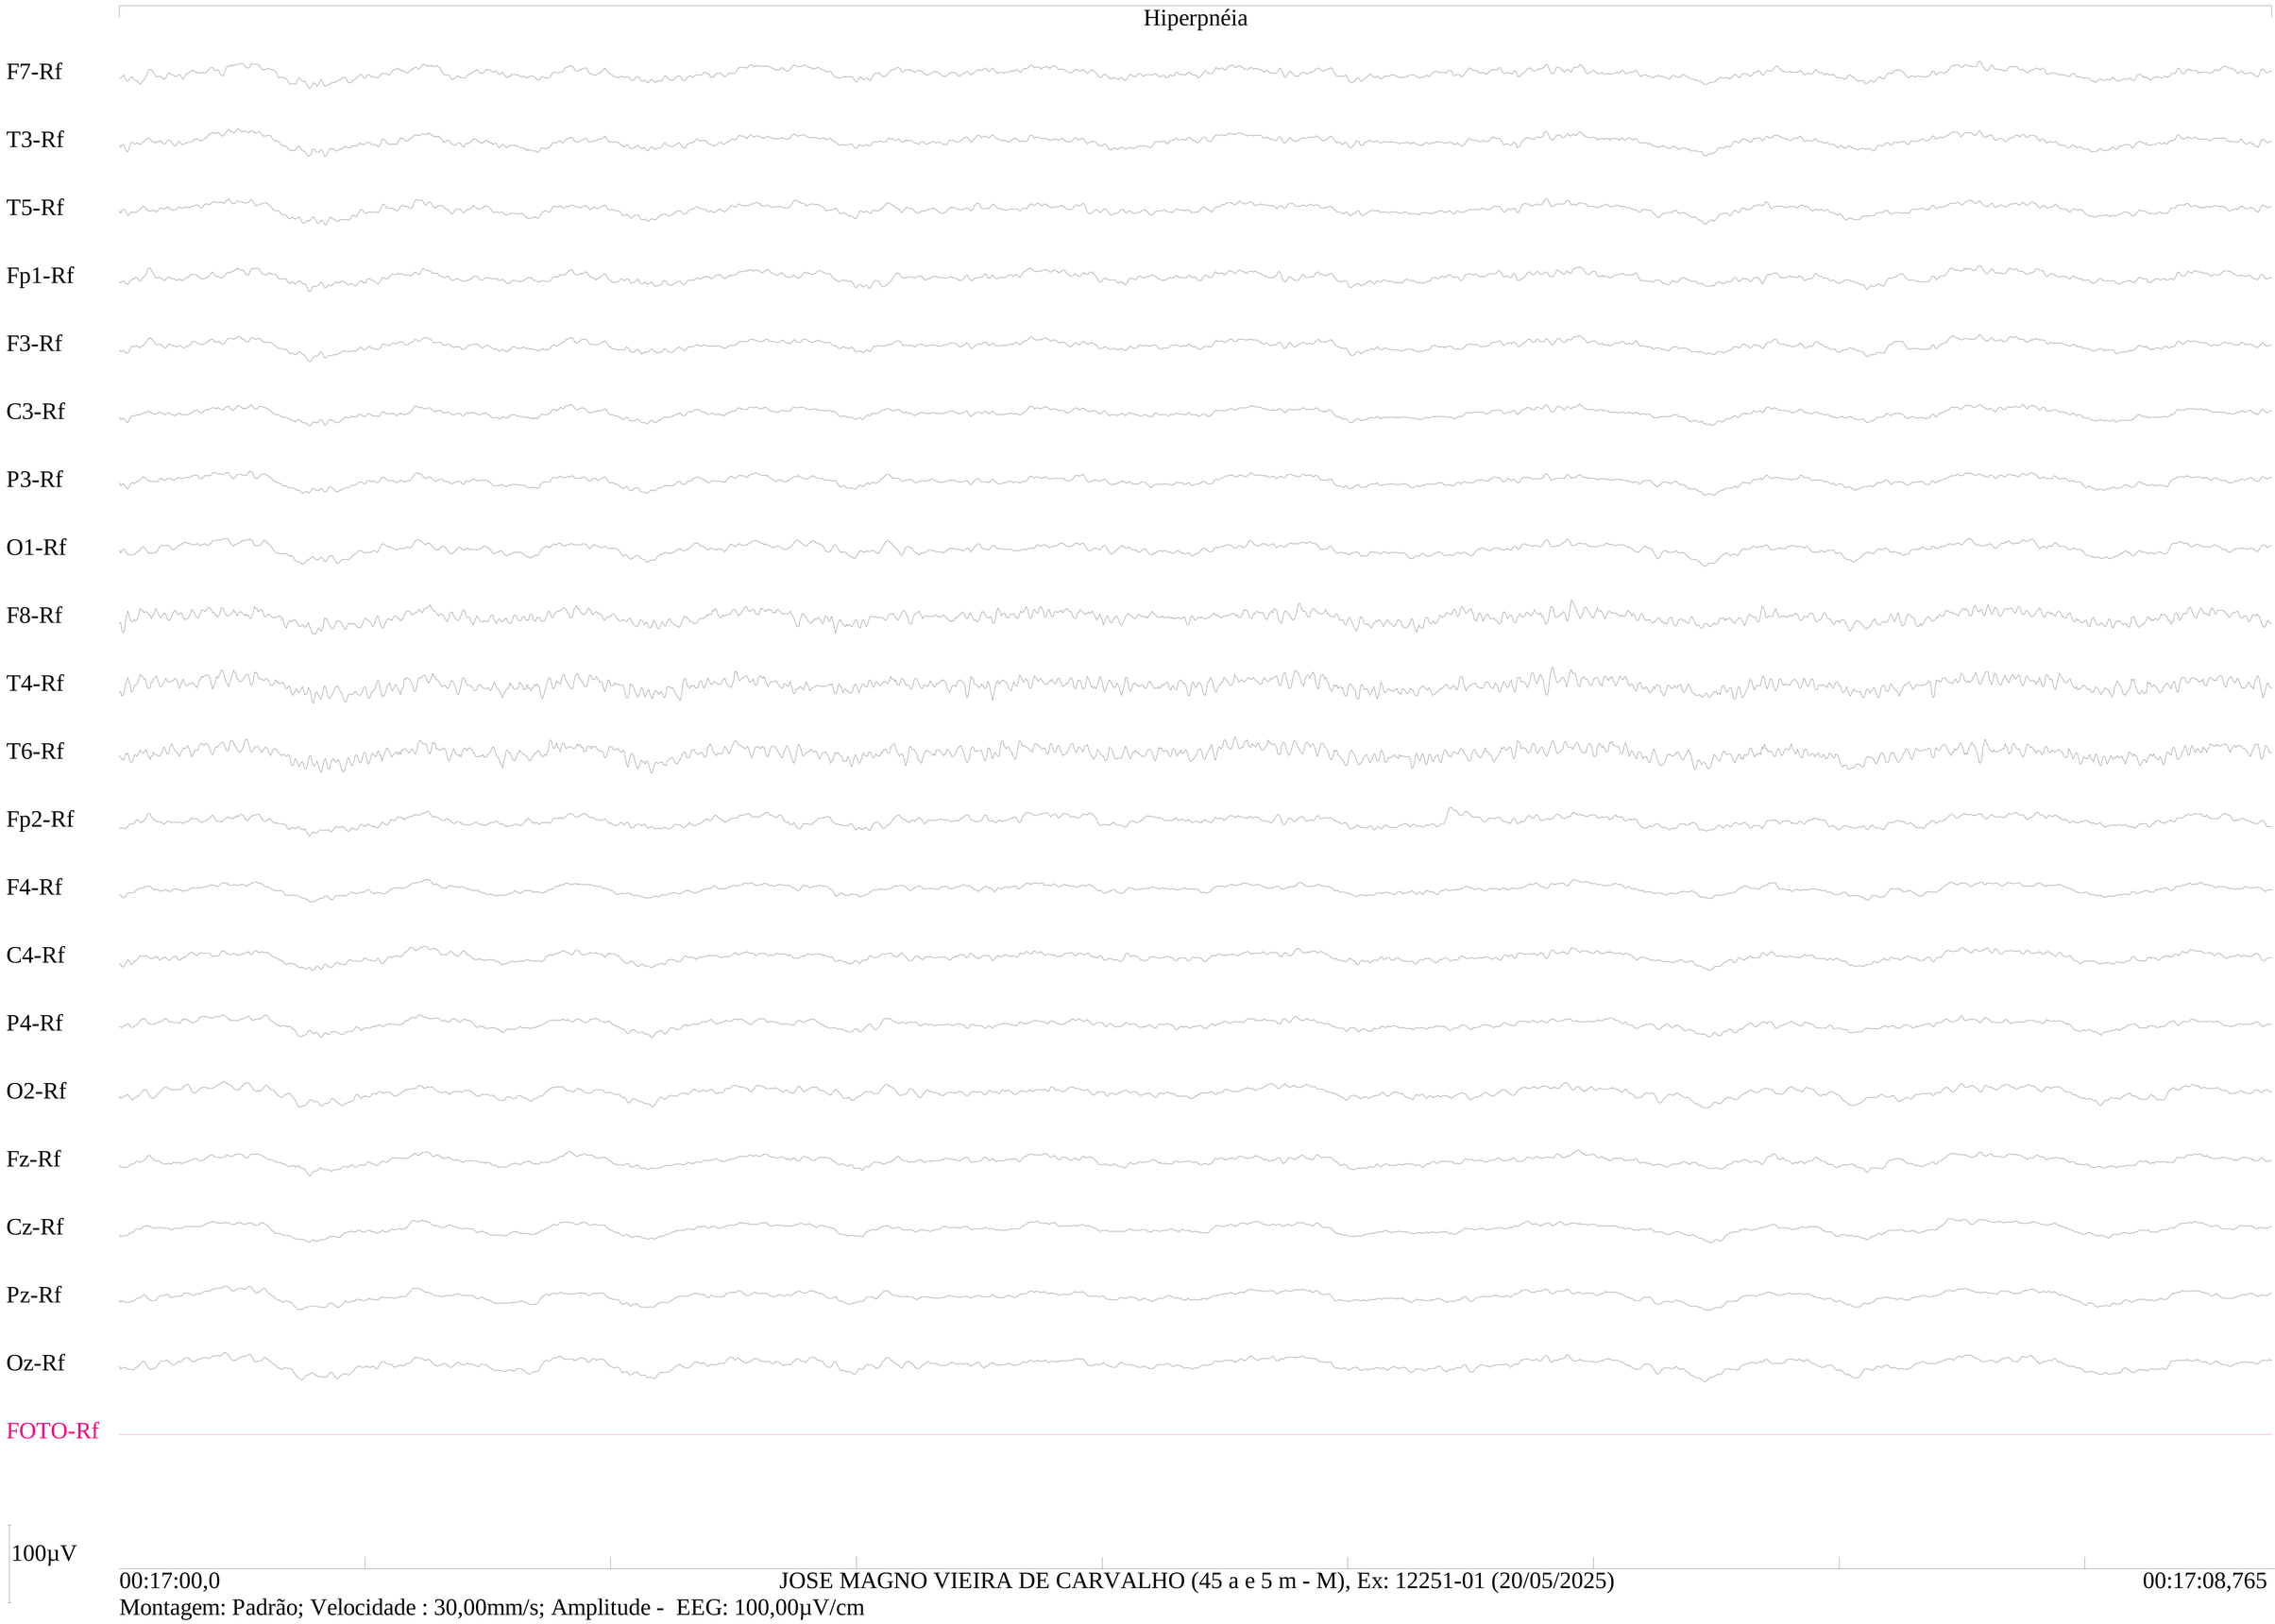

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

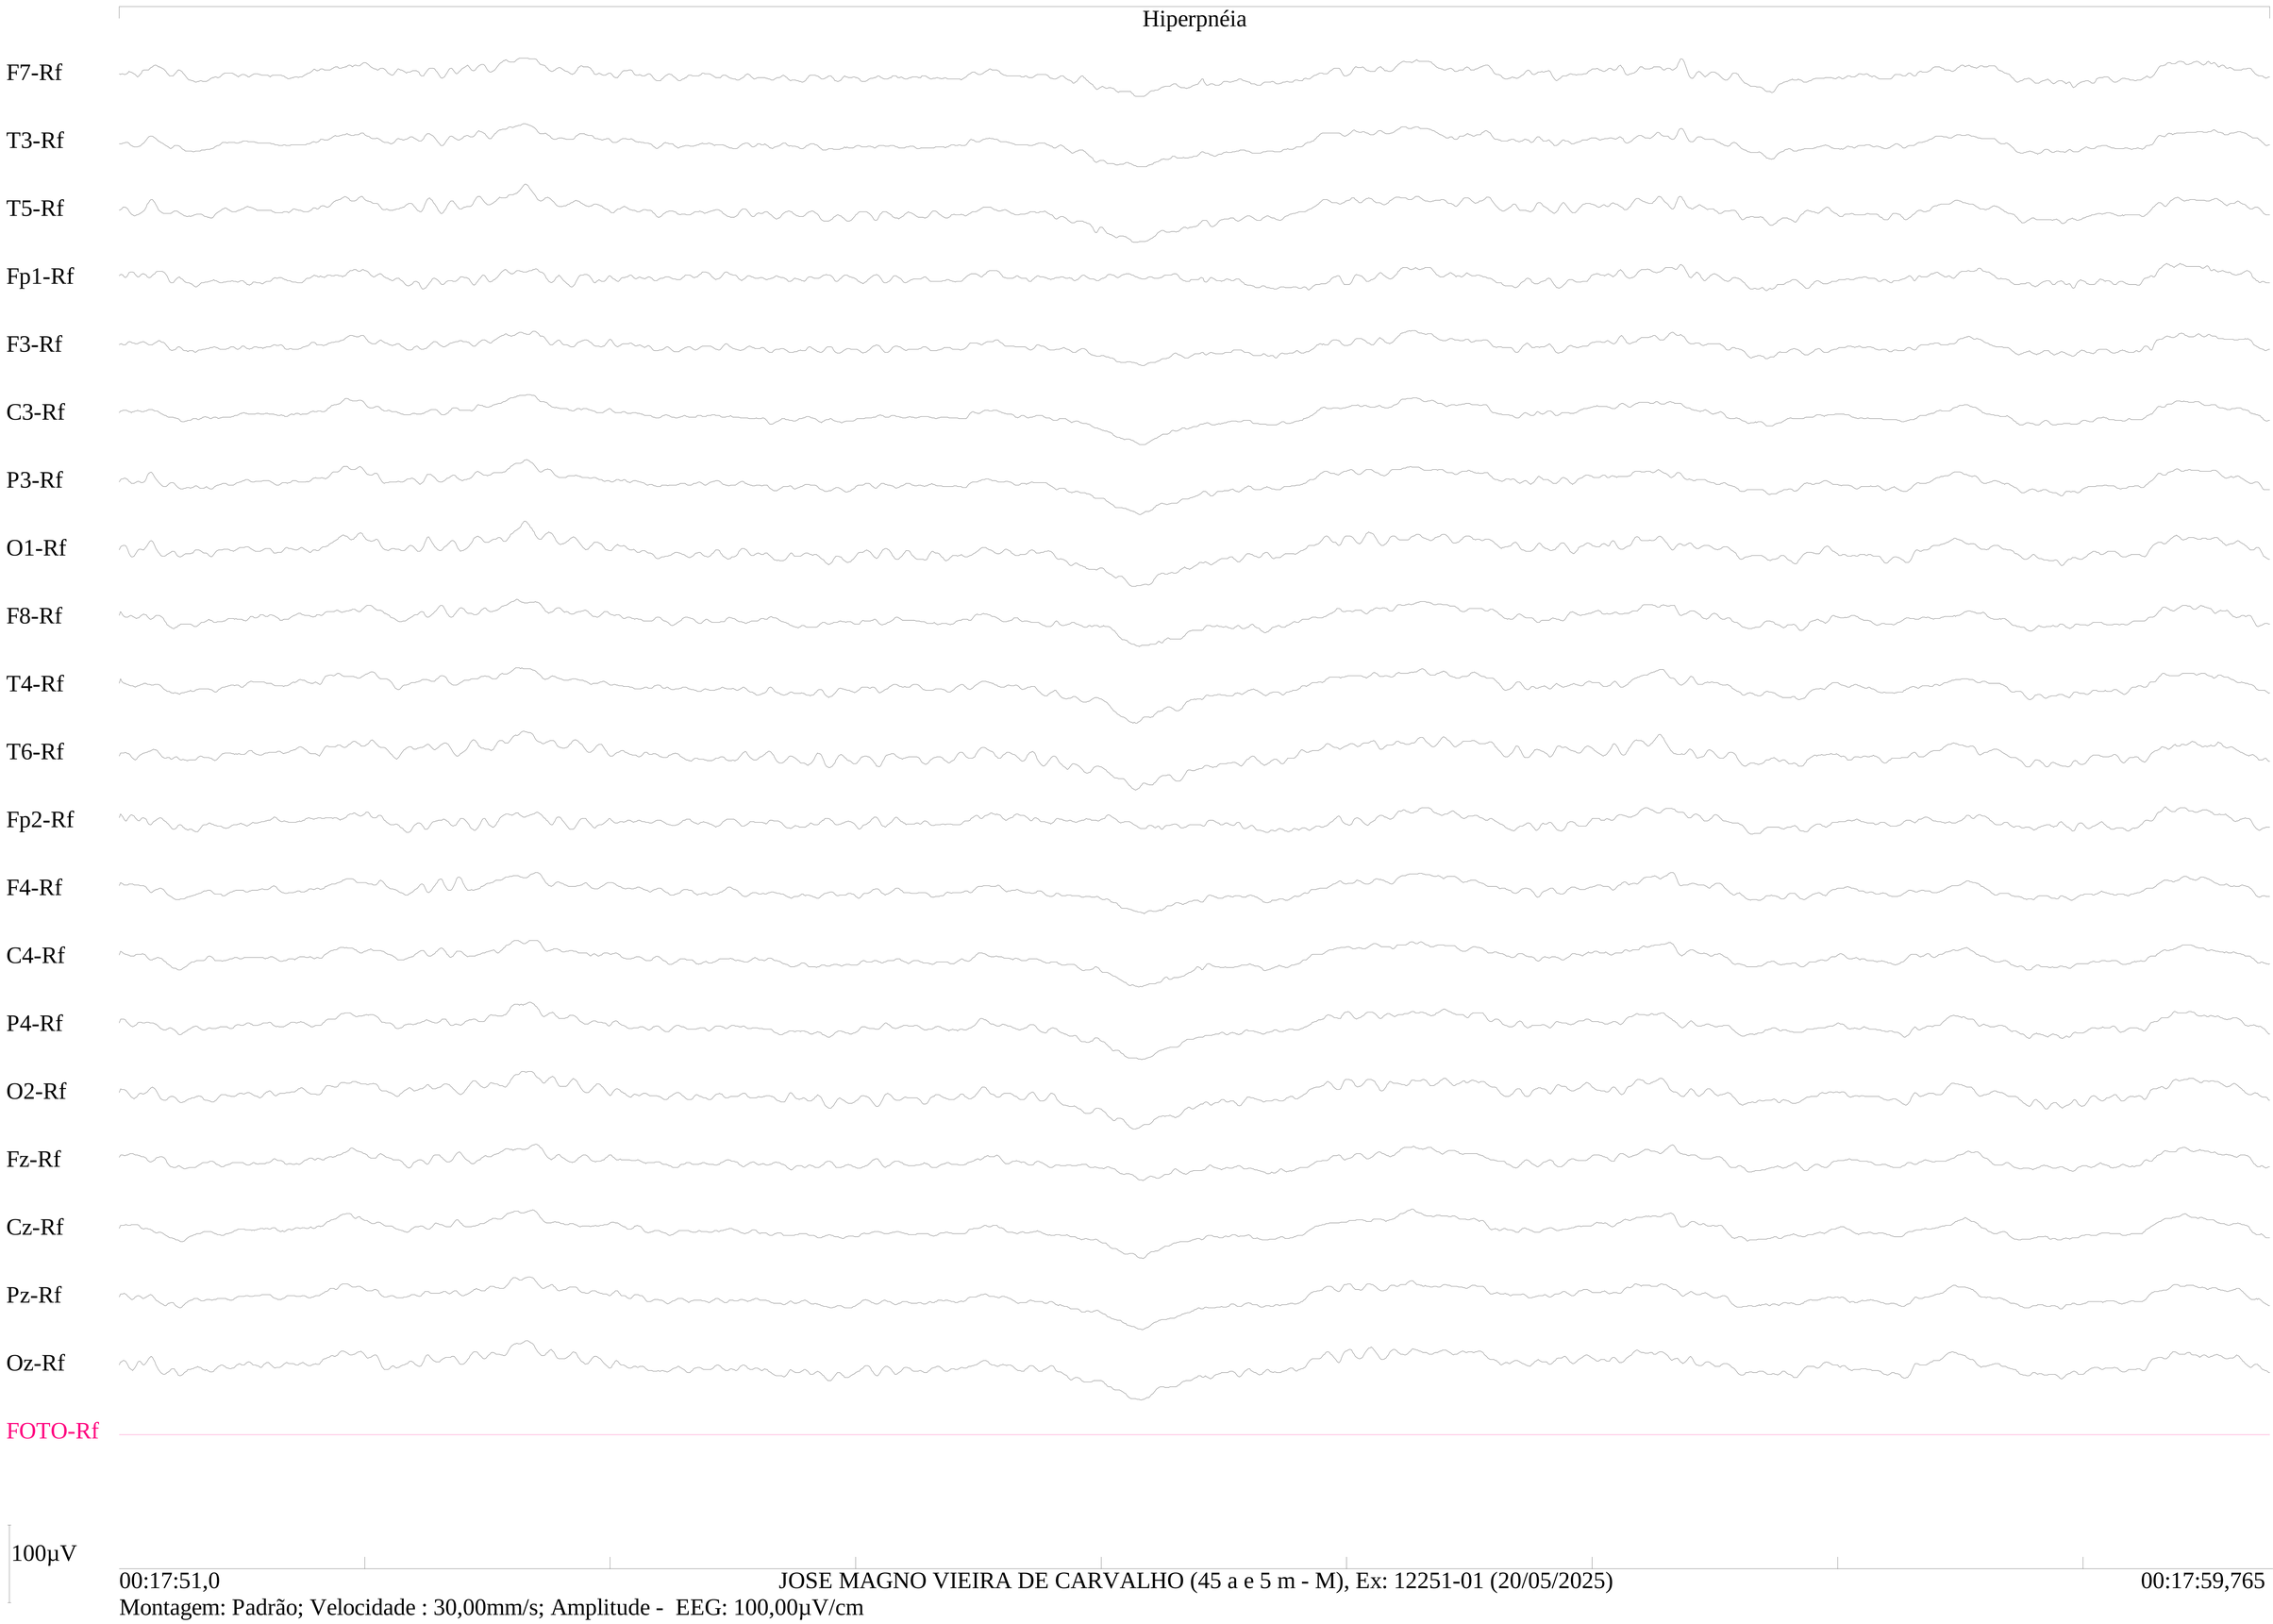

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

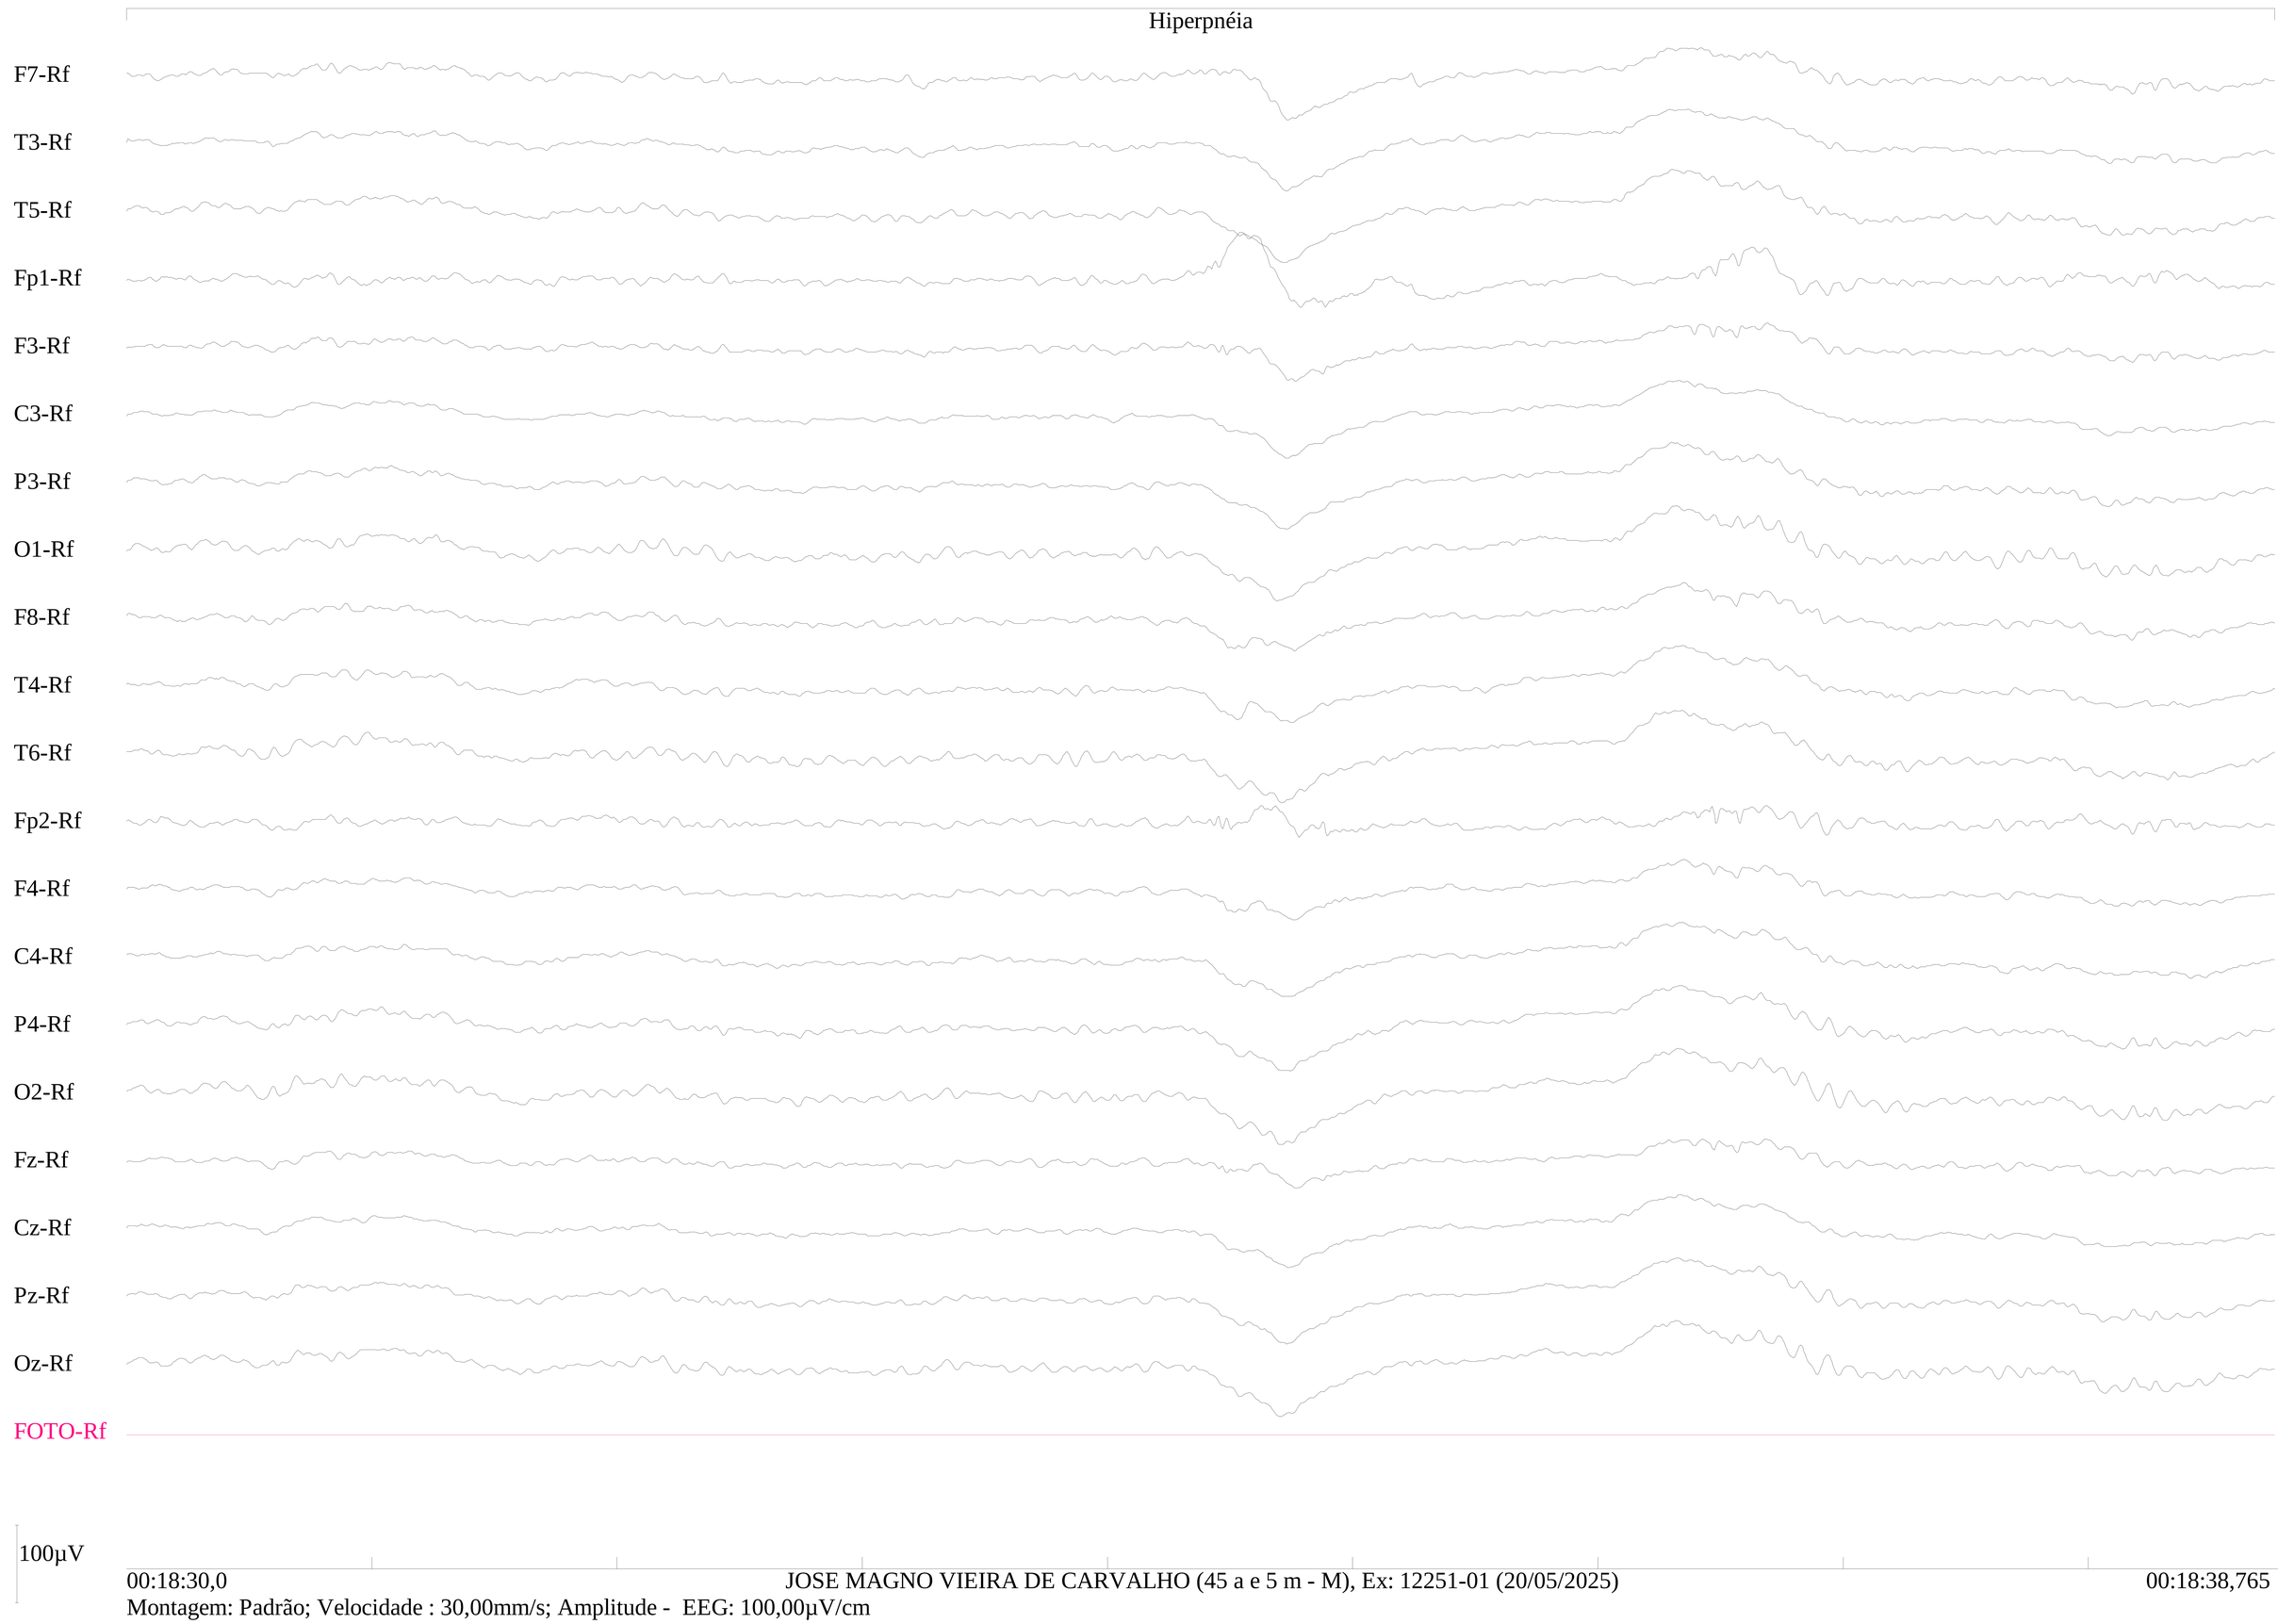

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

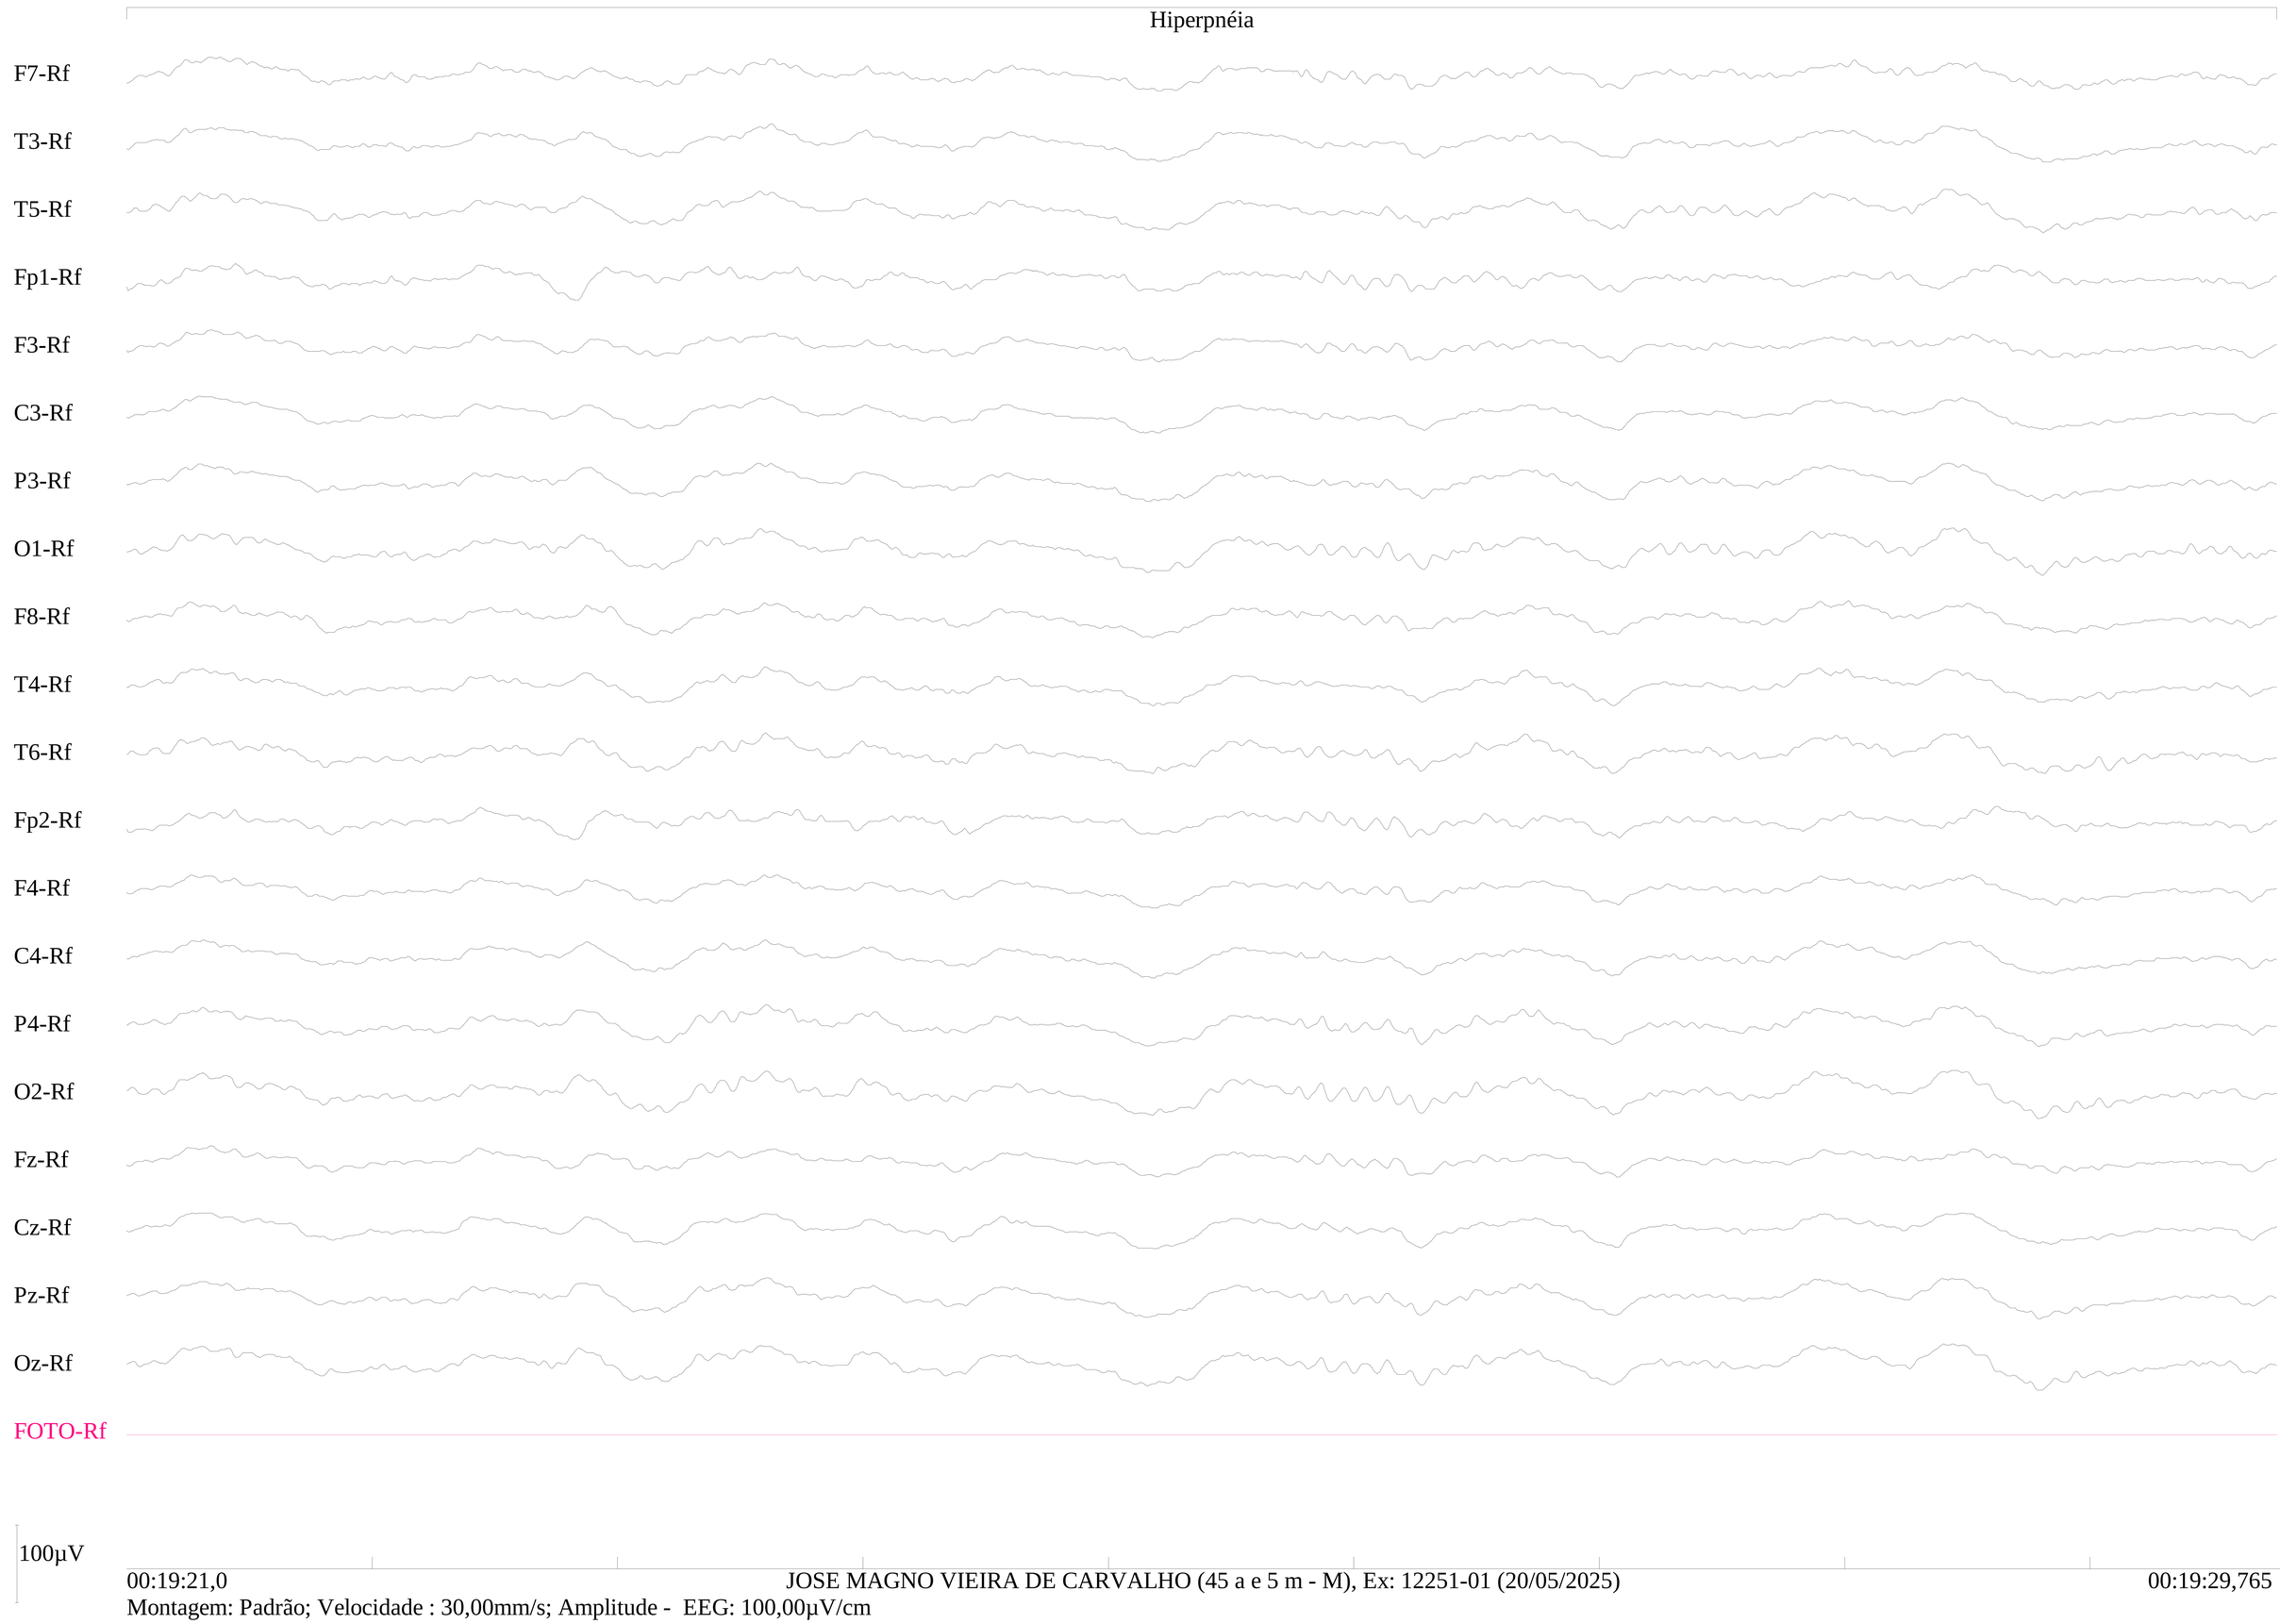

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

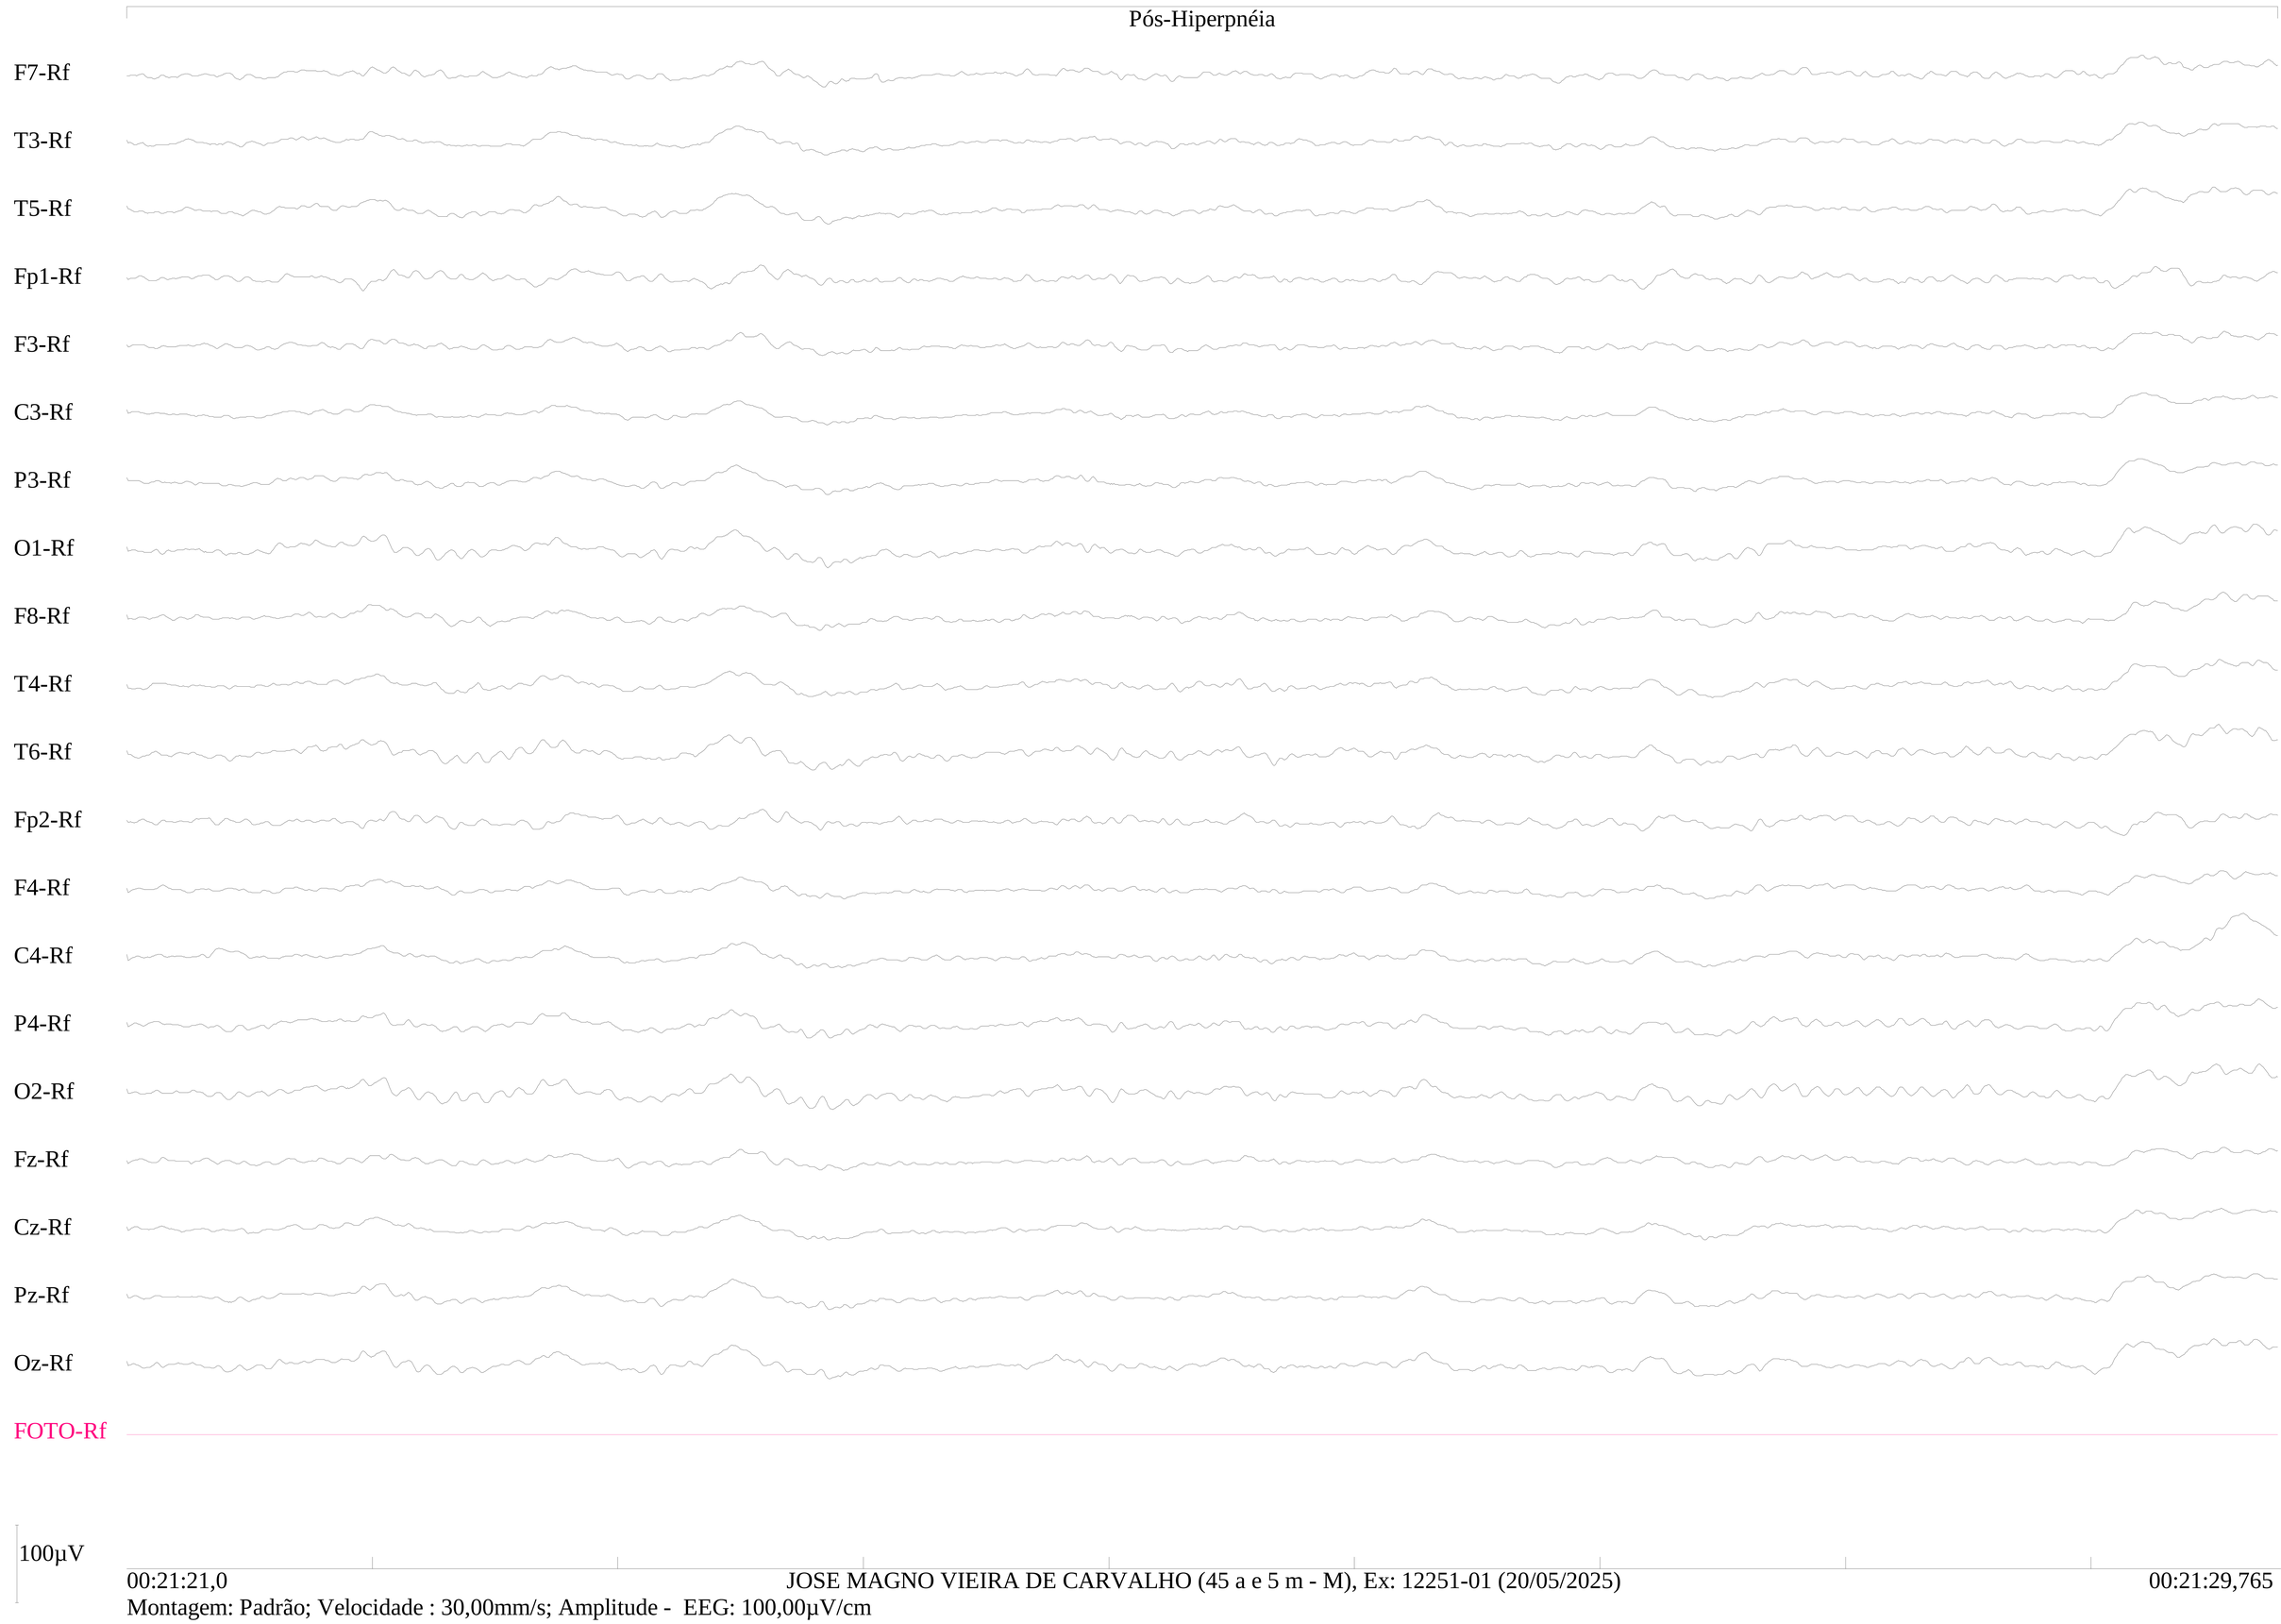
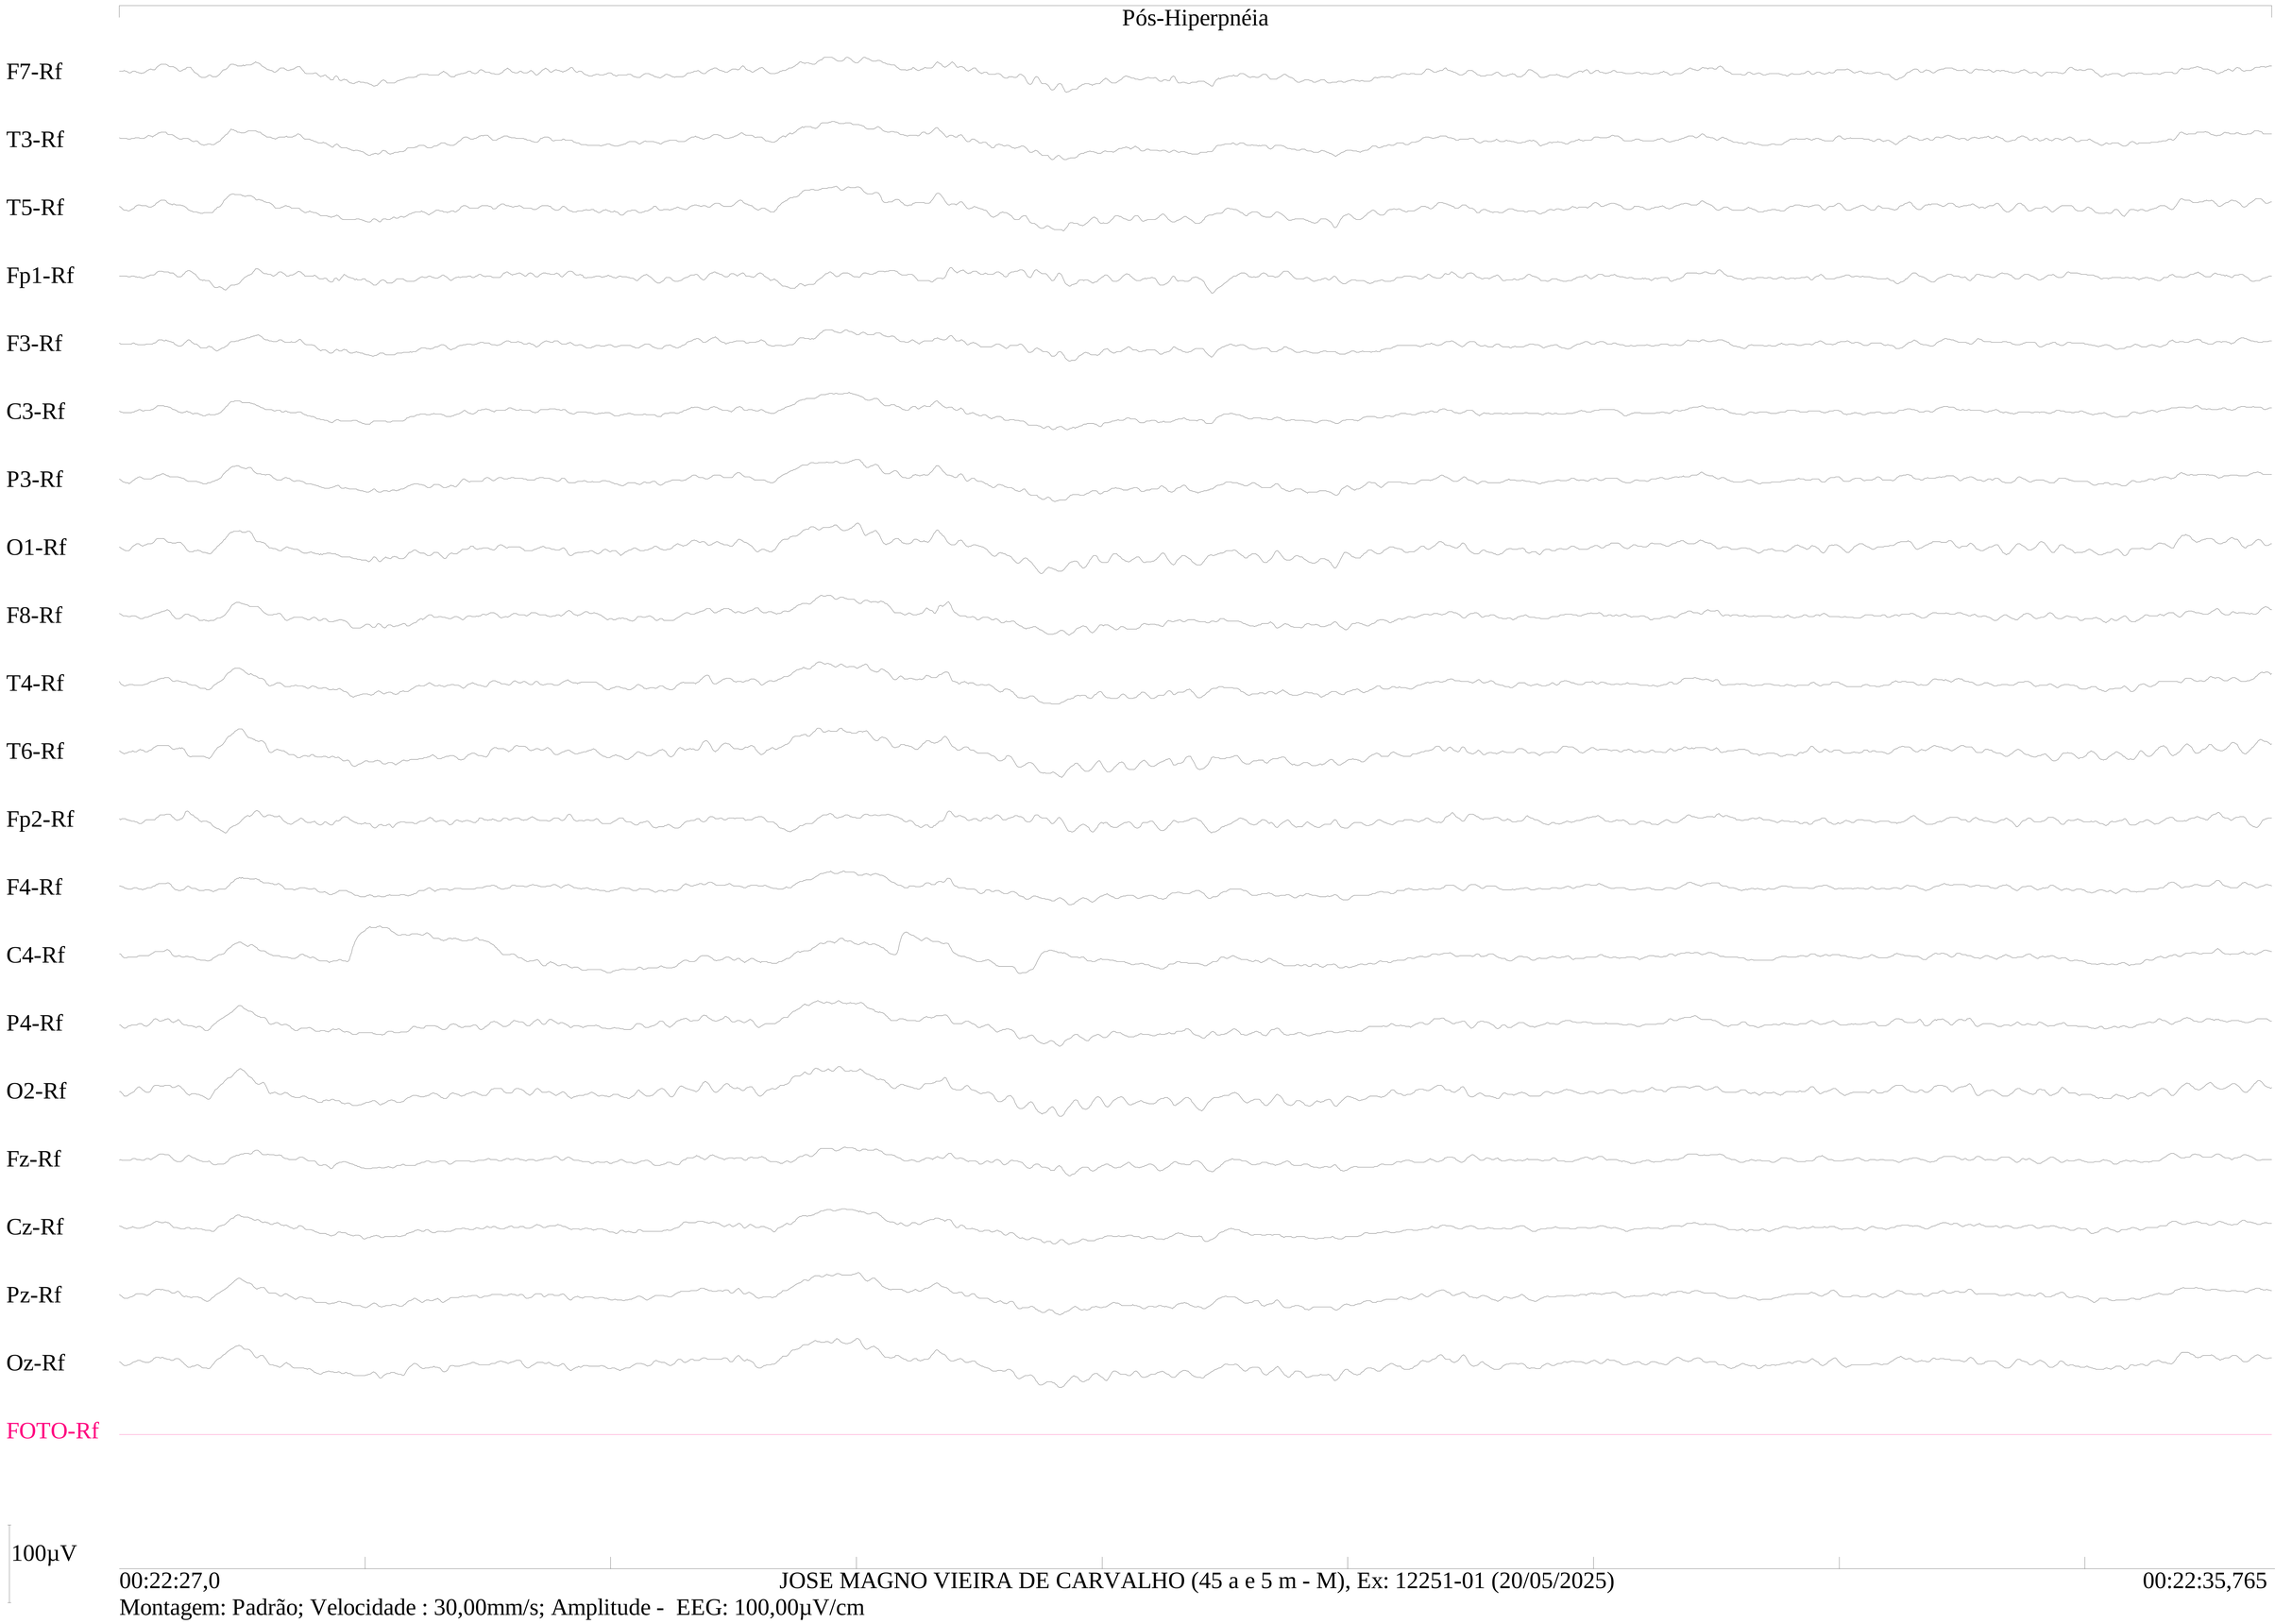
[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]