

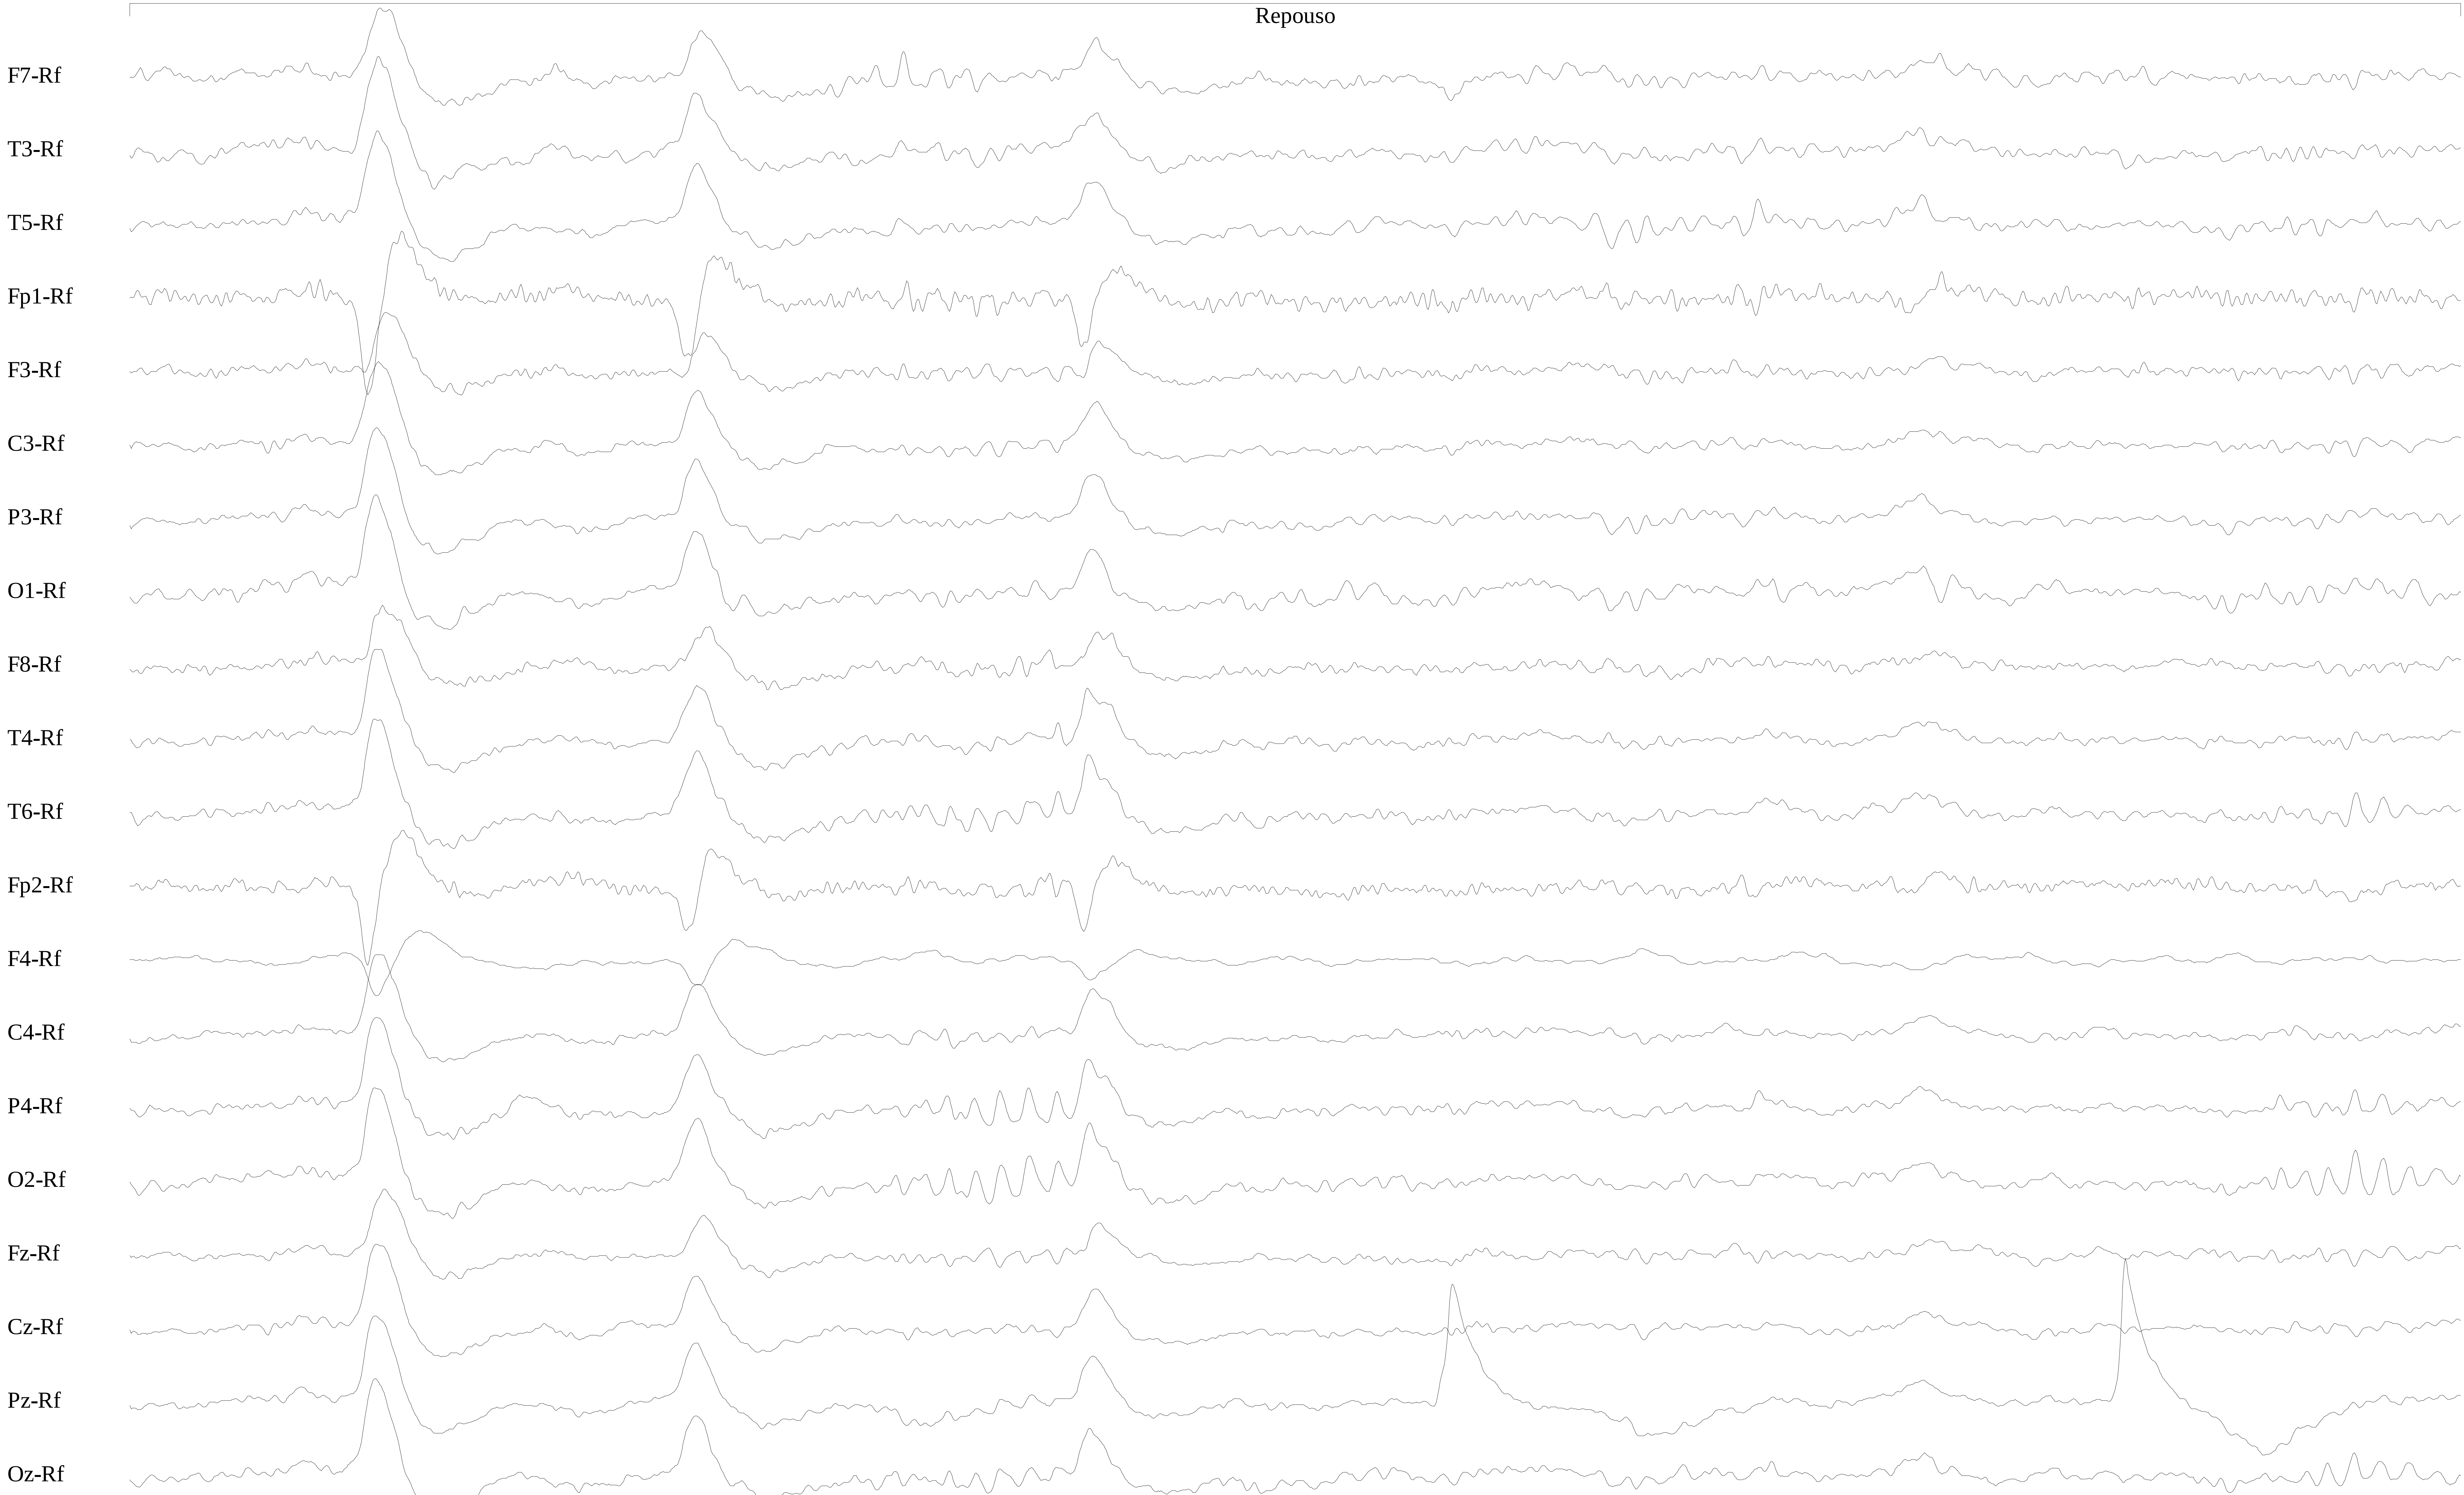


FOTO-Rf

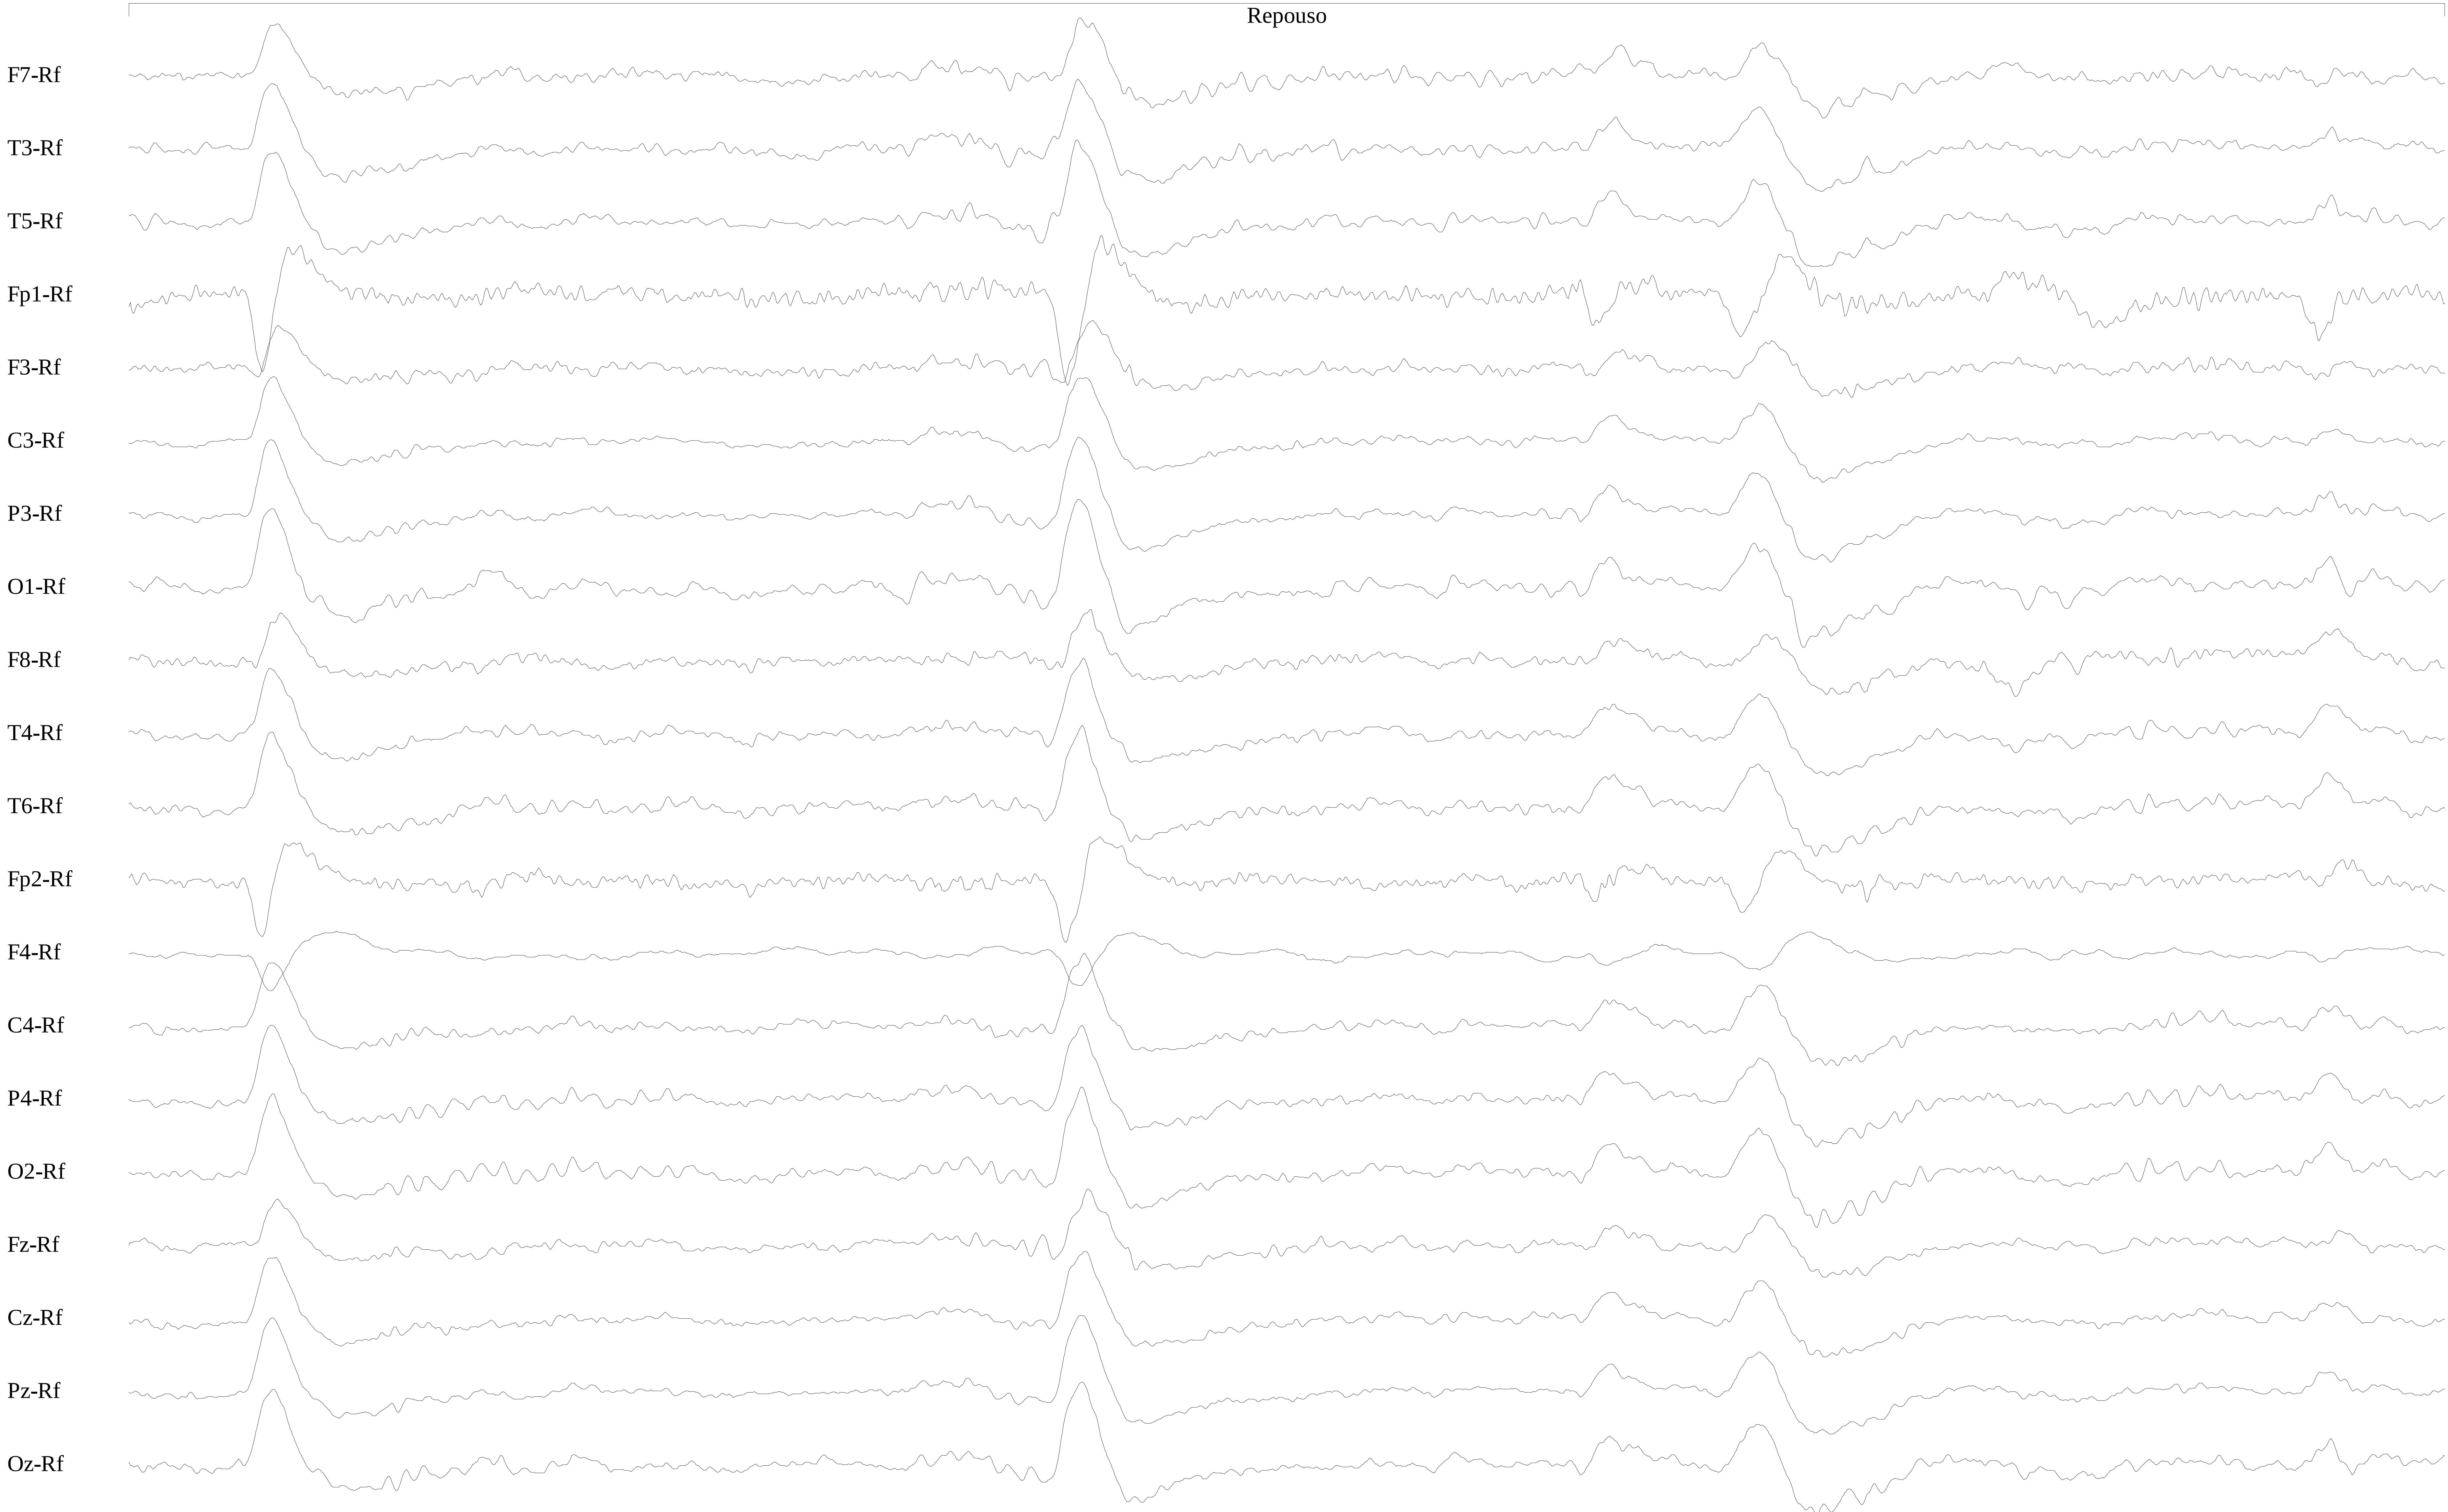


FOTO-Rf

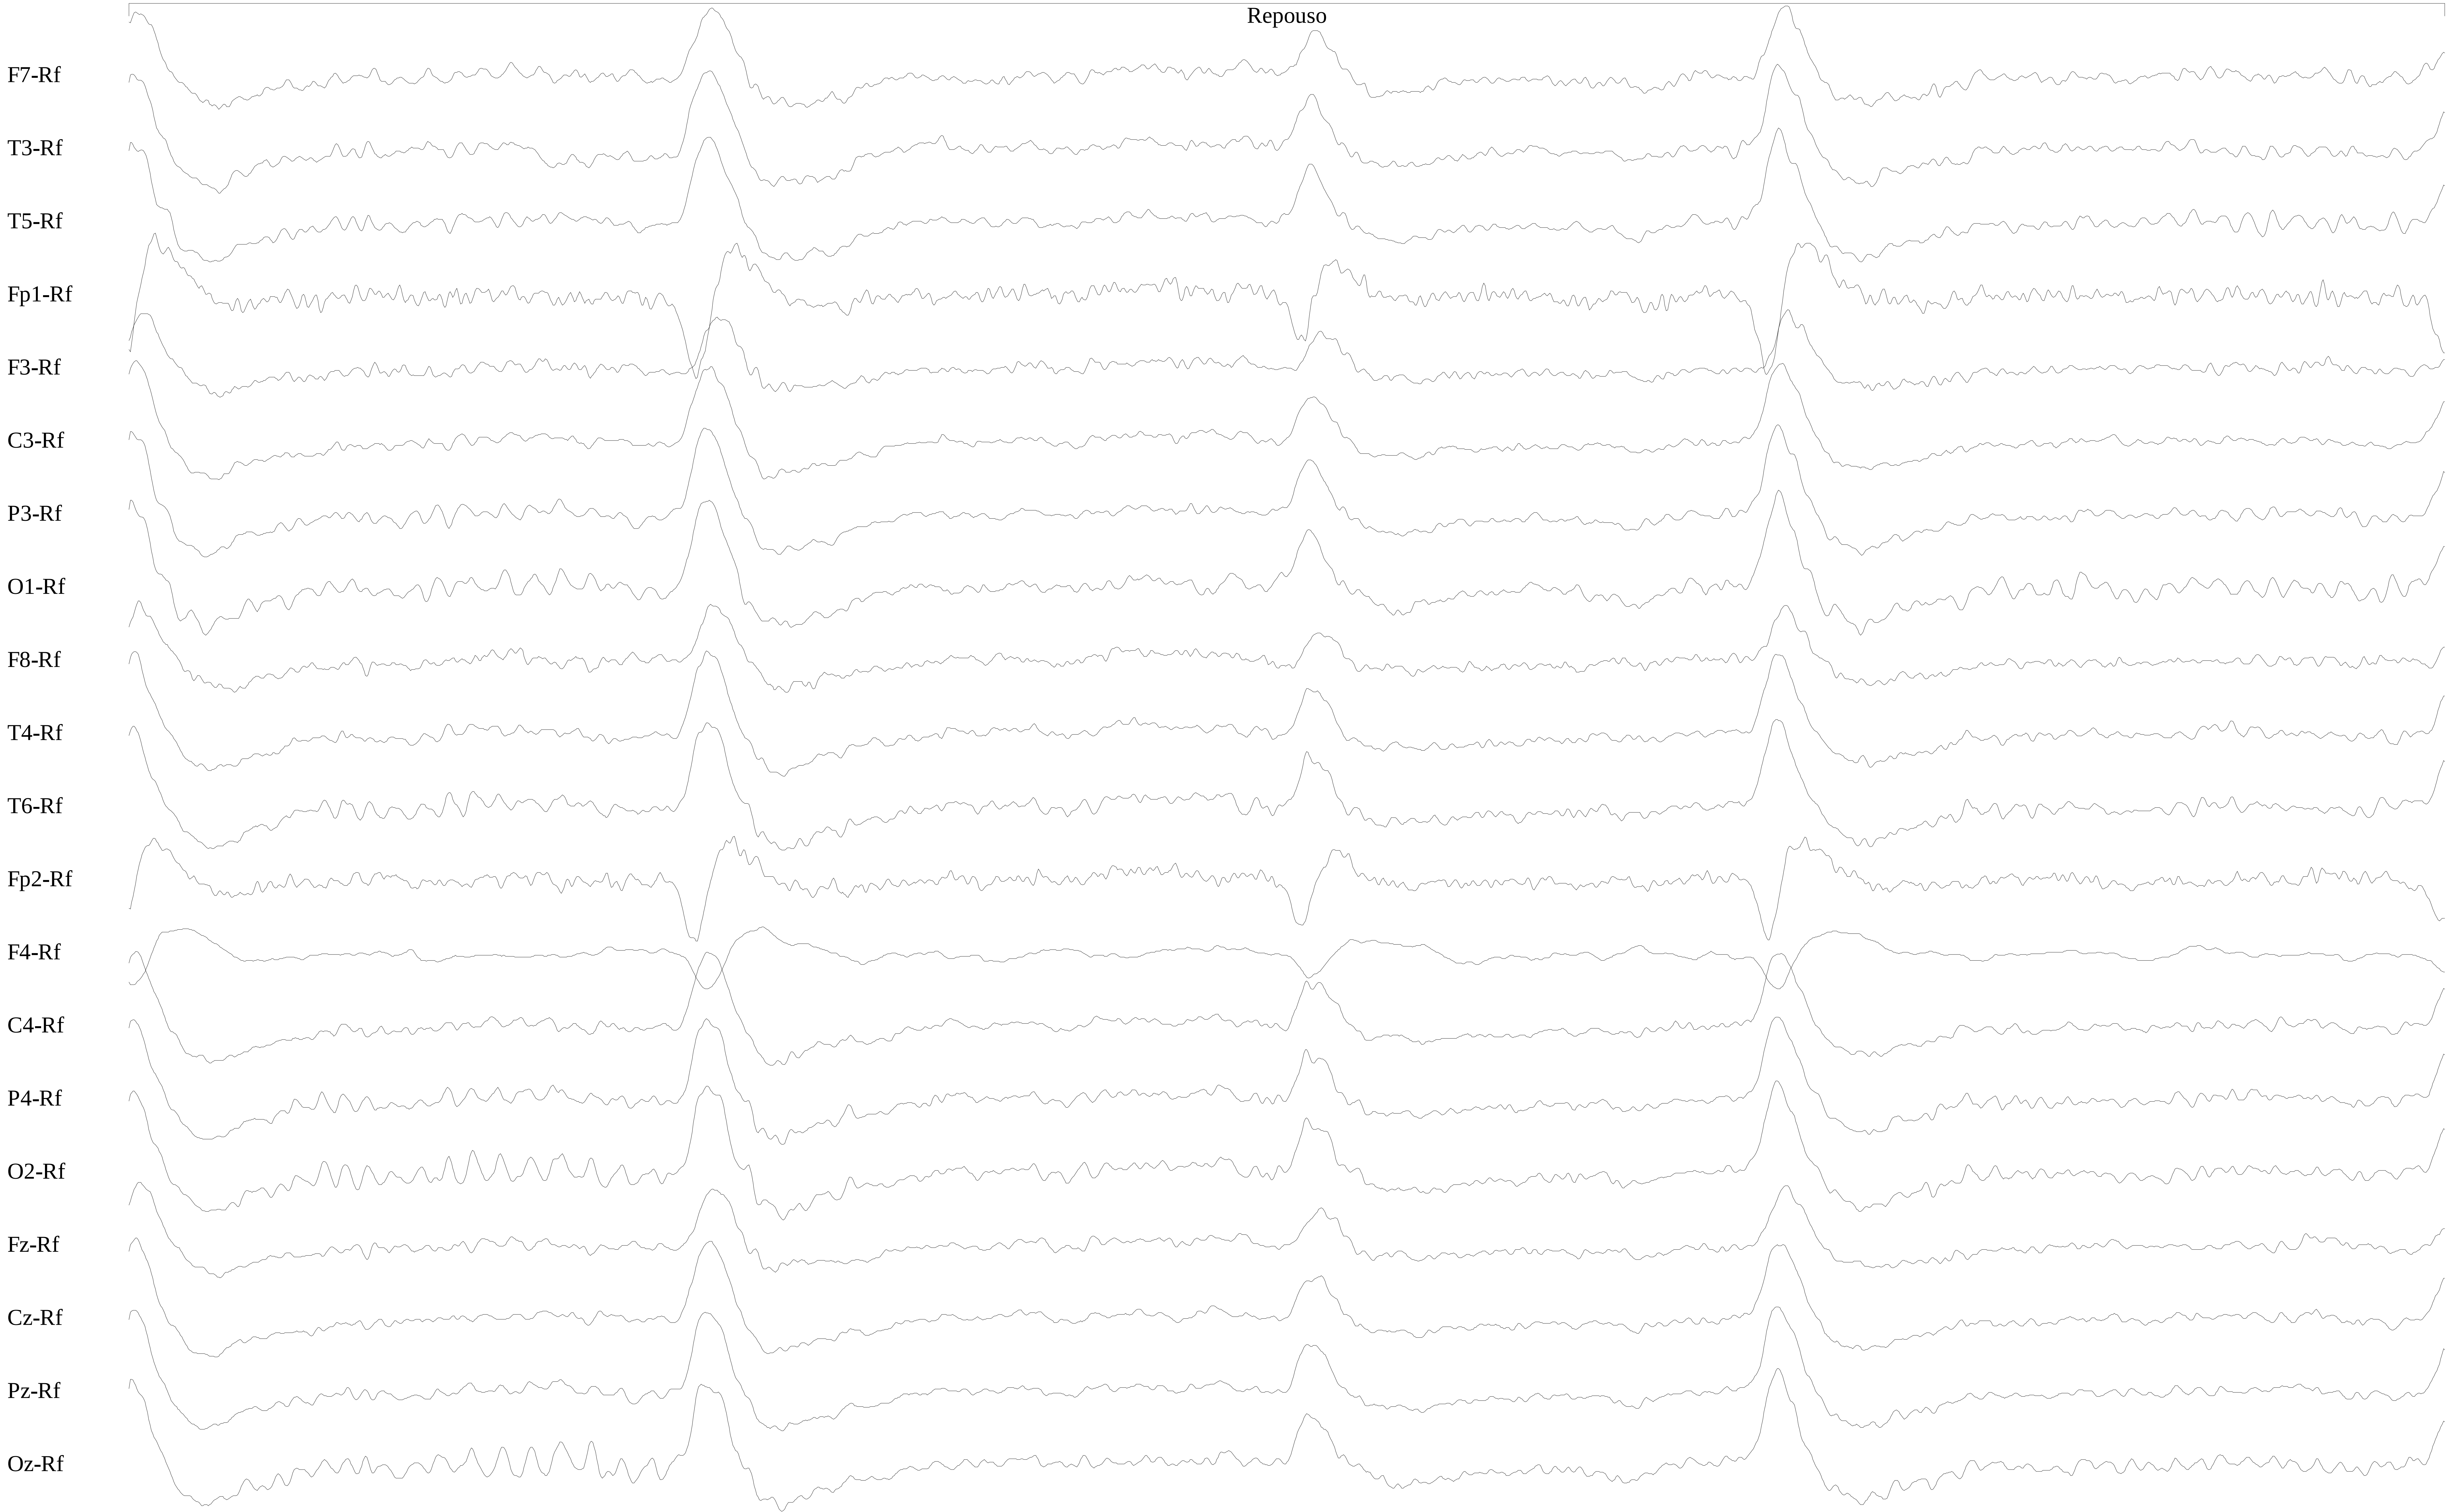


FOTO-Rf

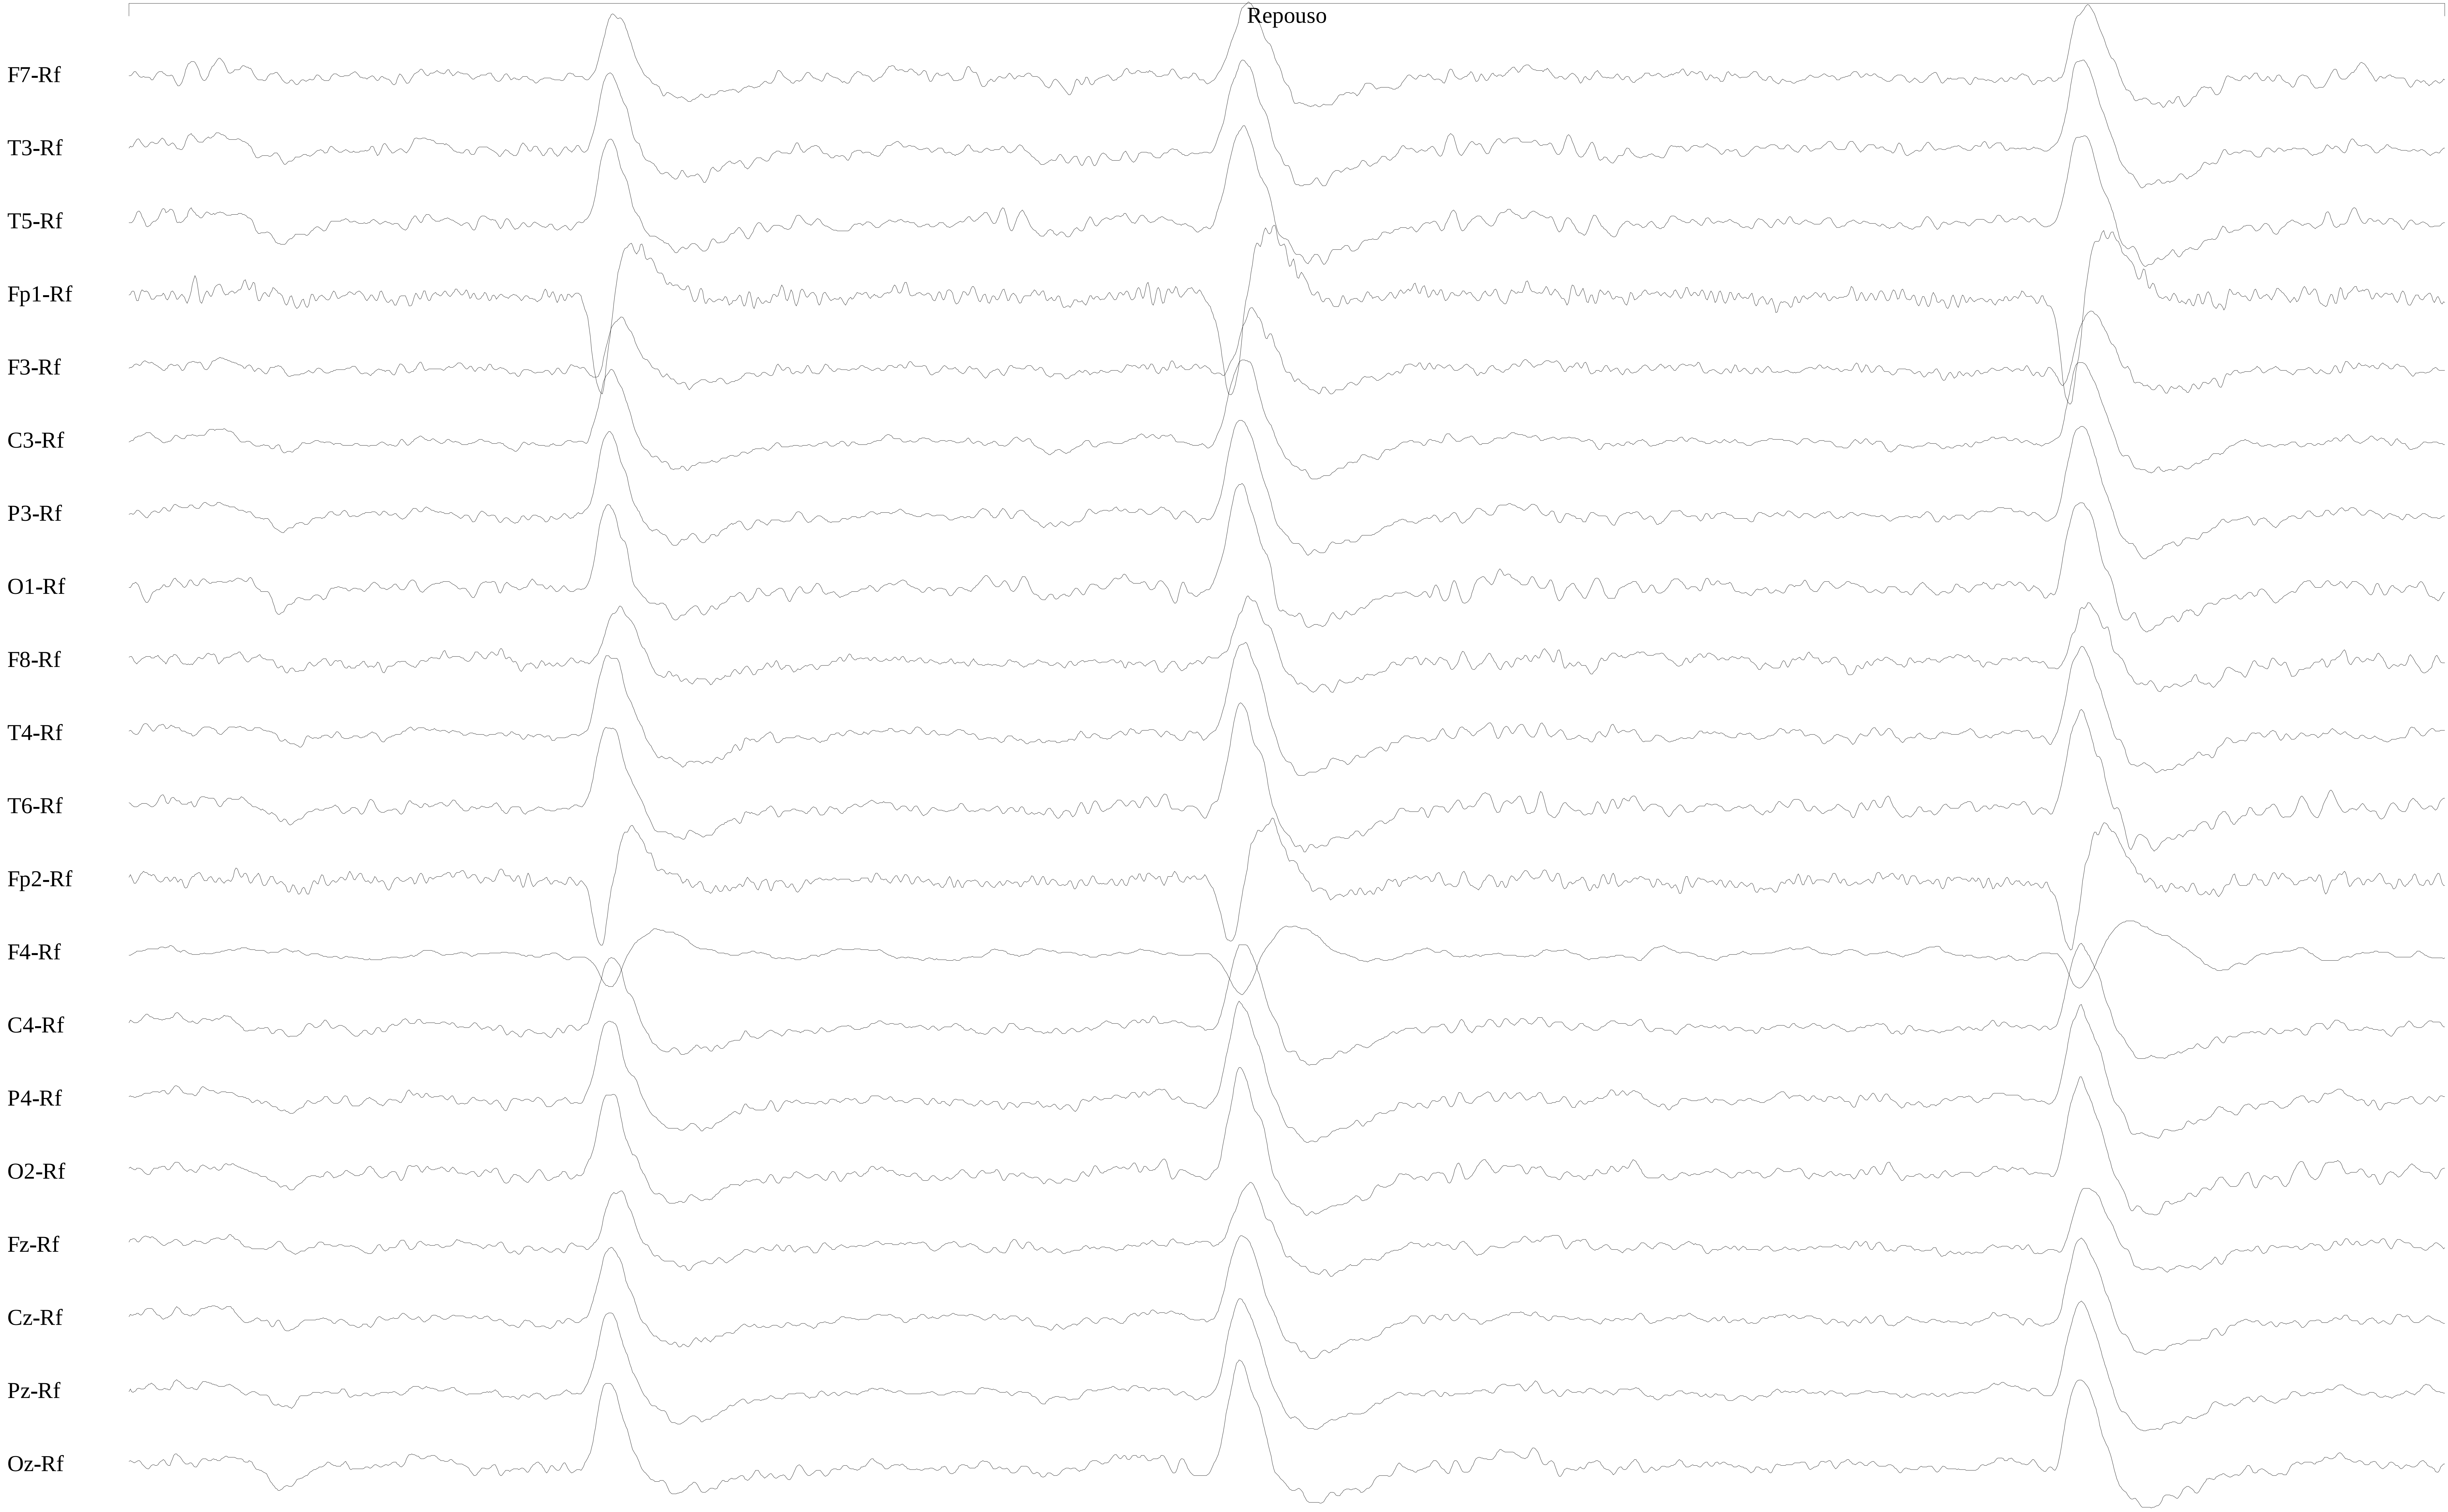


FOTO-Rf

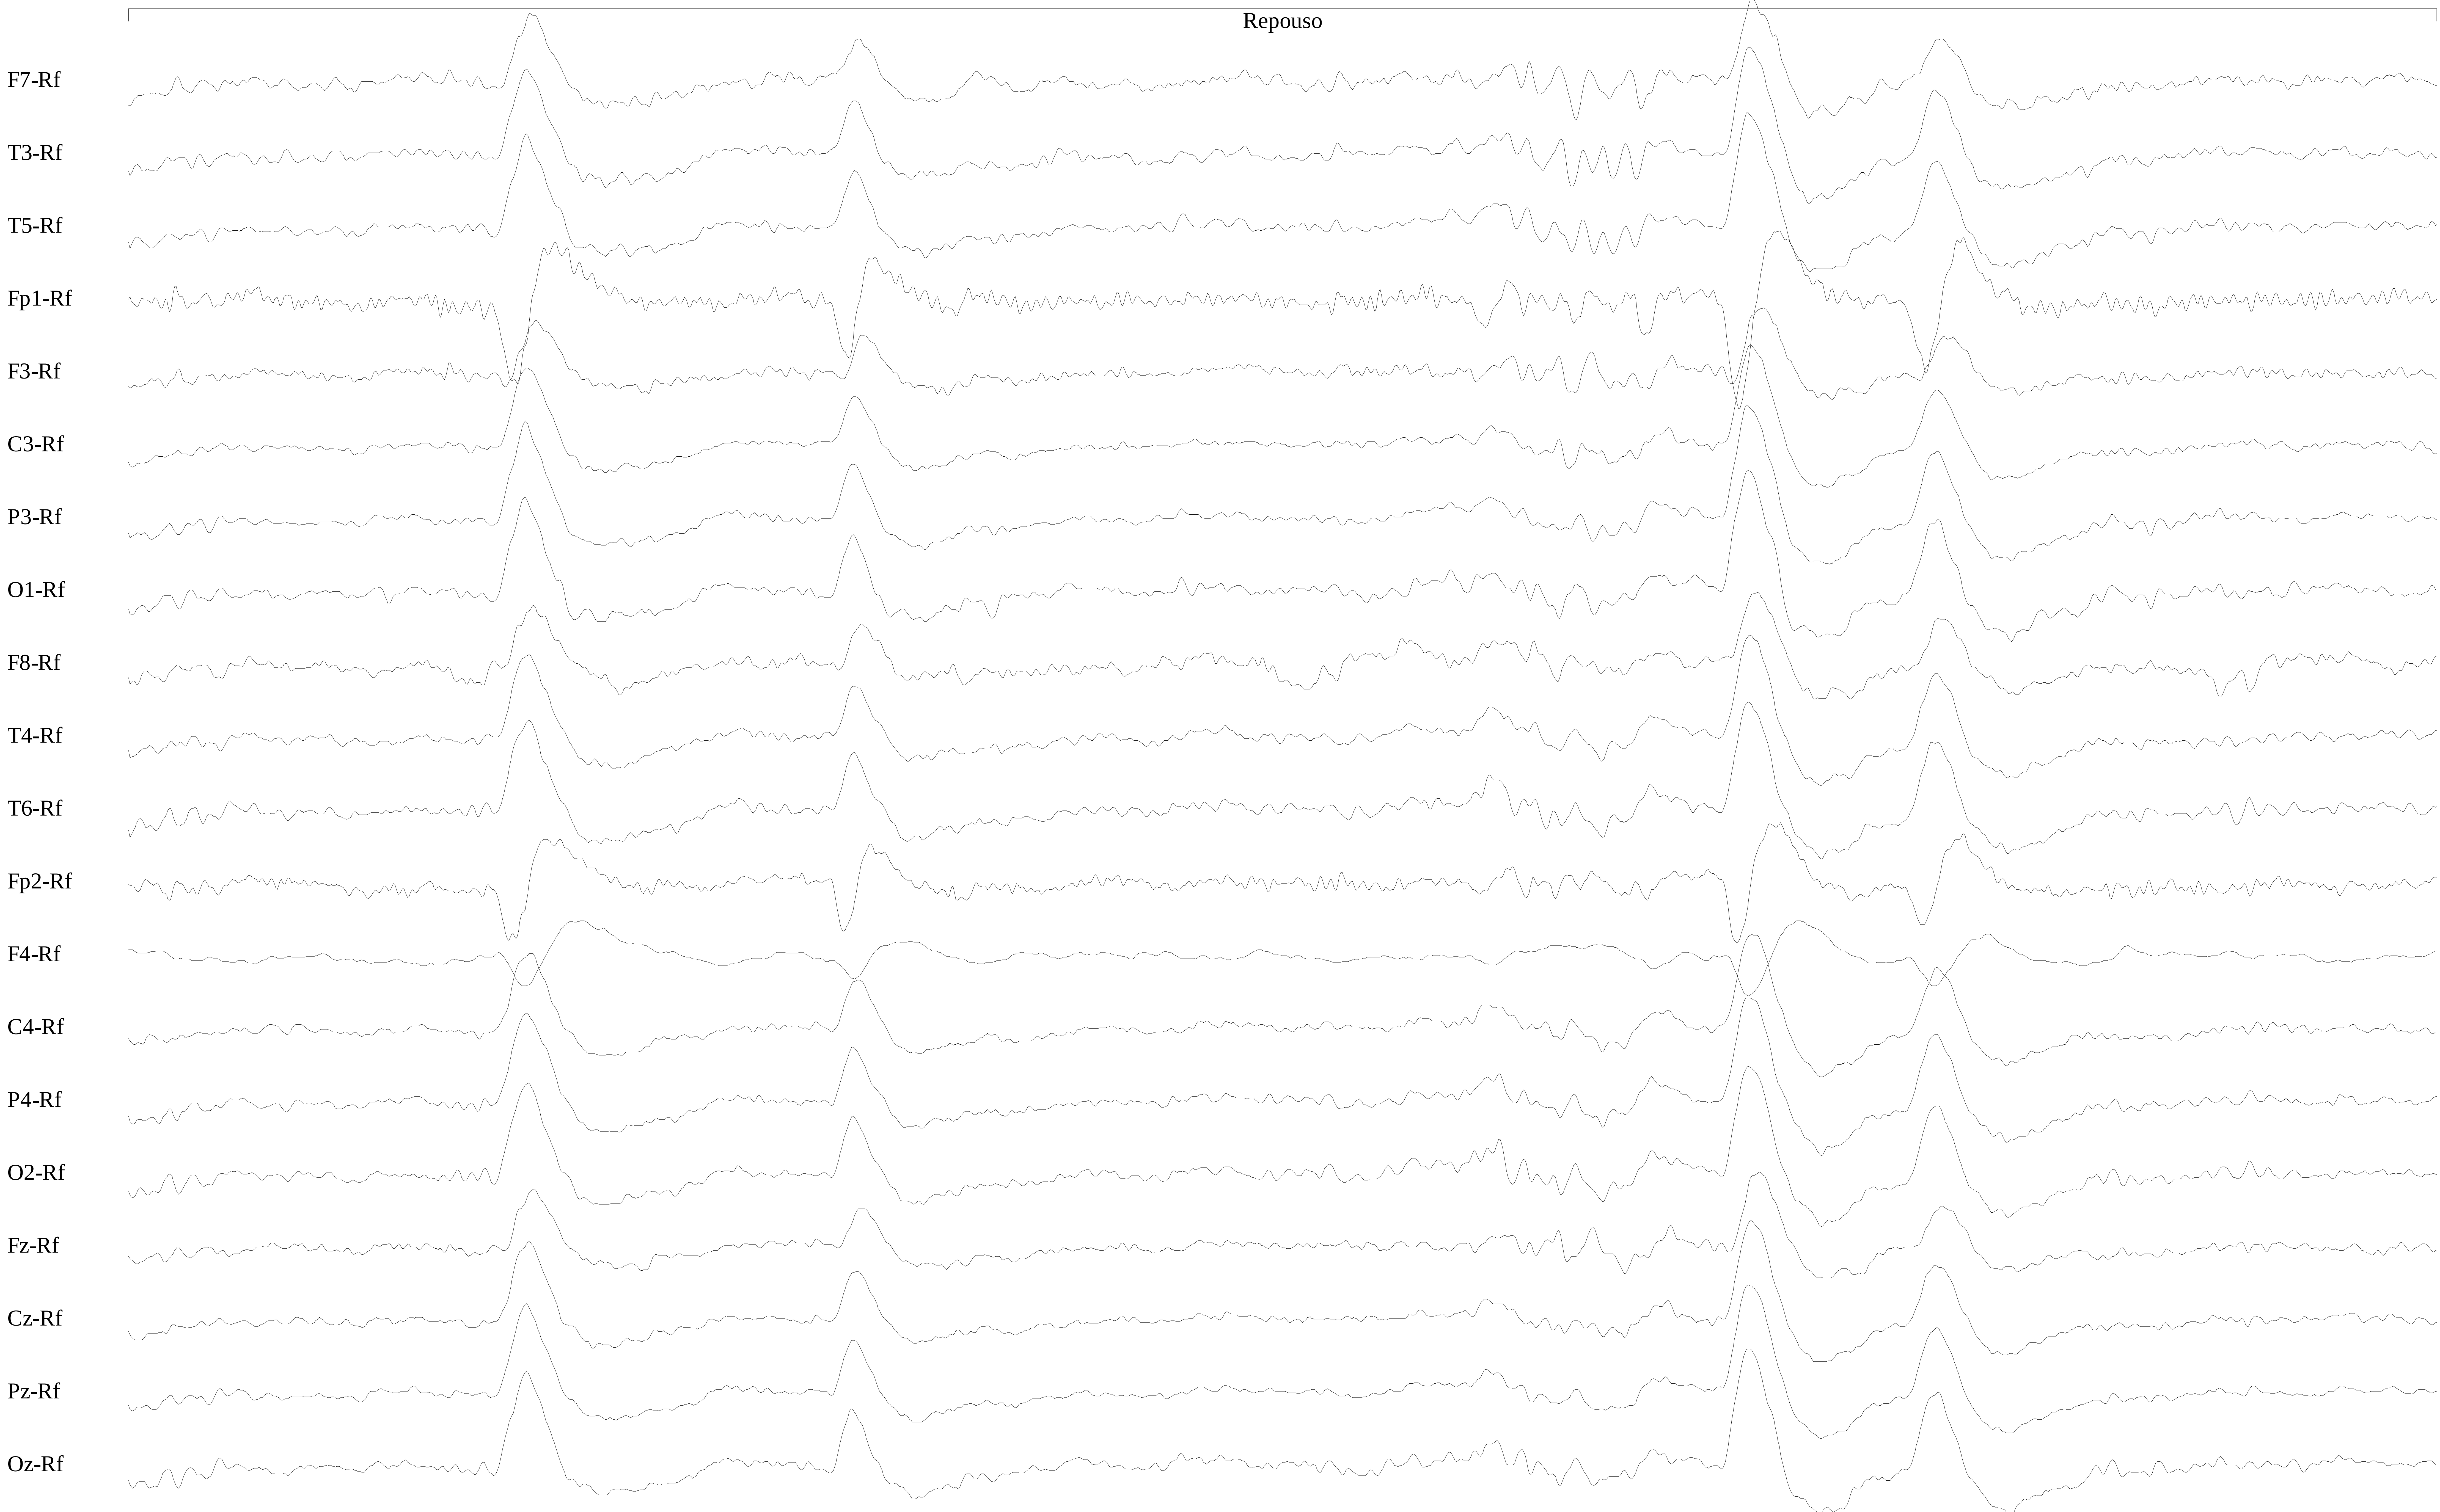
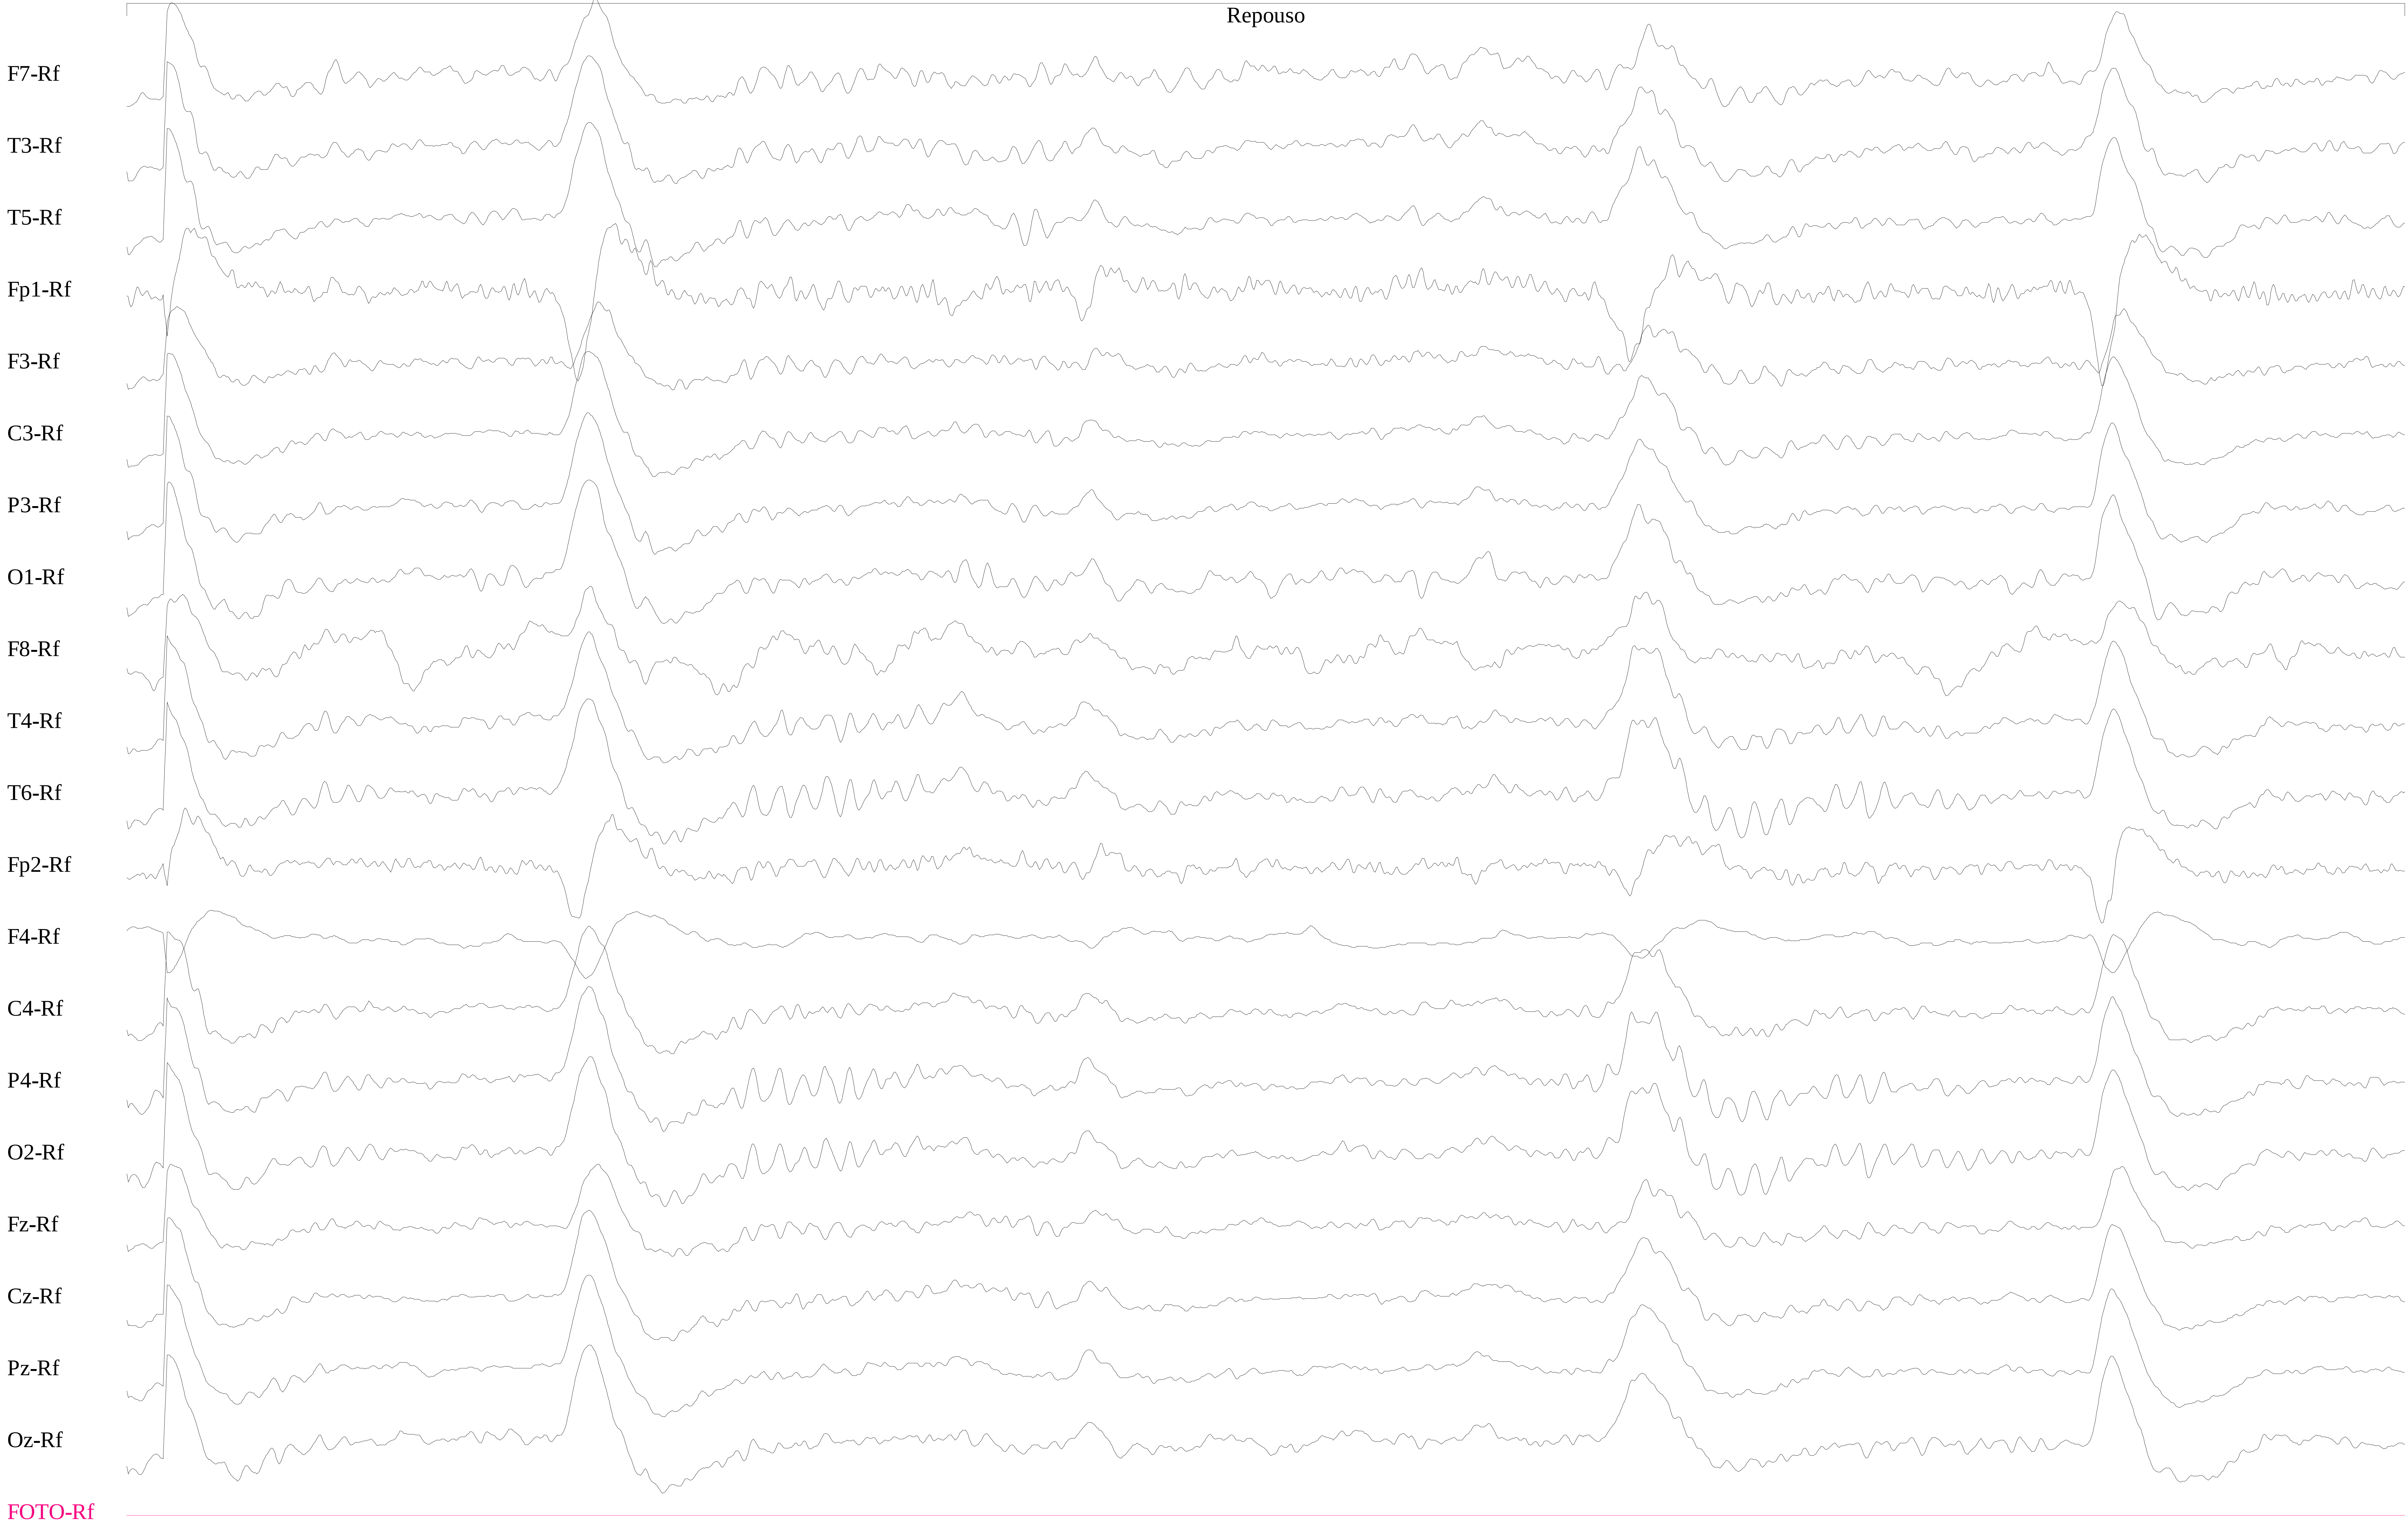
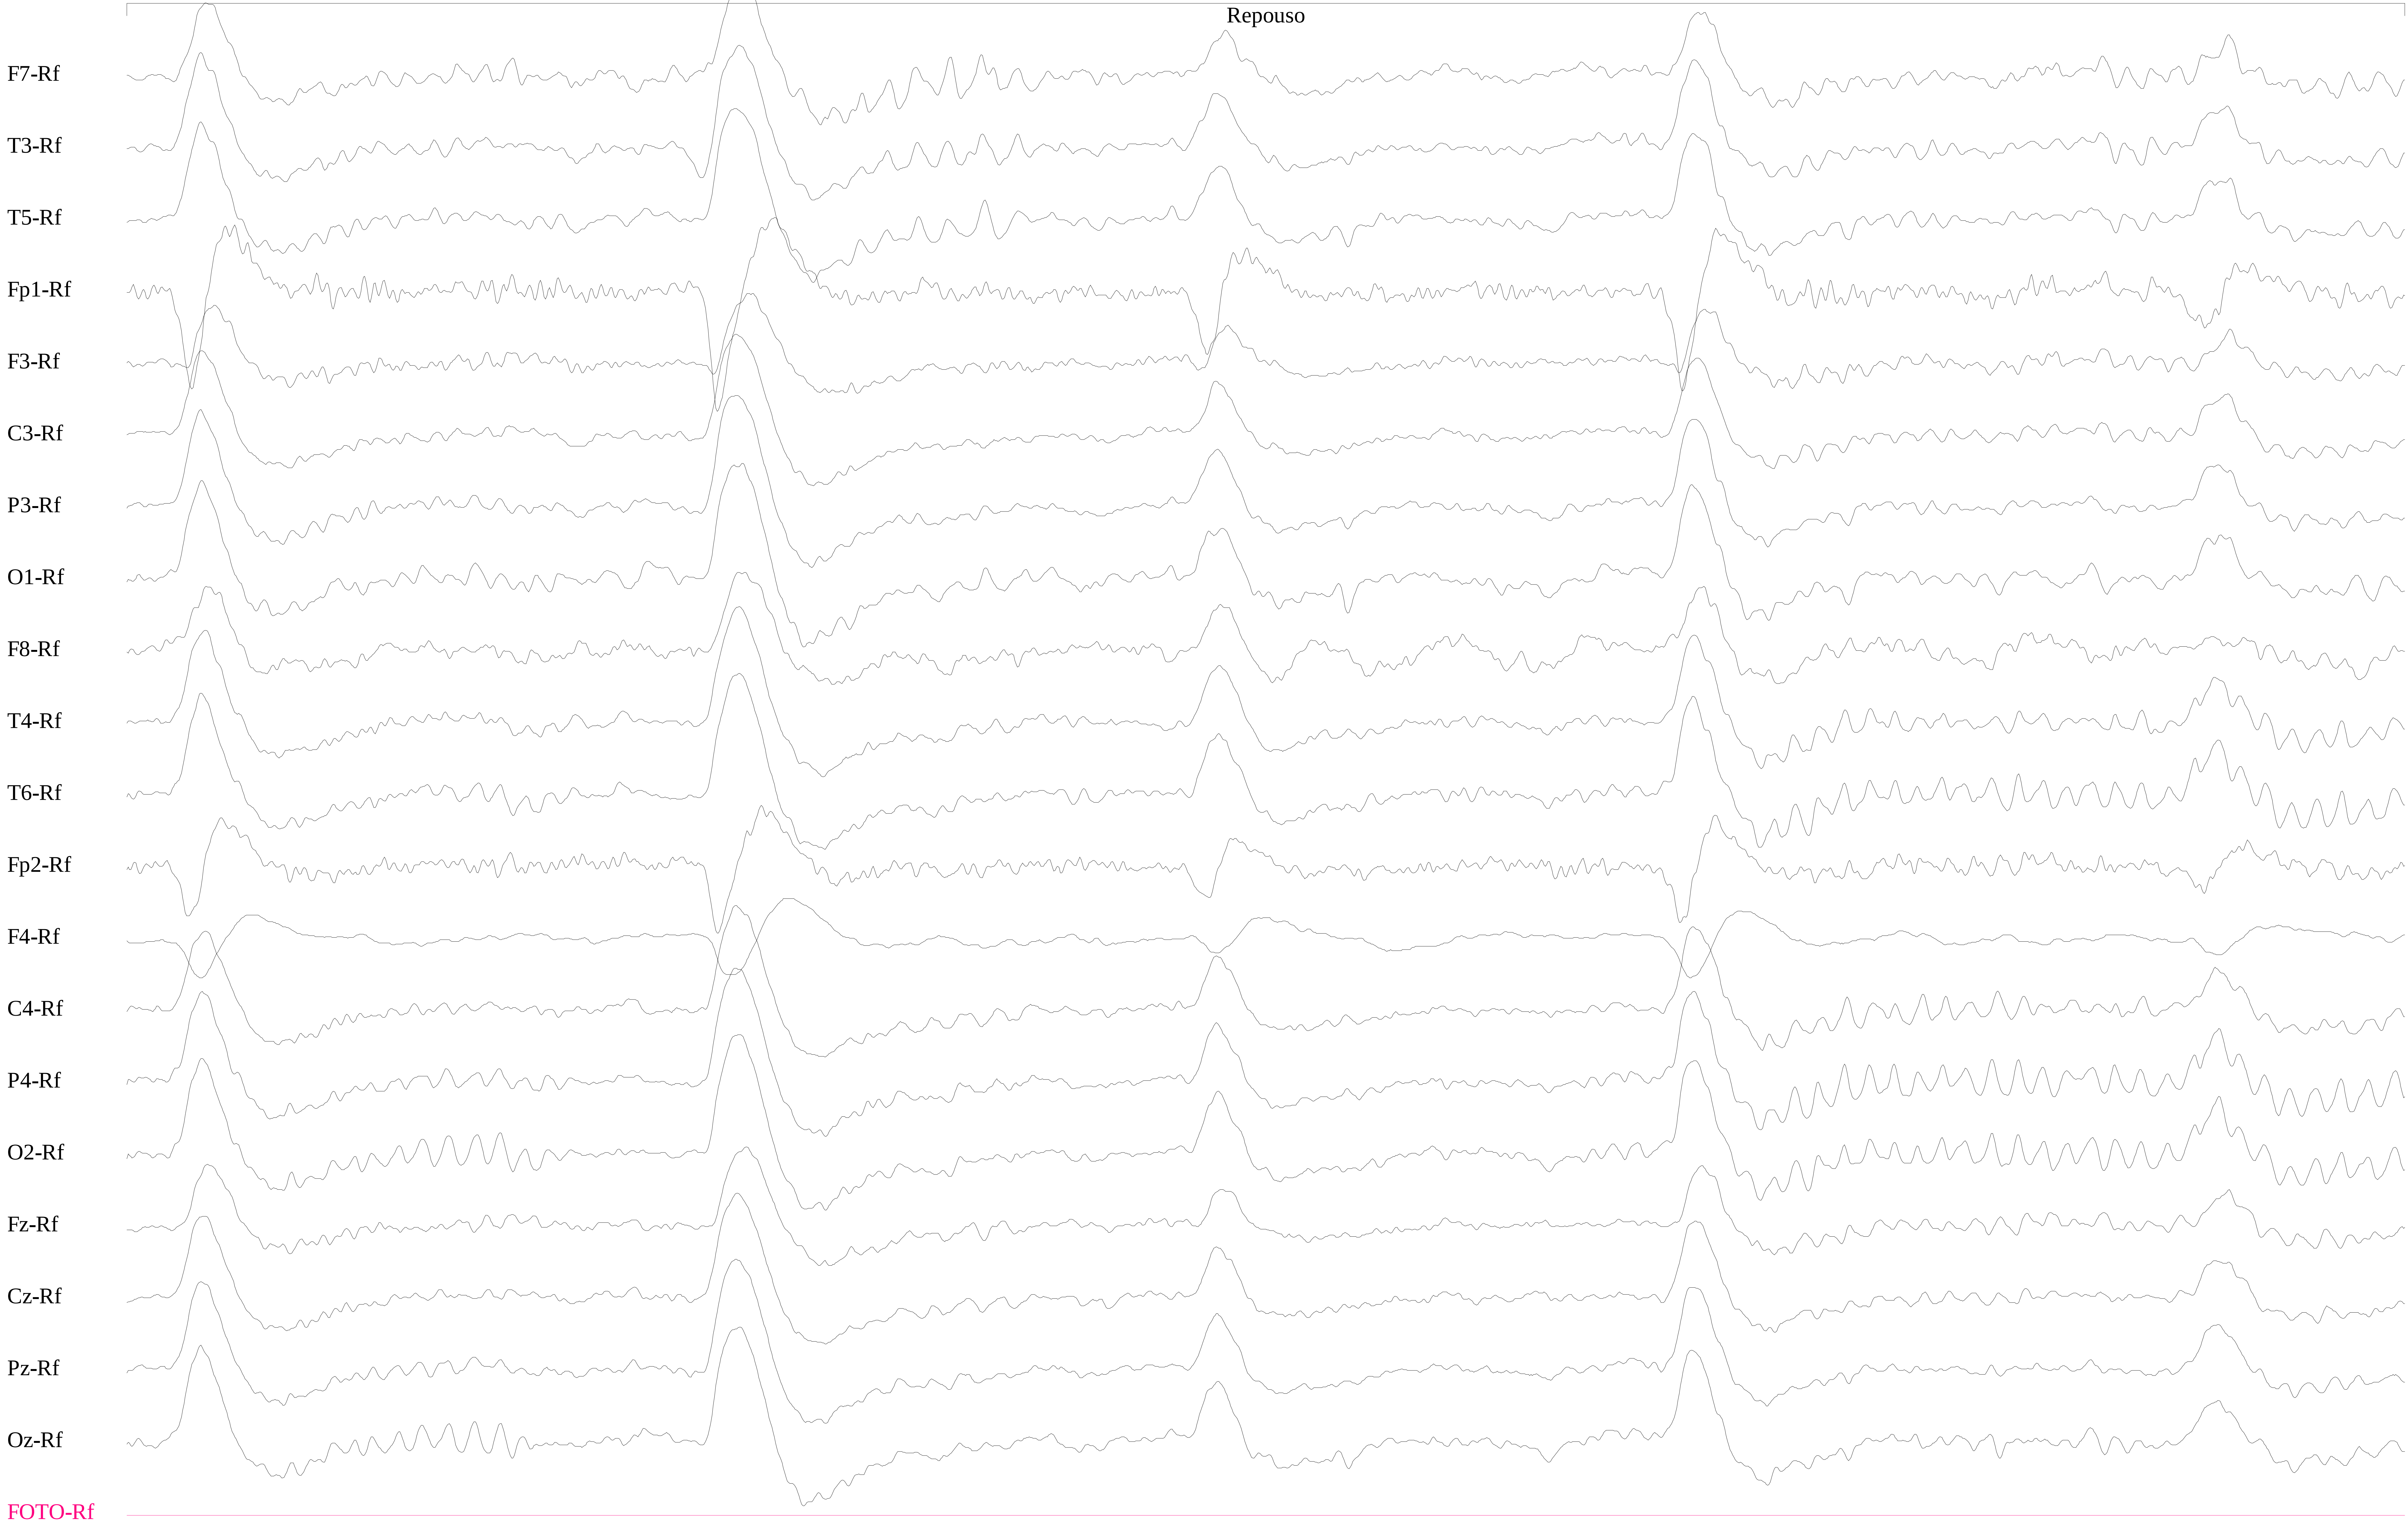
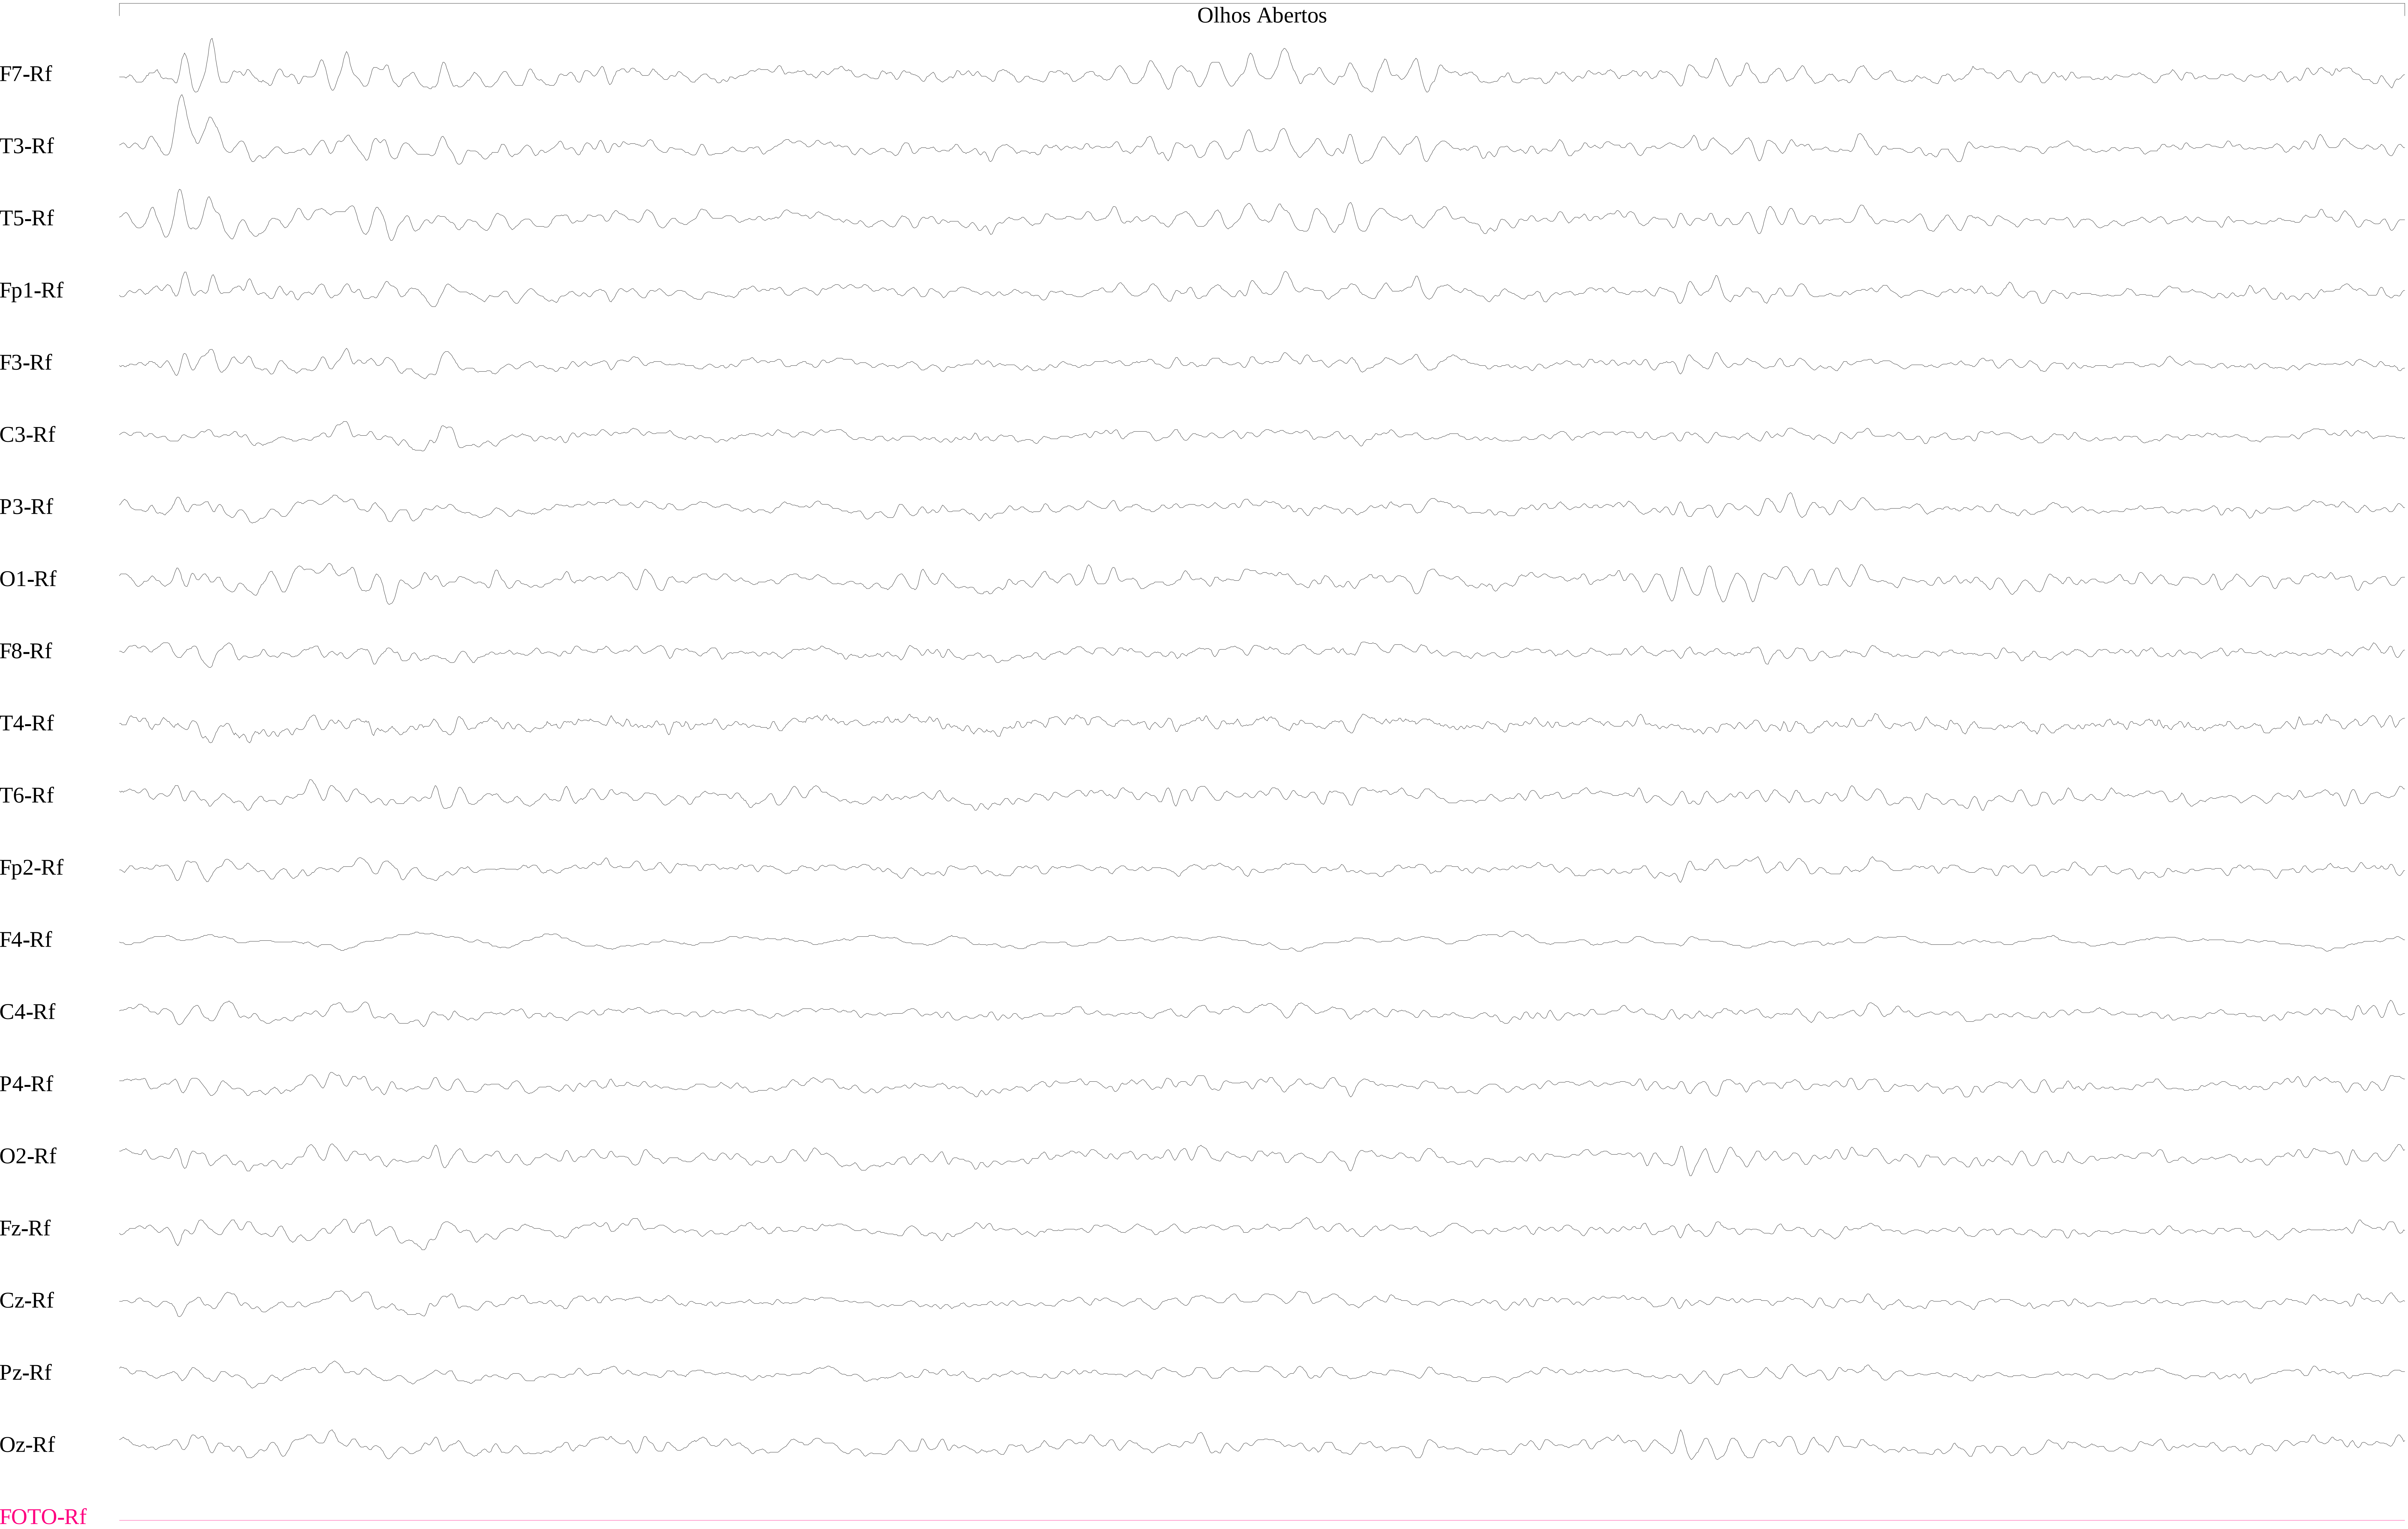


FOTO-Rf









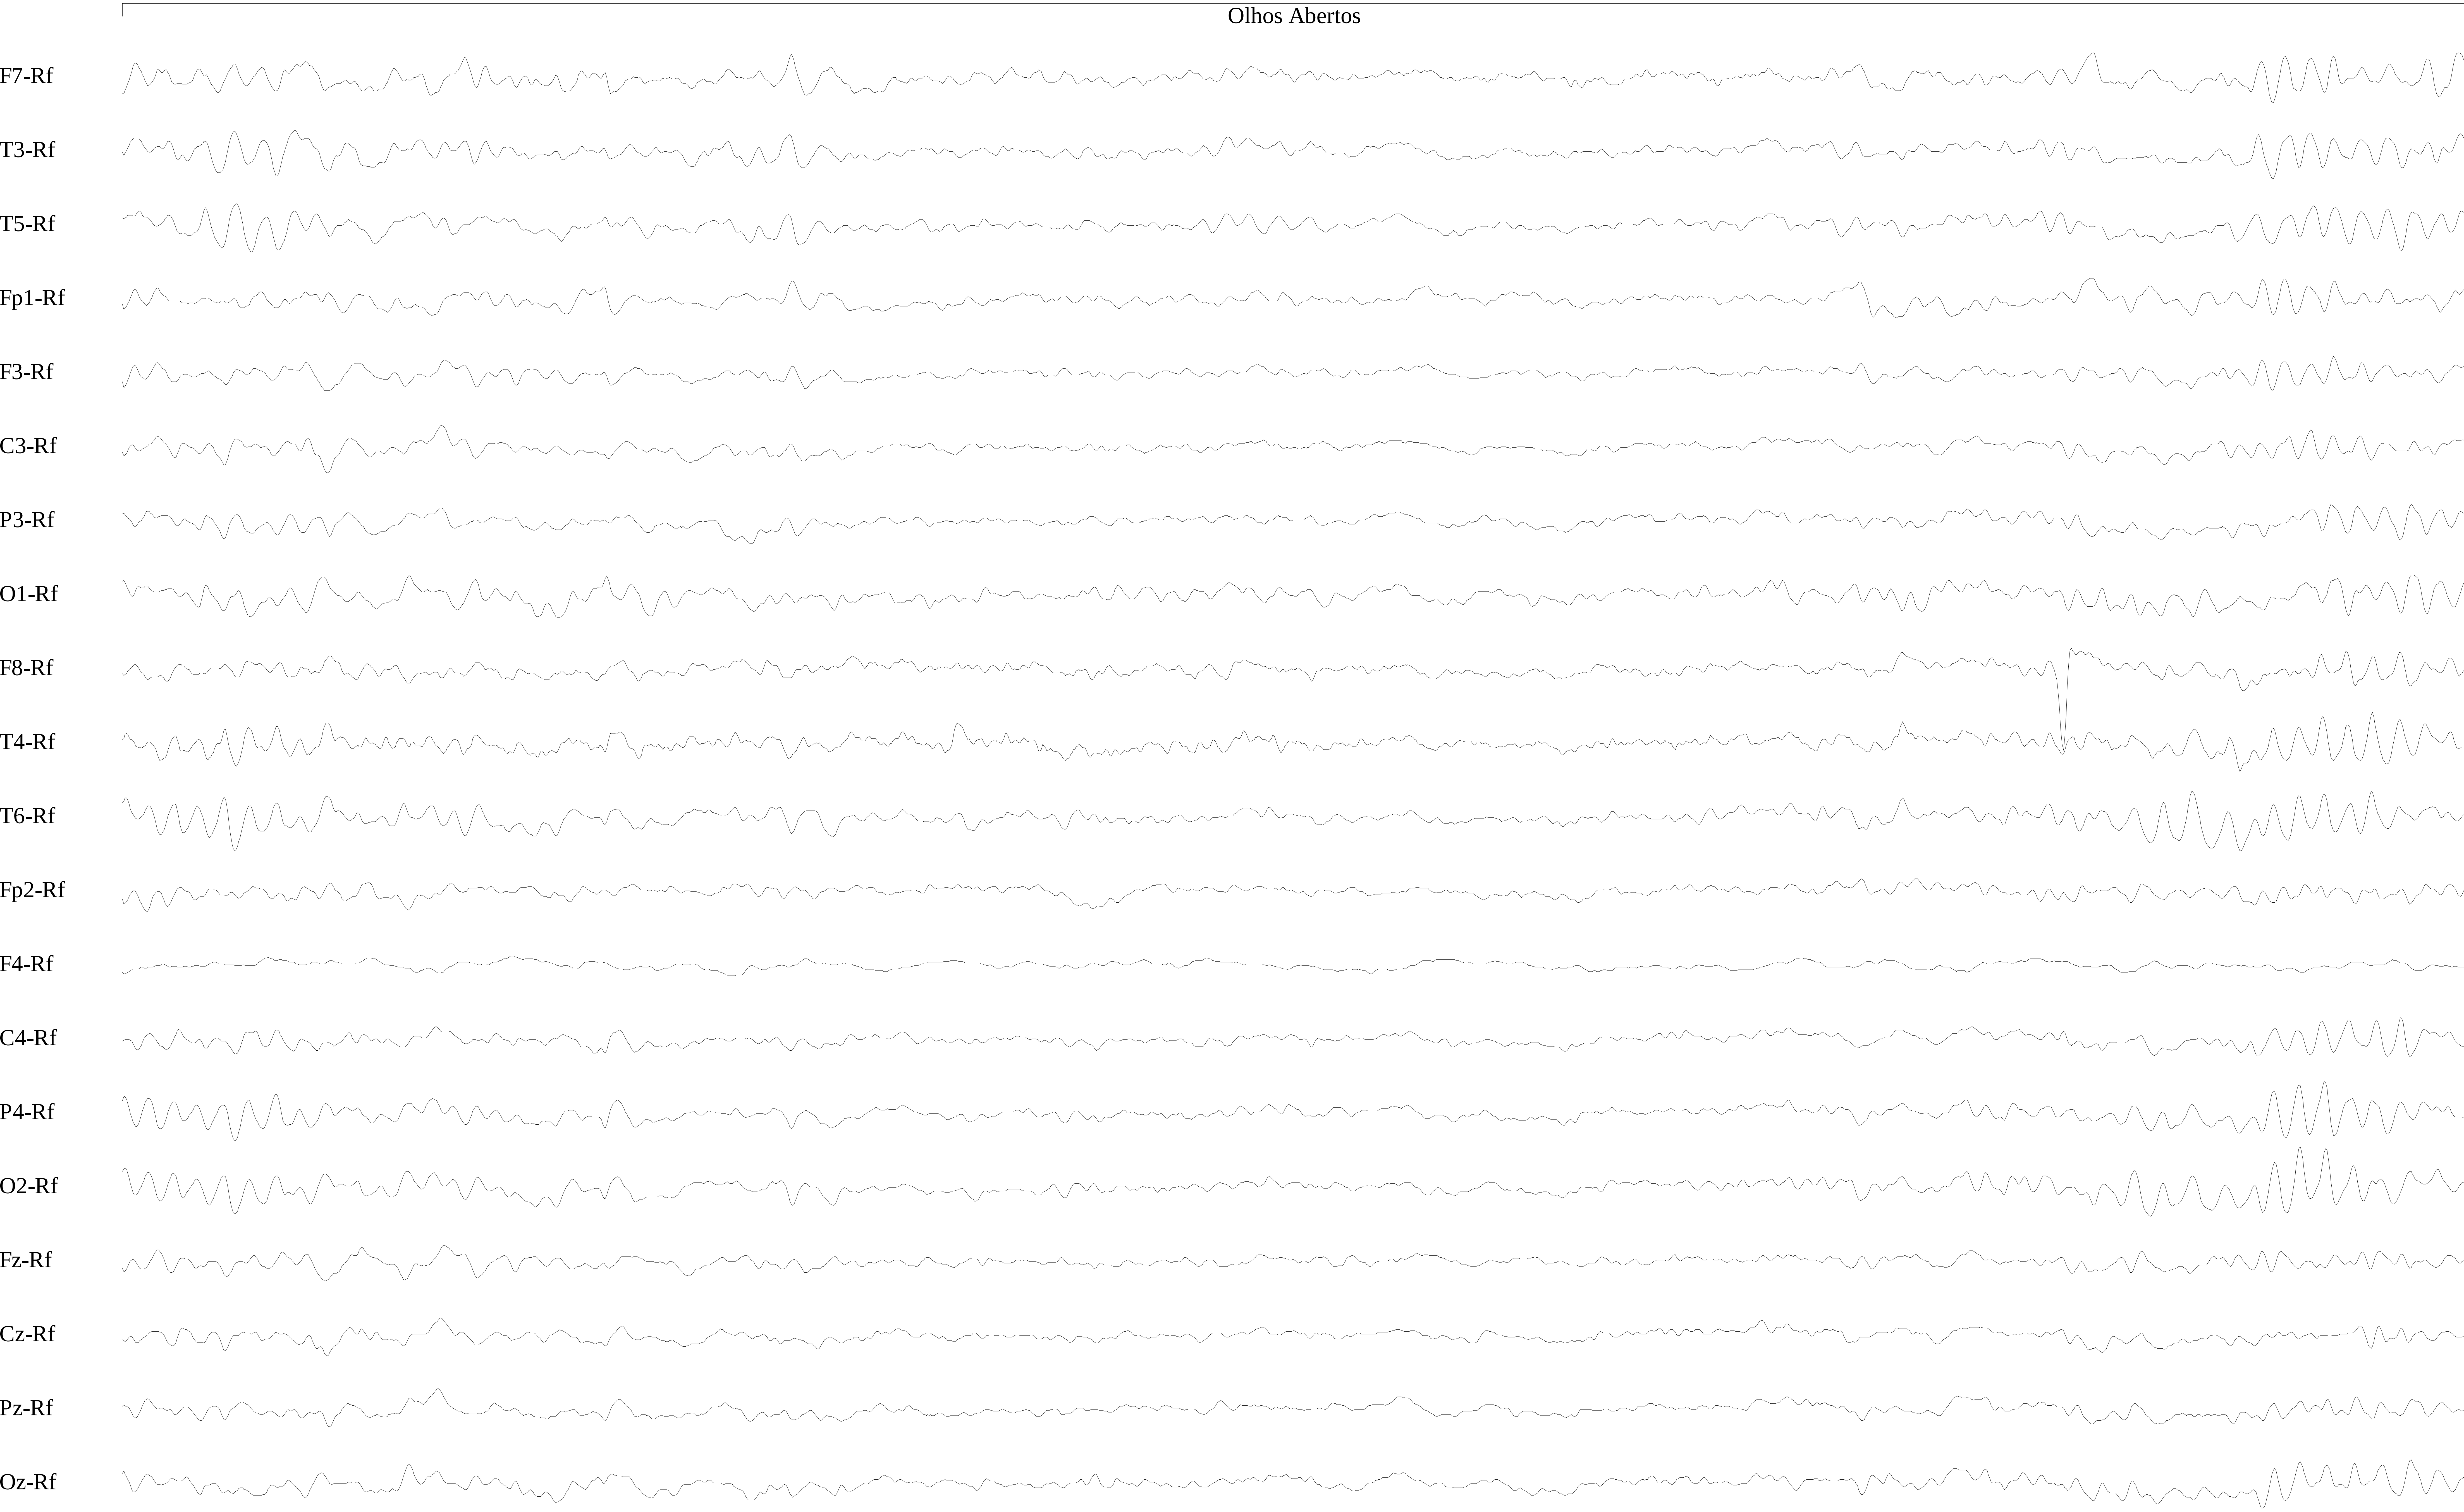


FOTO-Rf

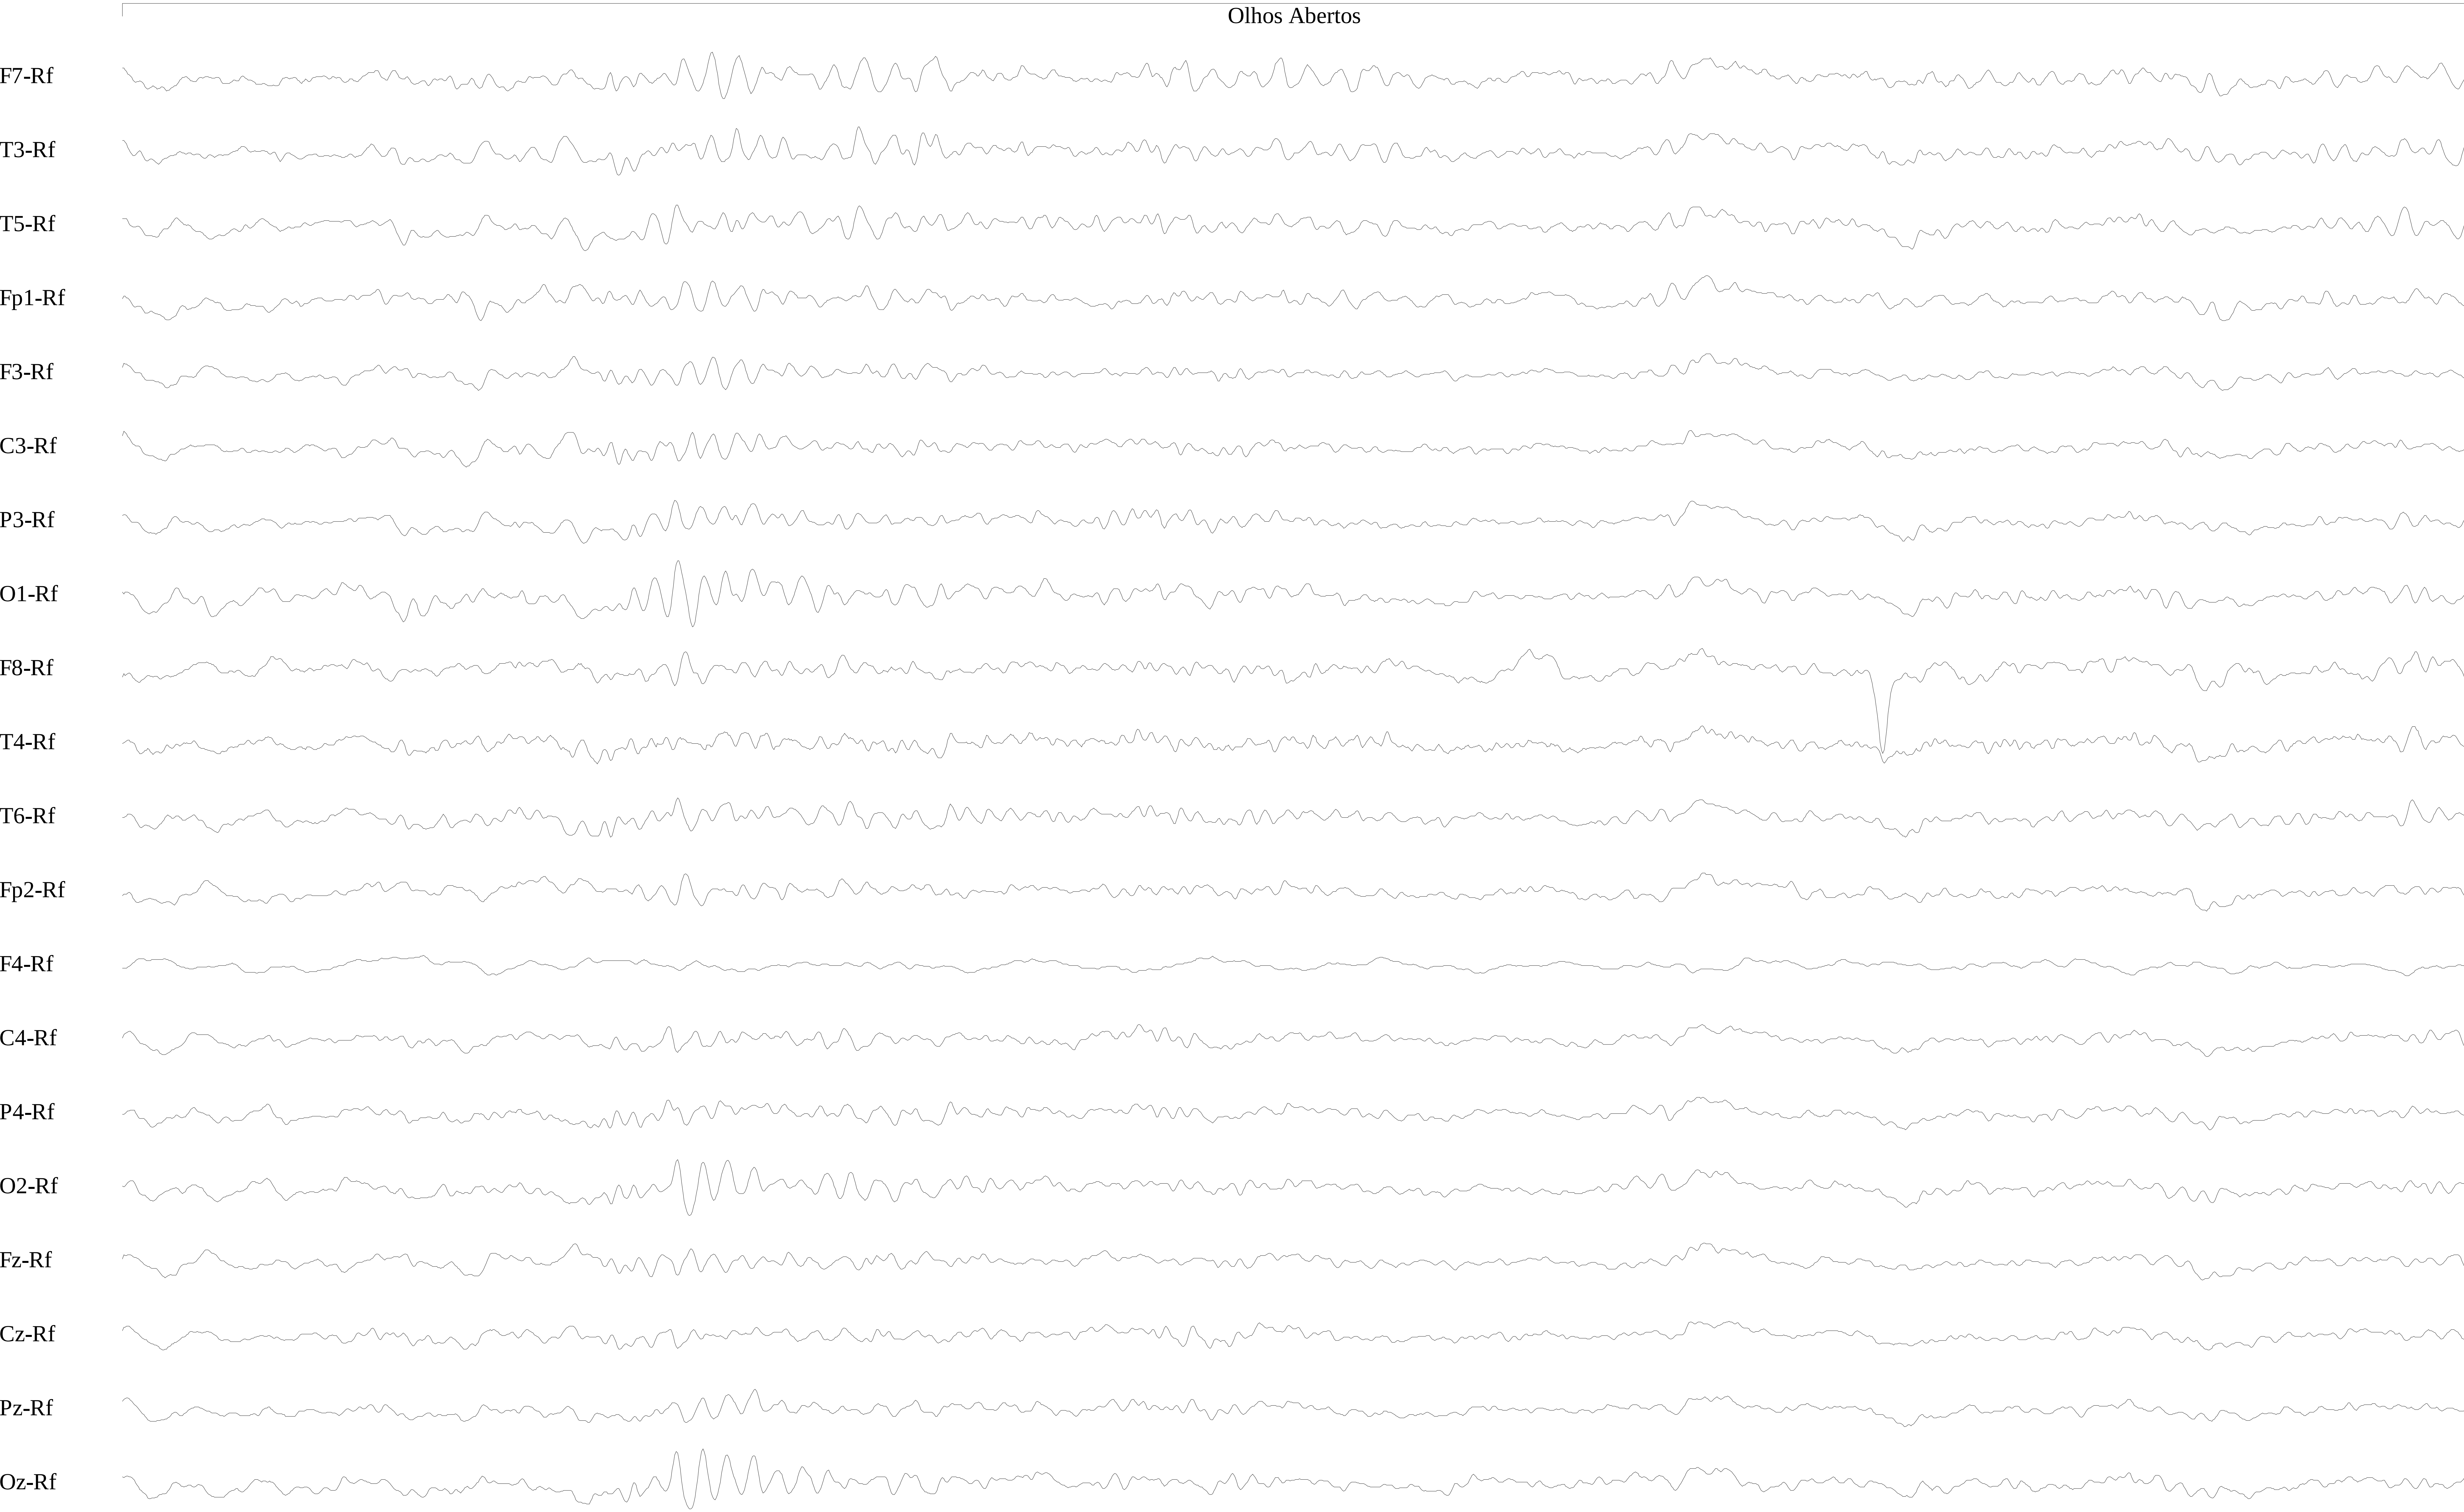


FOTO-Rf

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

100µV

00:09:03,0 CINDALVA MARIA DOS SANTOS (52 a e 11 m - F), Ex: 12279-01 (02/06/2025) 00:09:11,765

Montagem: Padrão; Velocidade : 30,00mm/s; Amplitude - EEG: 100,00µV/cm

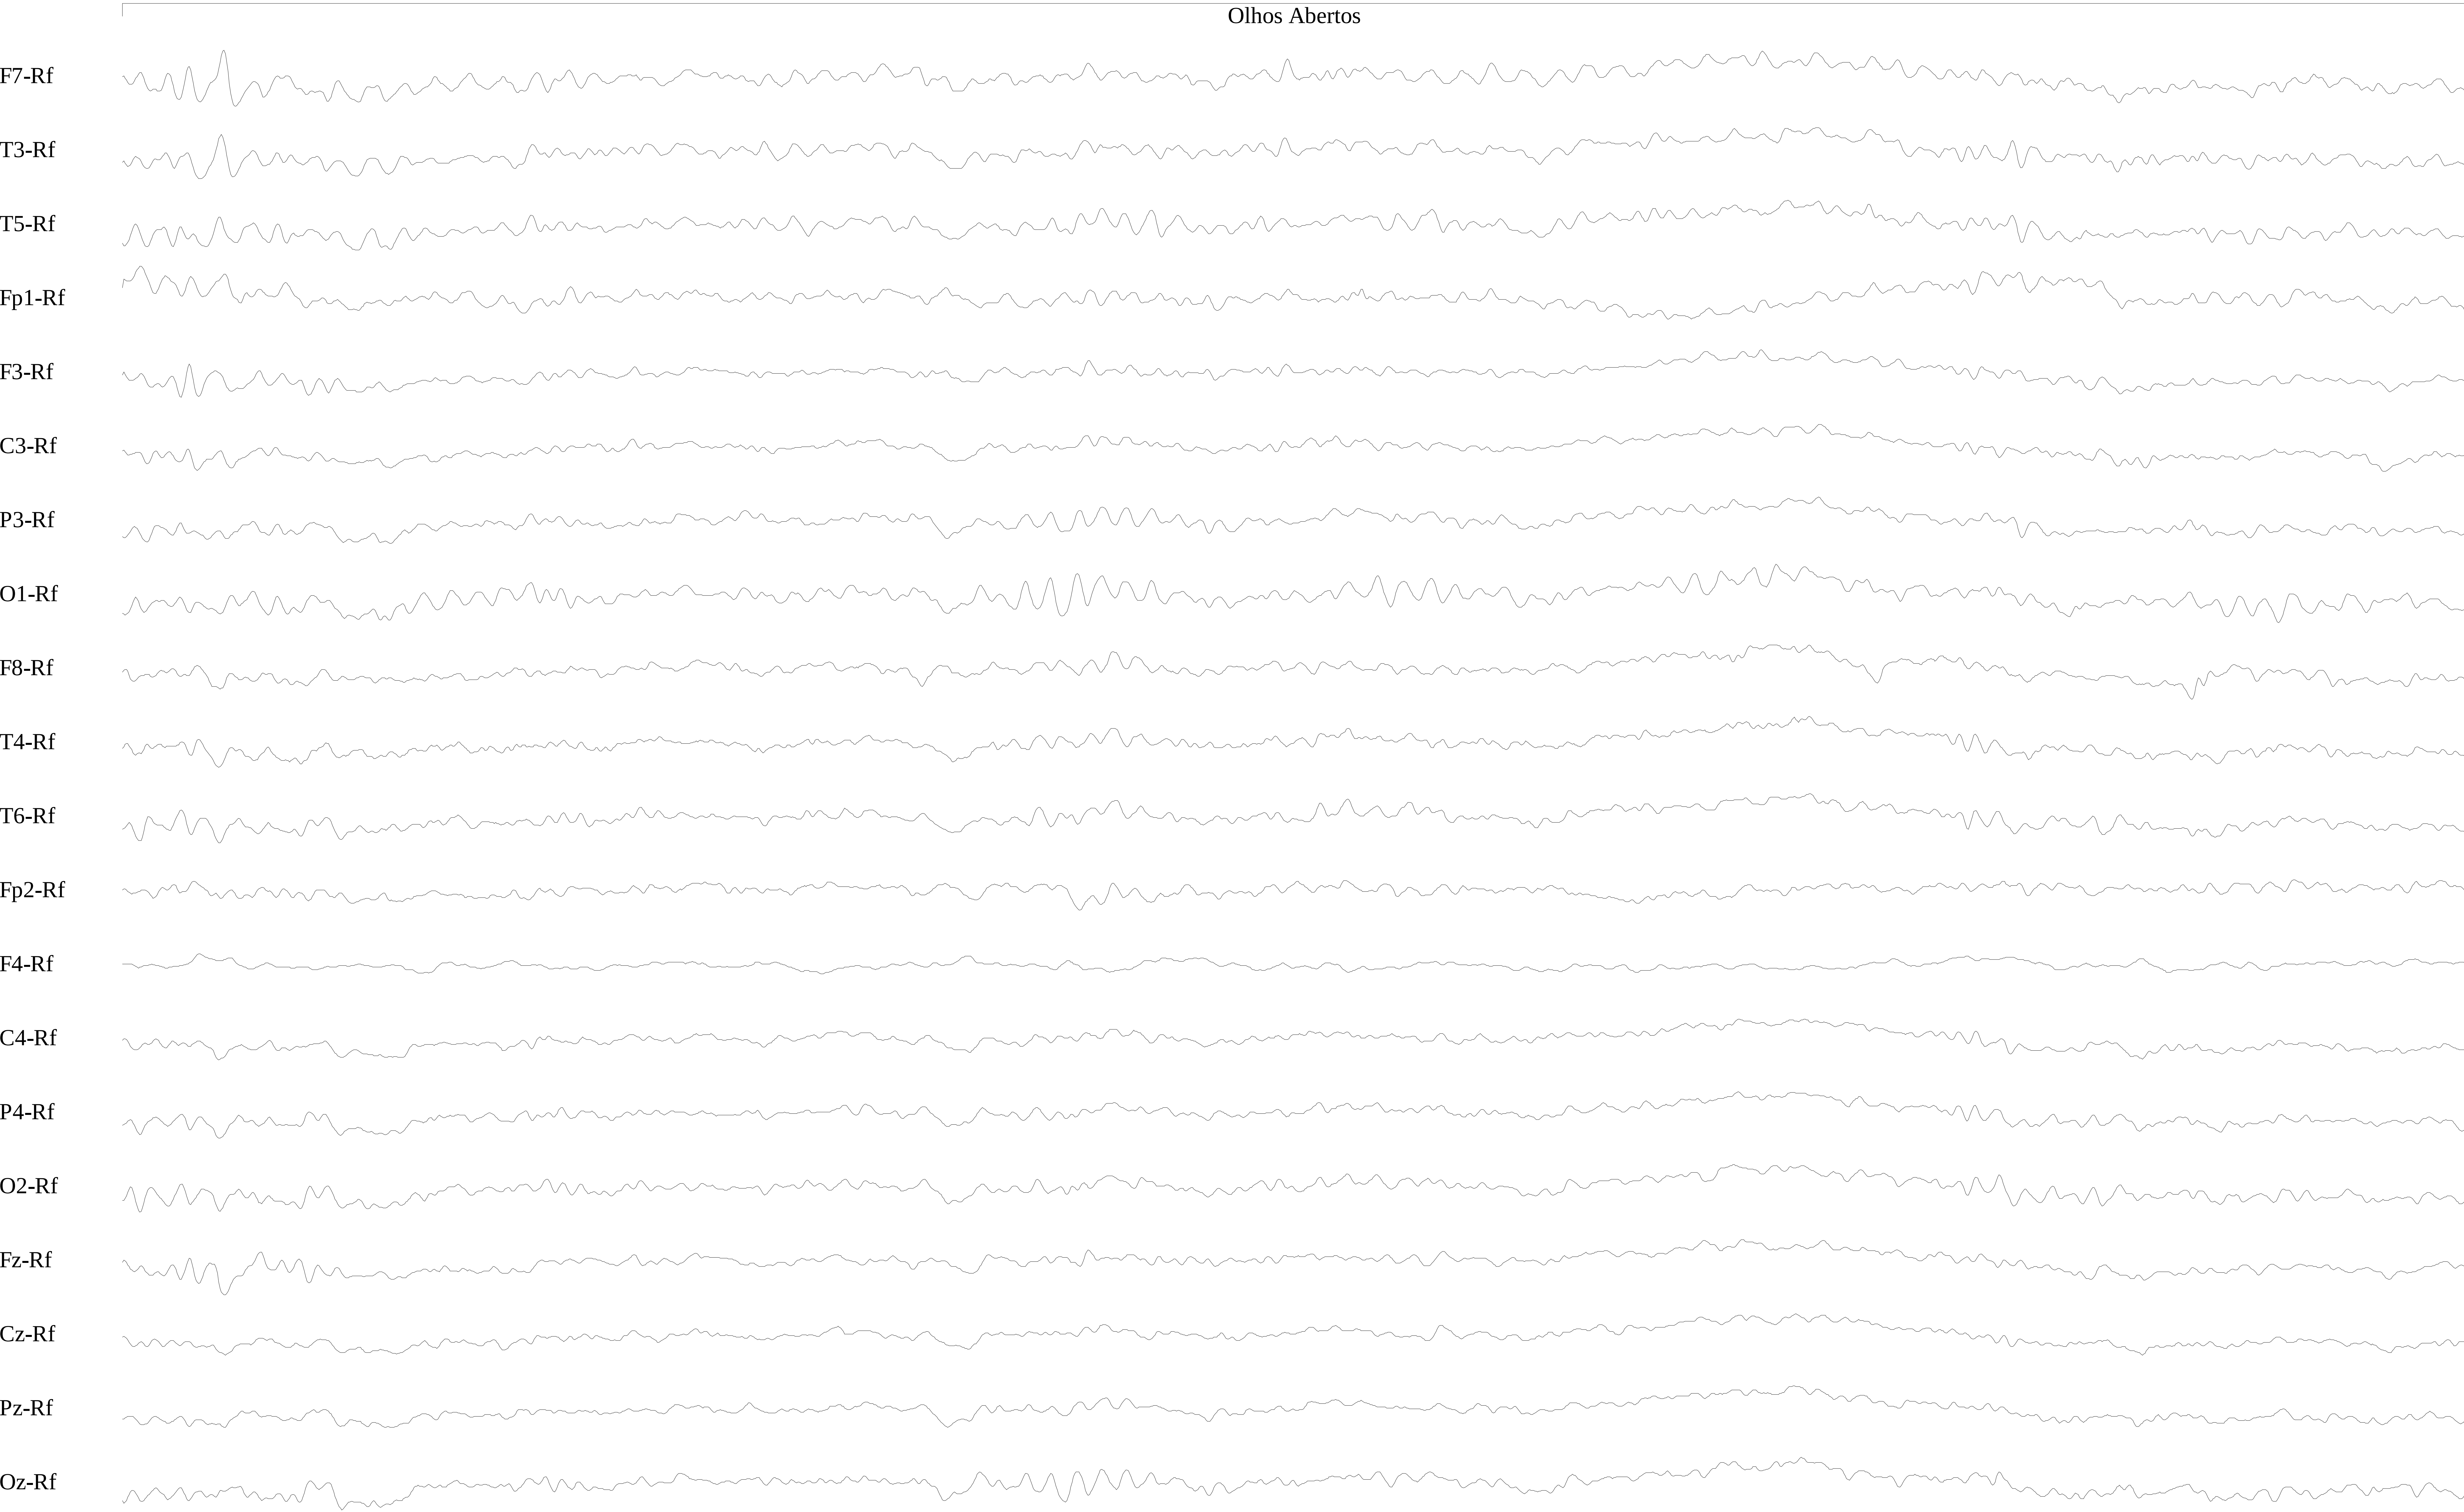


FOTO-Rf

[Aqui vai o nome do Medico/Clinica]

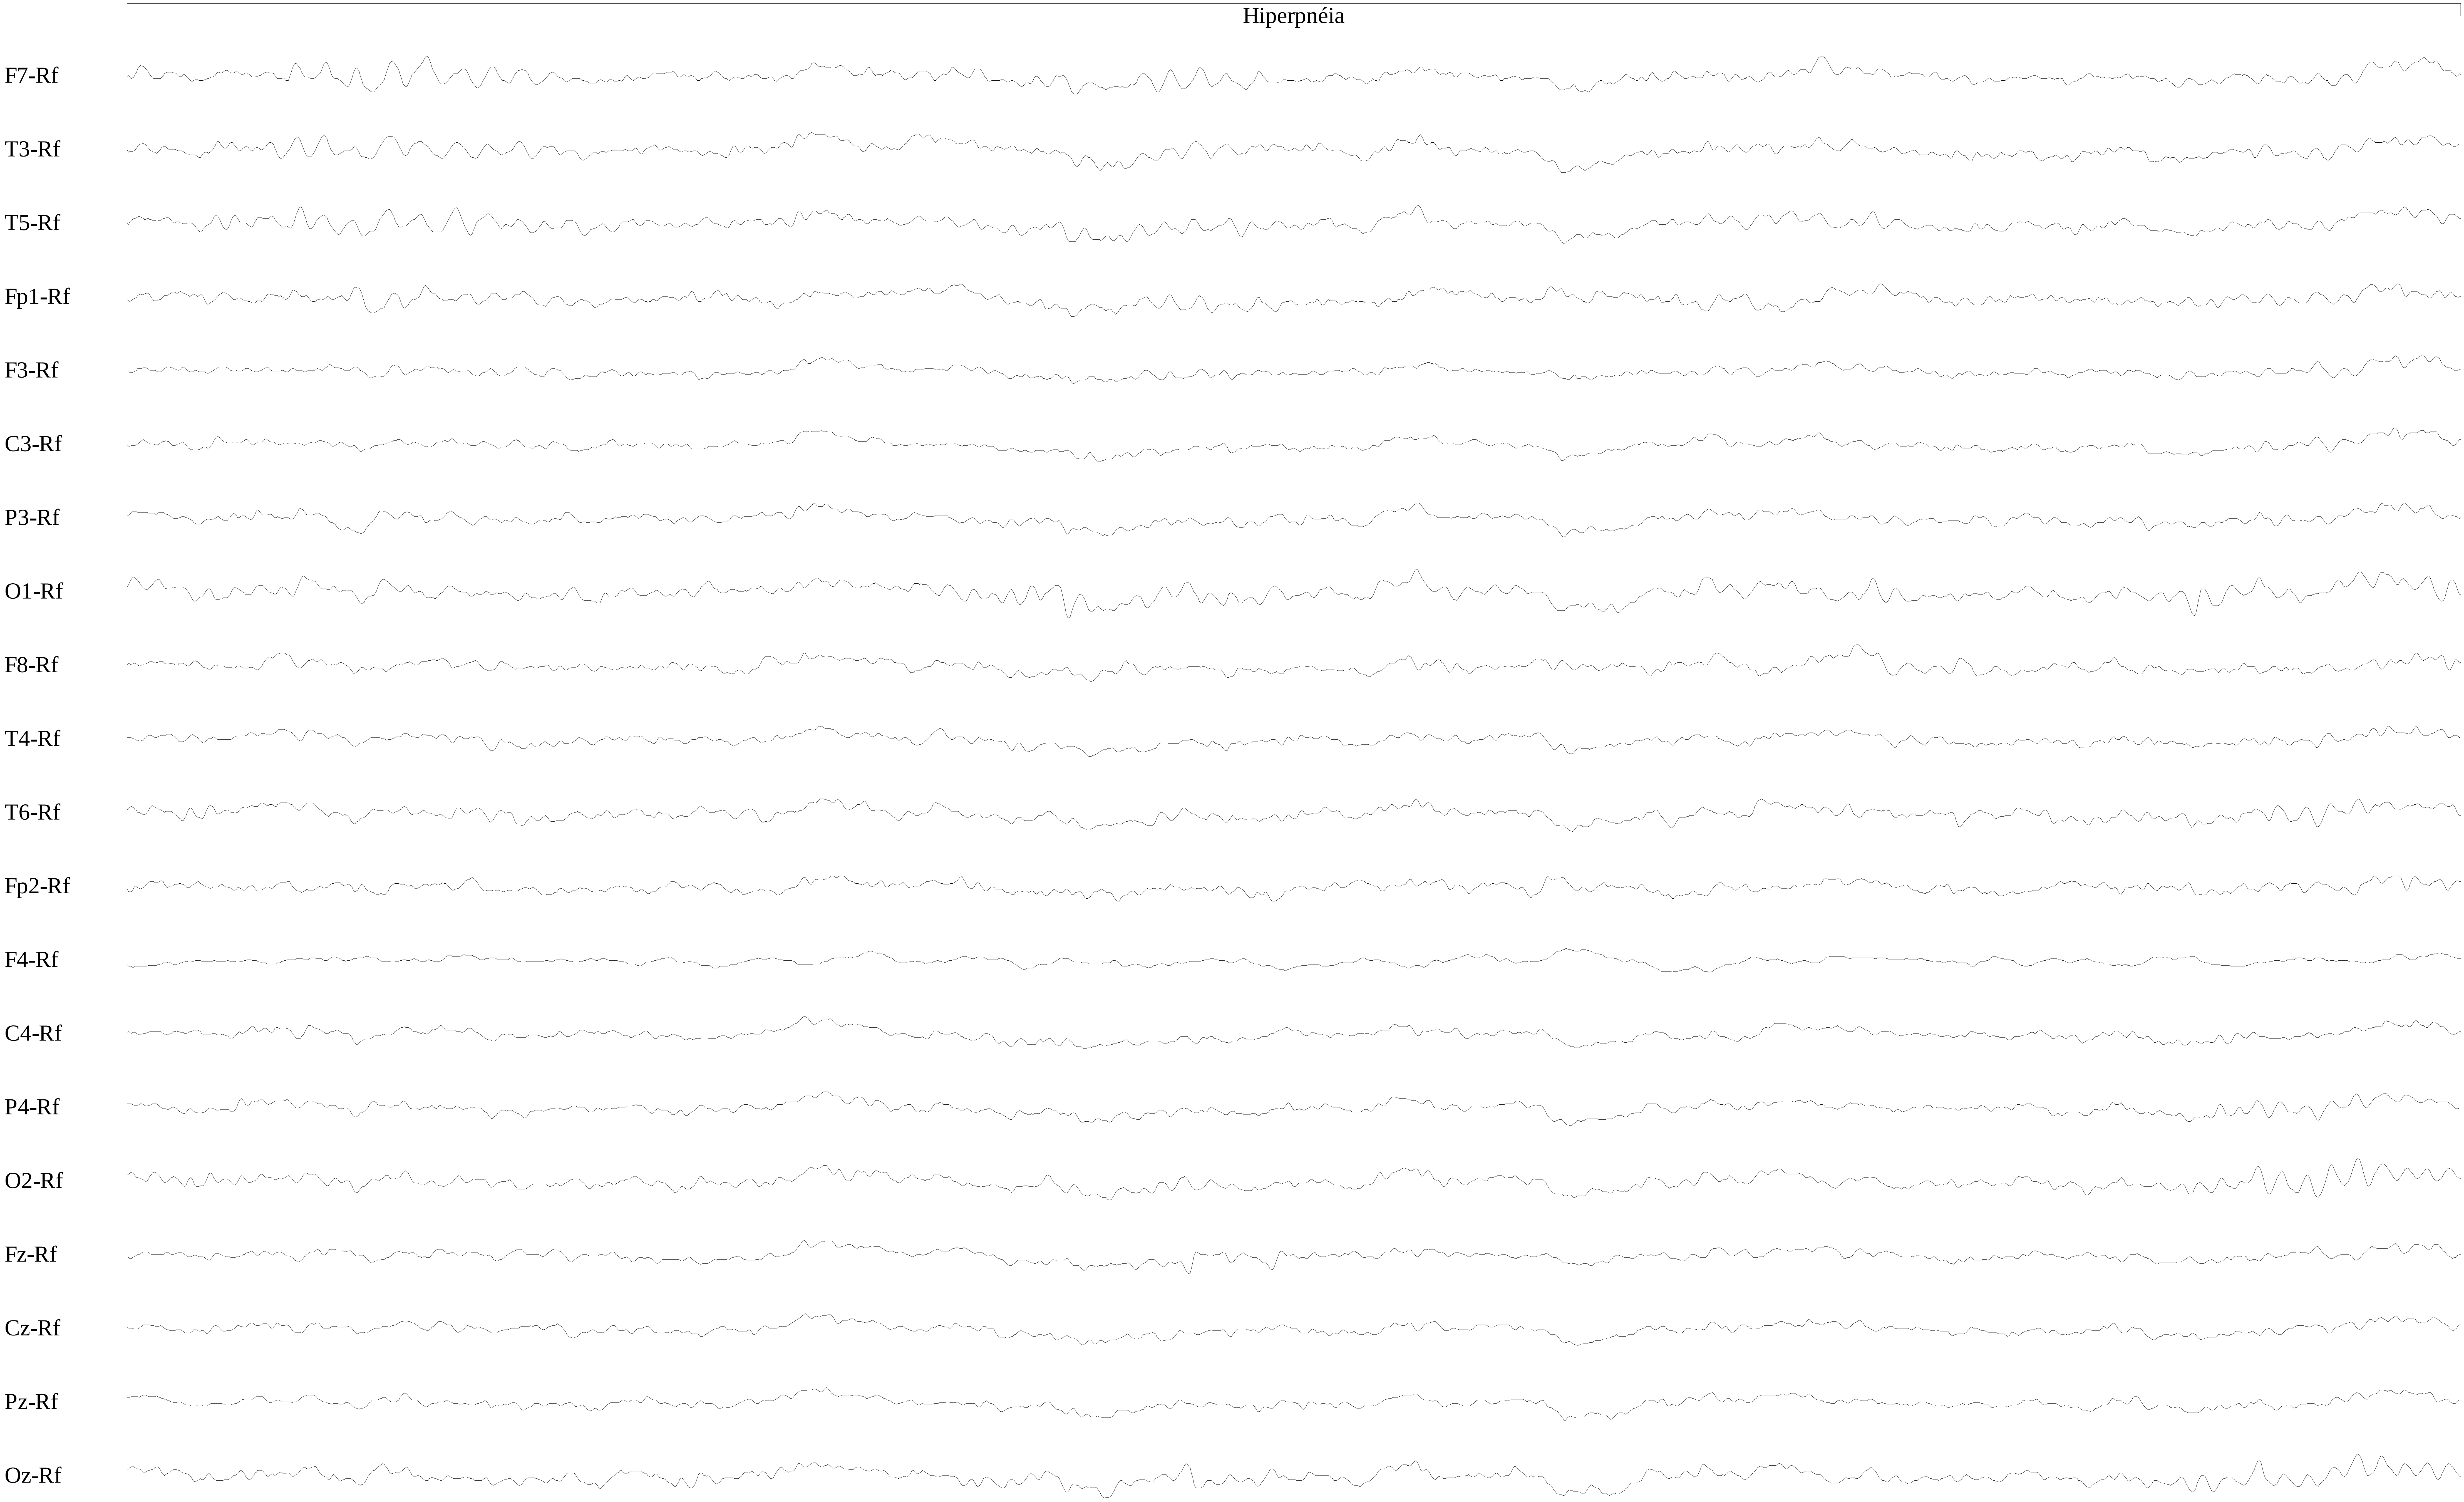
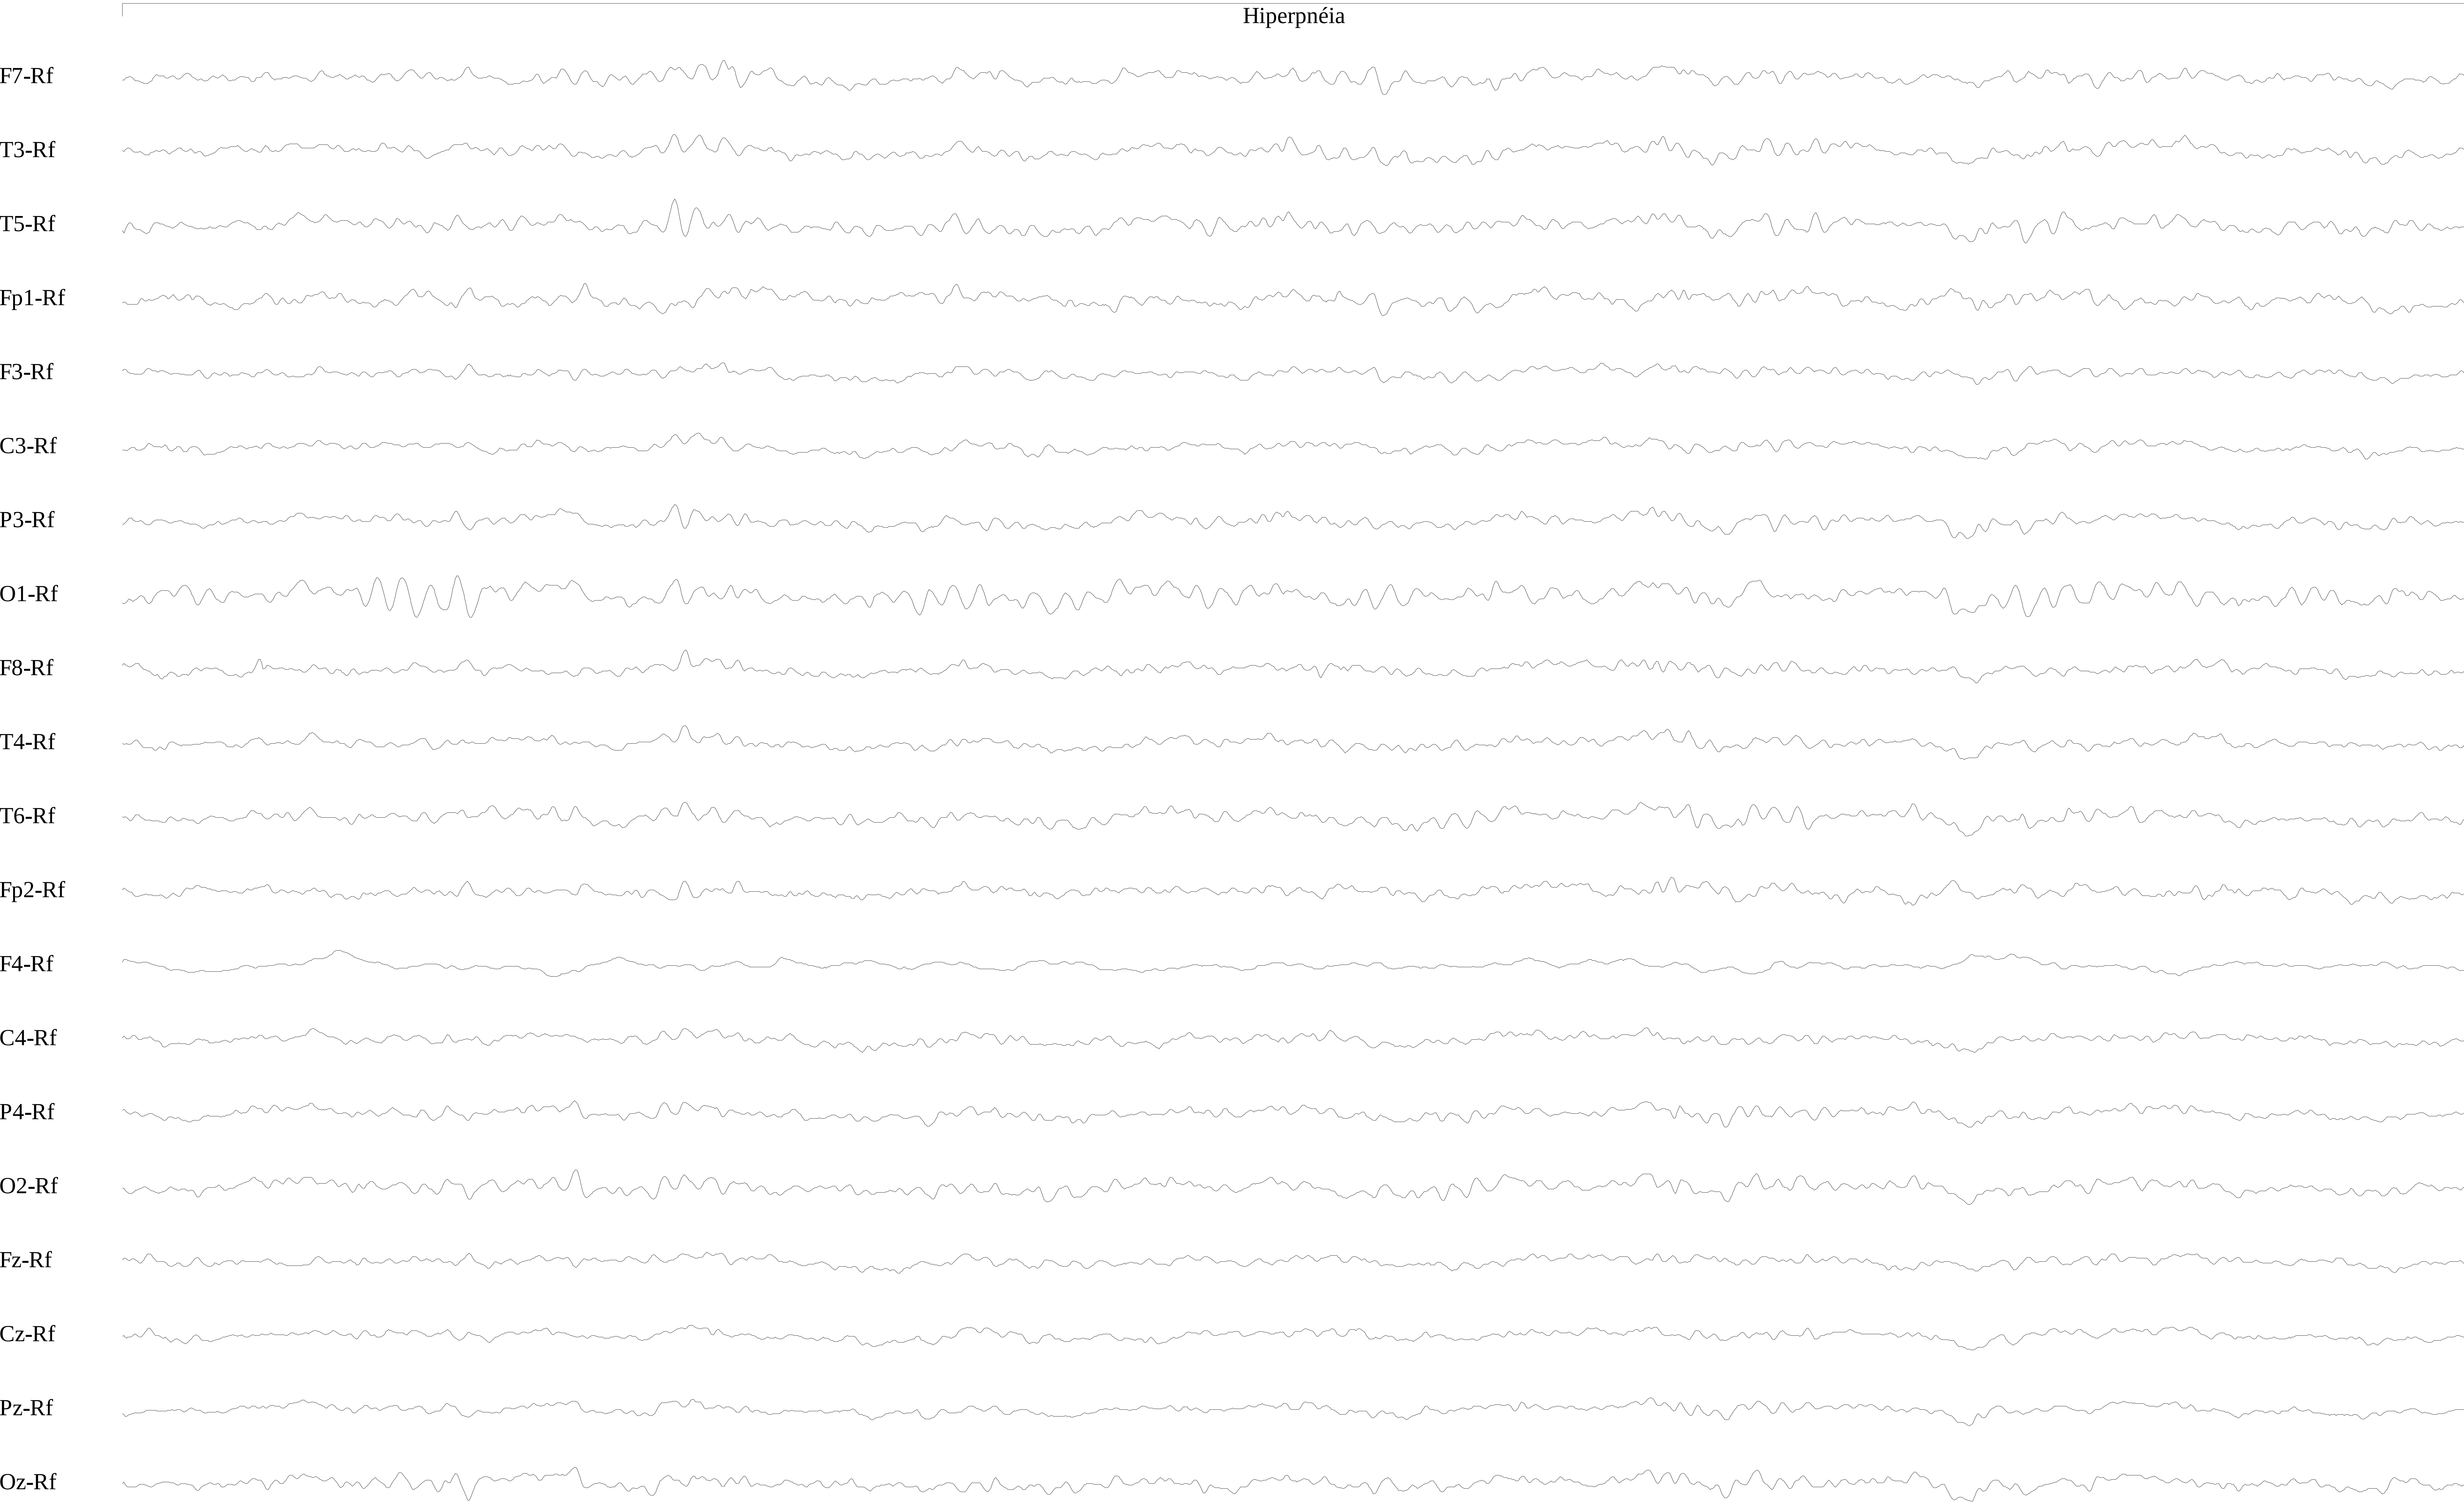
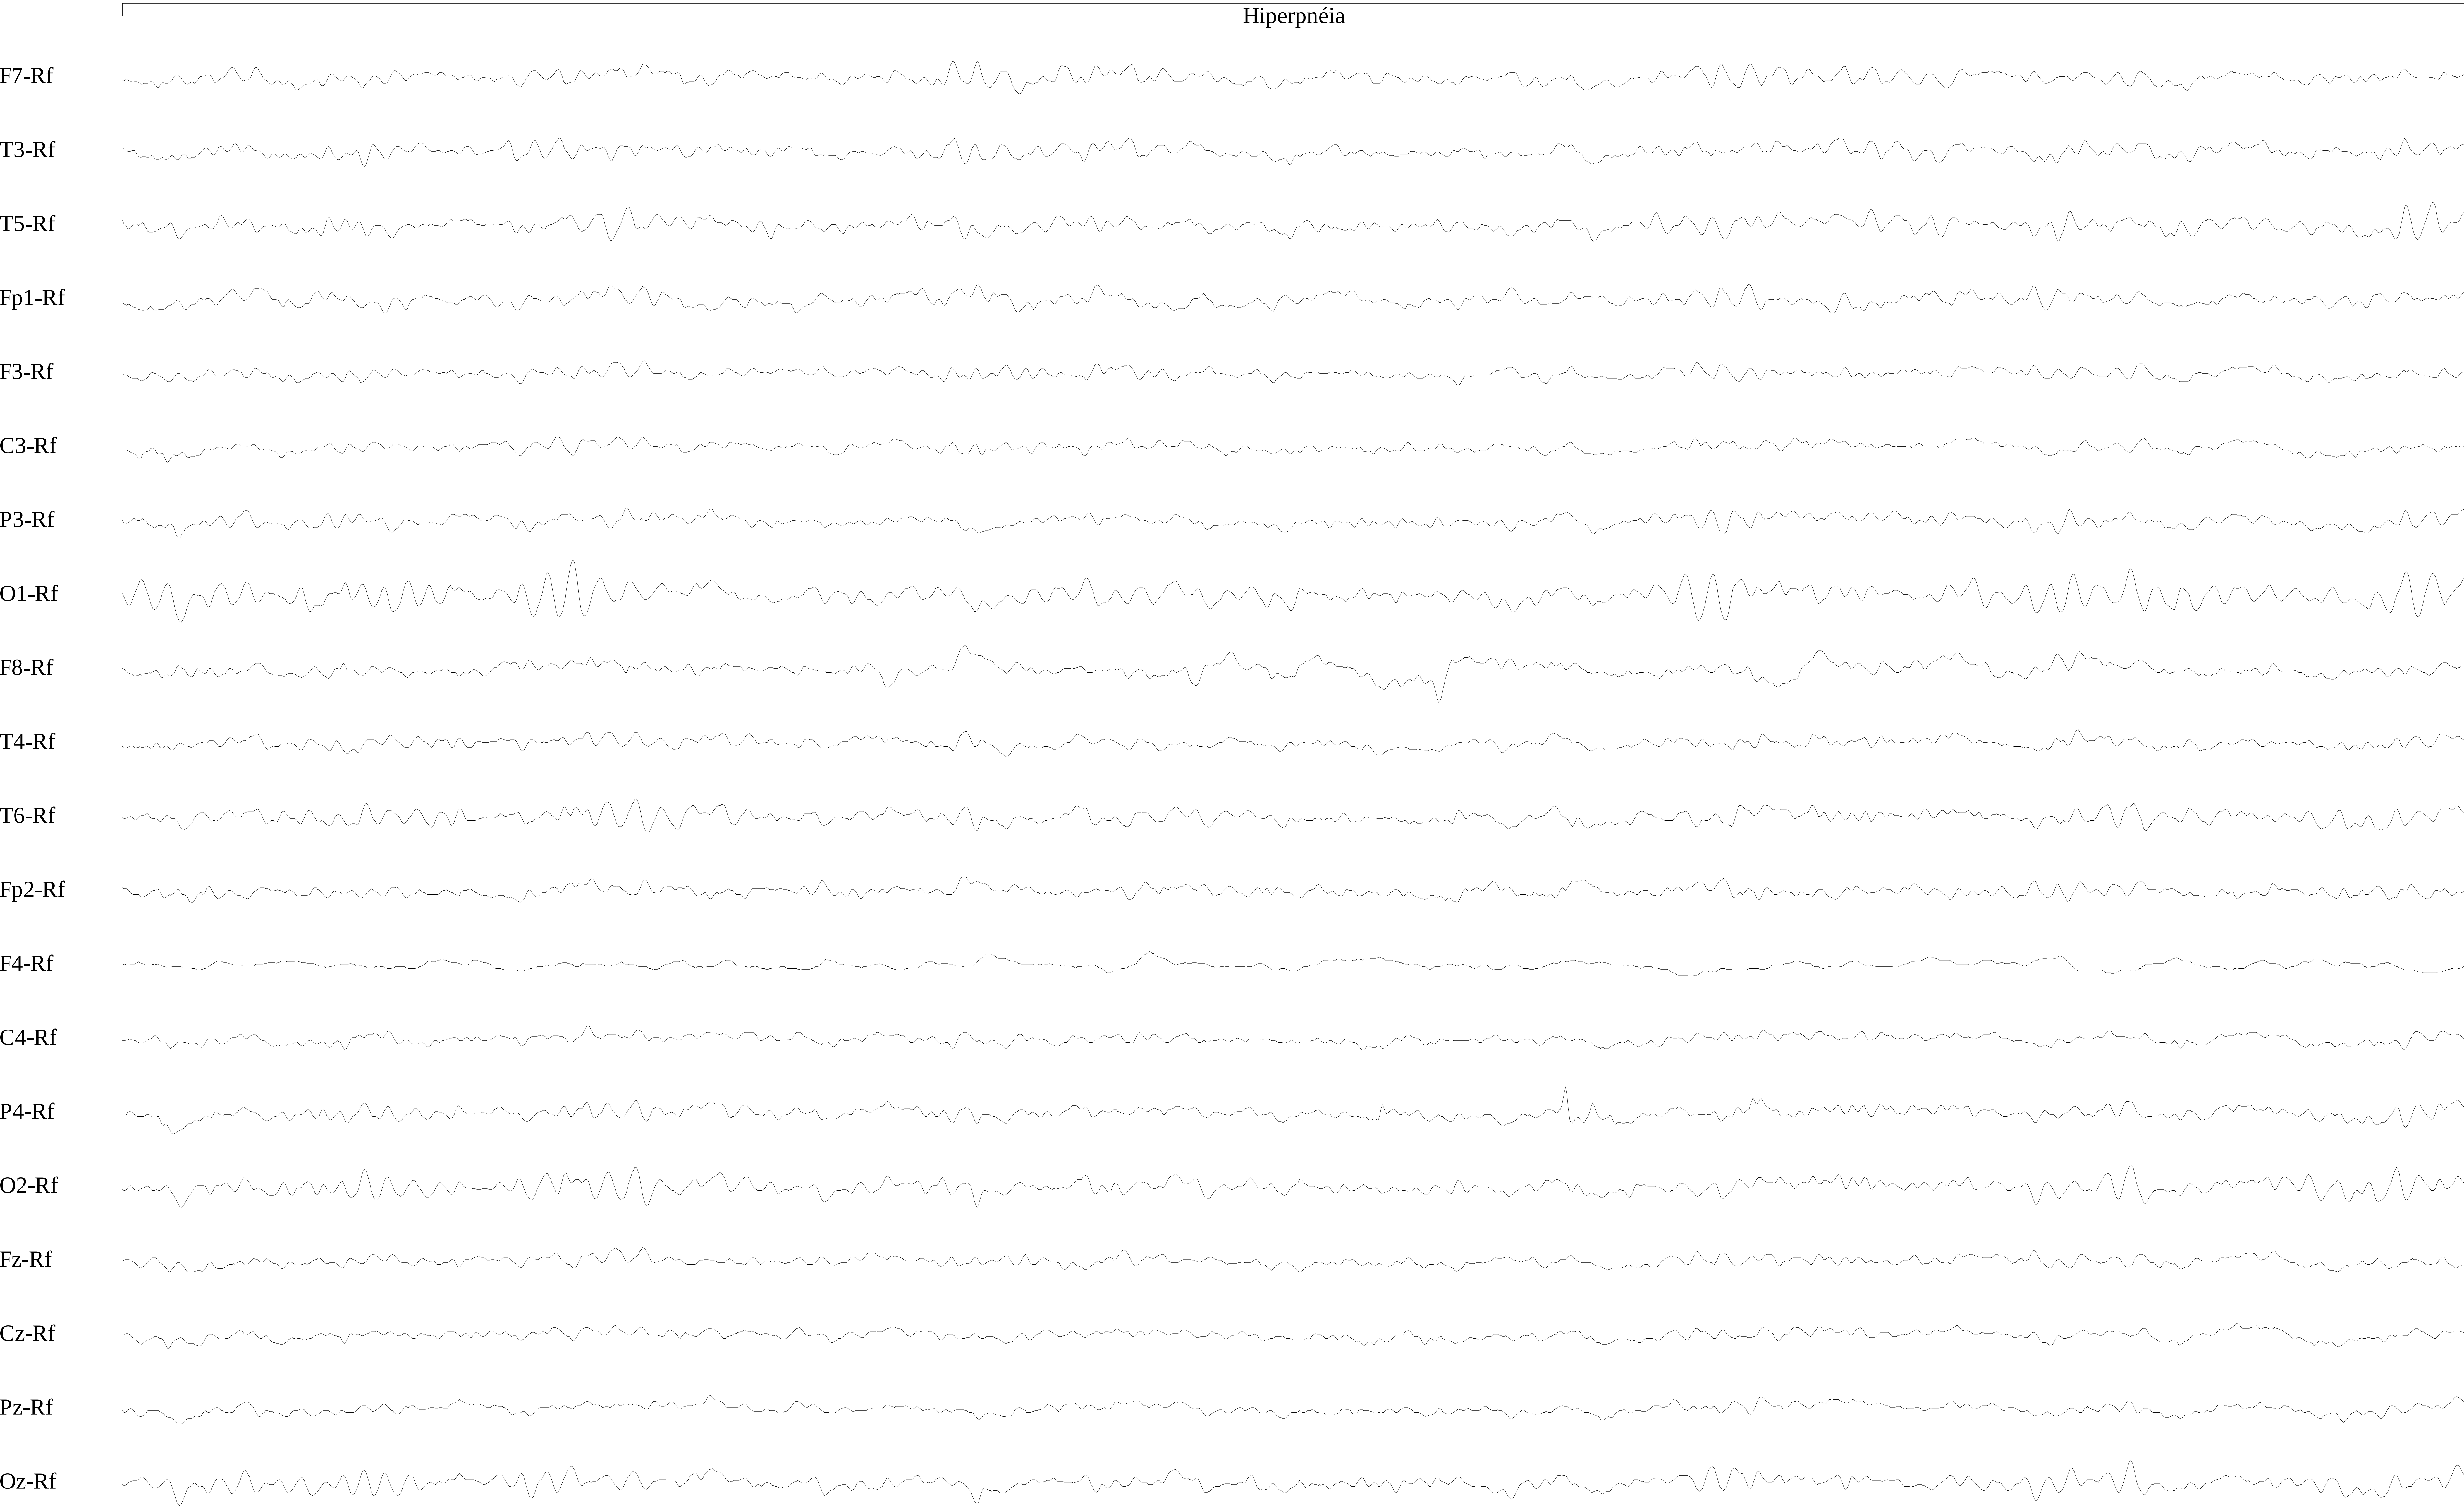


FOTO-Rf





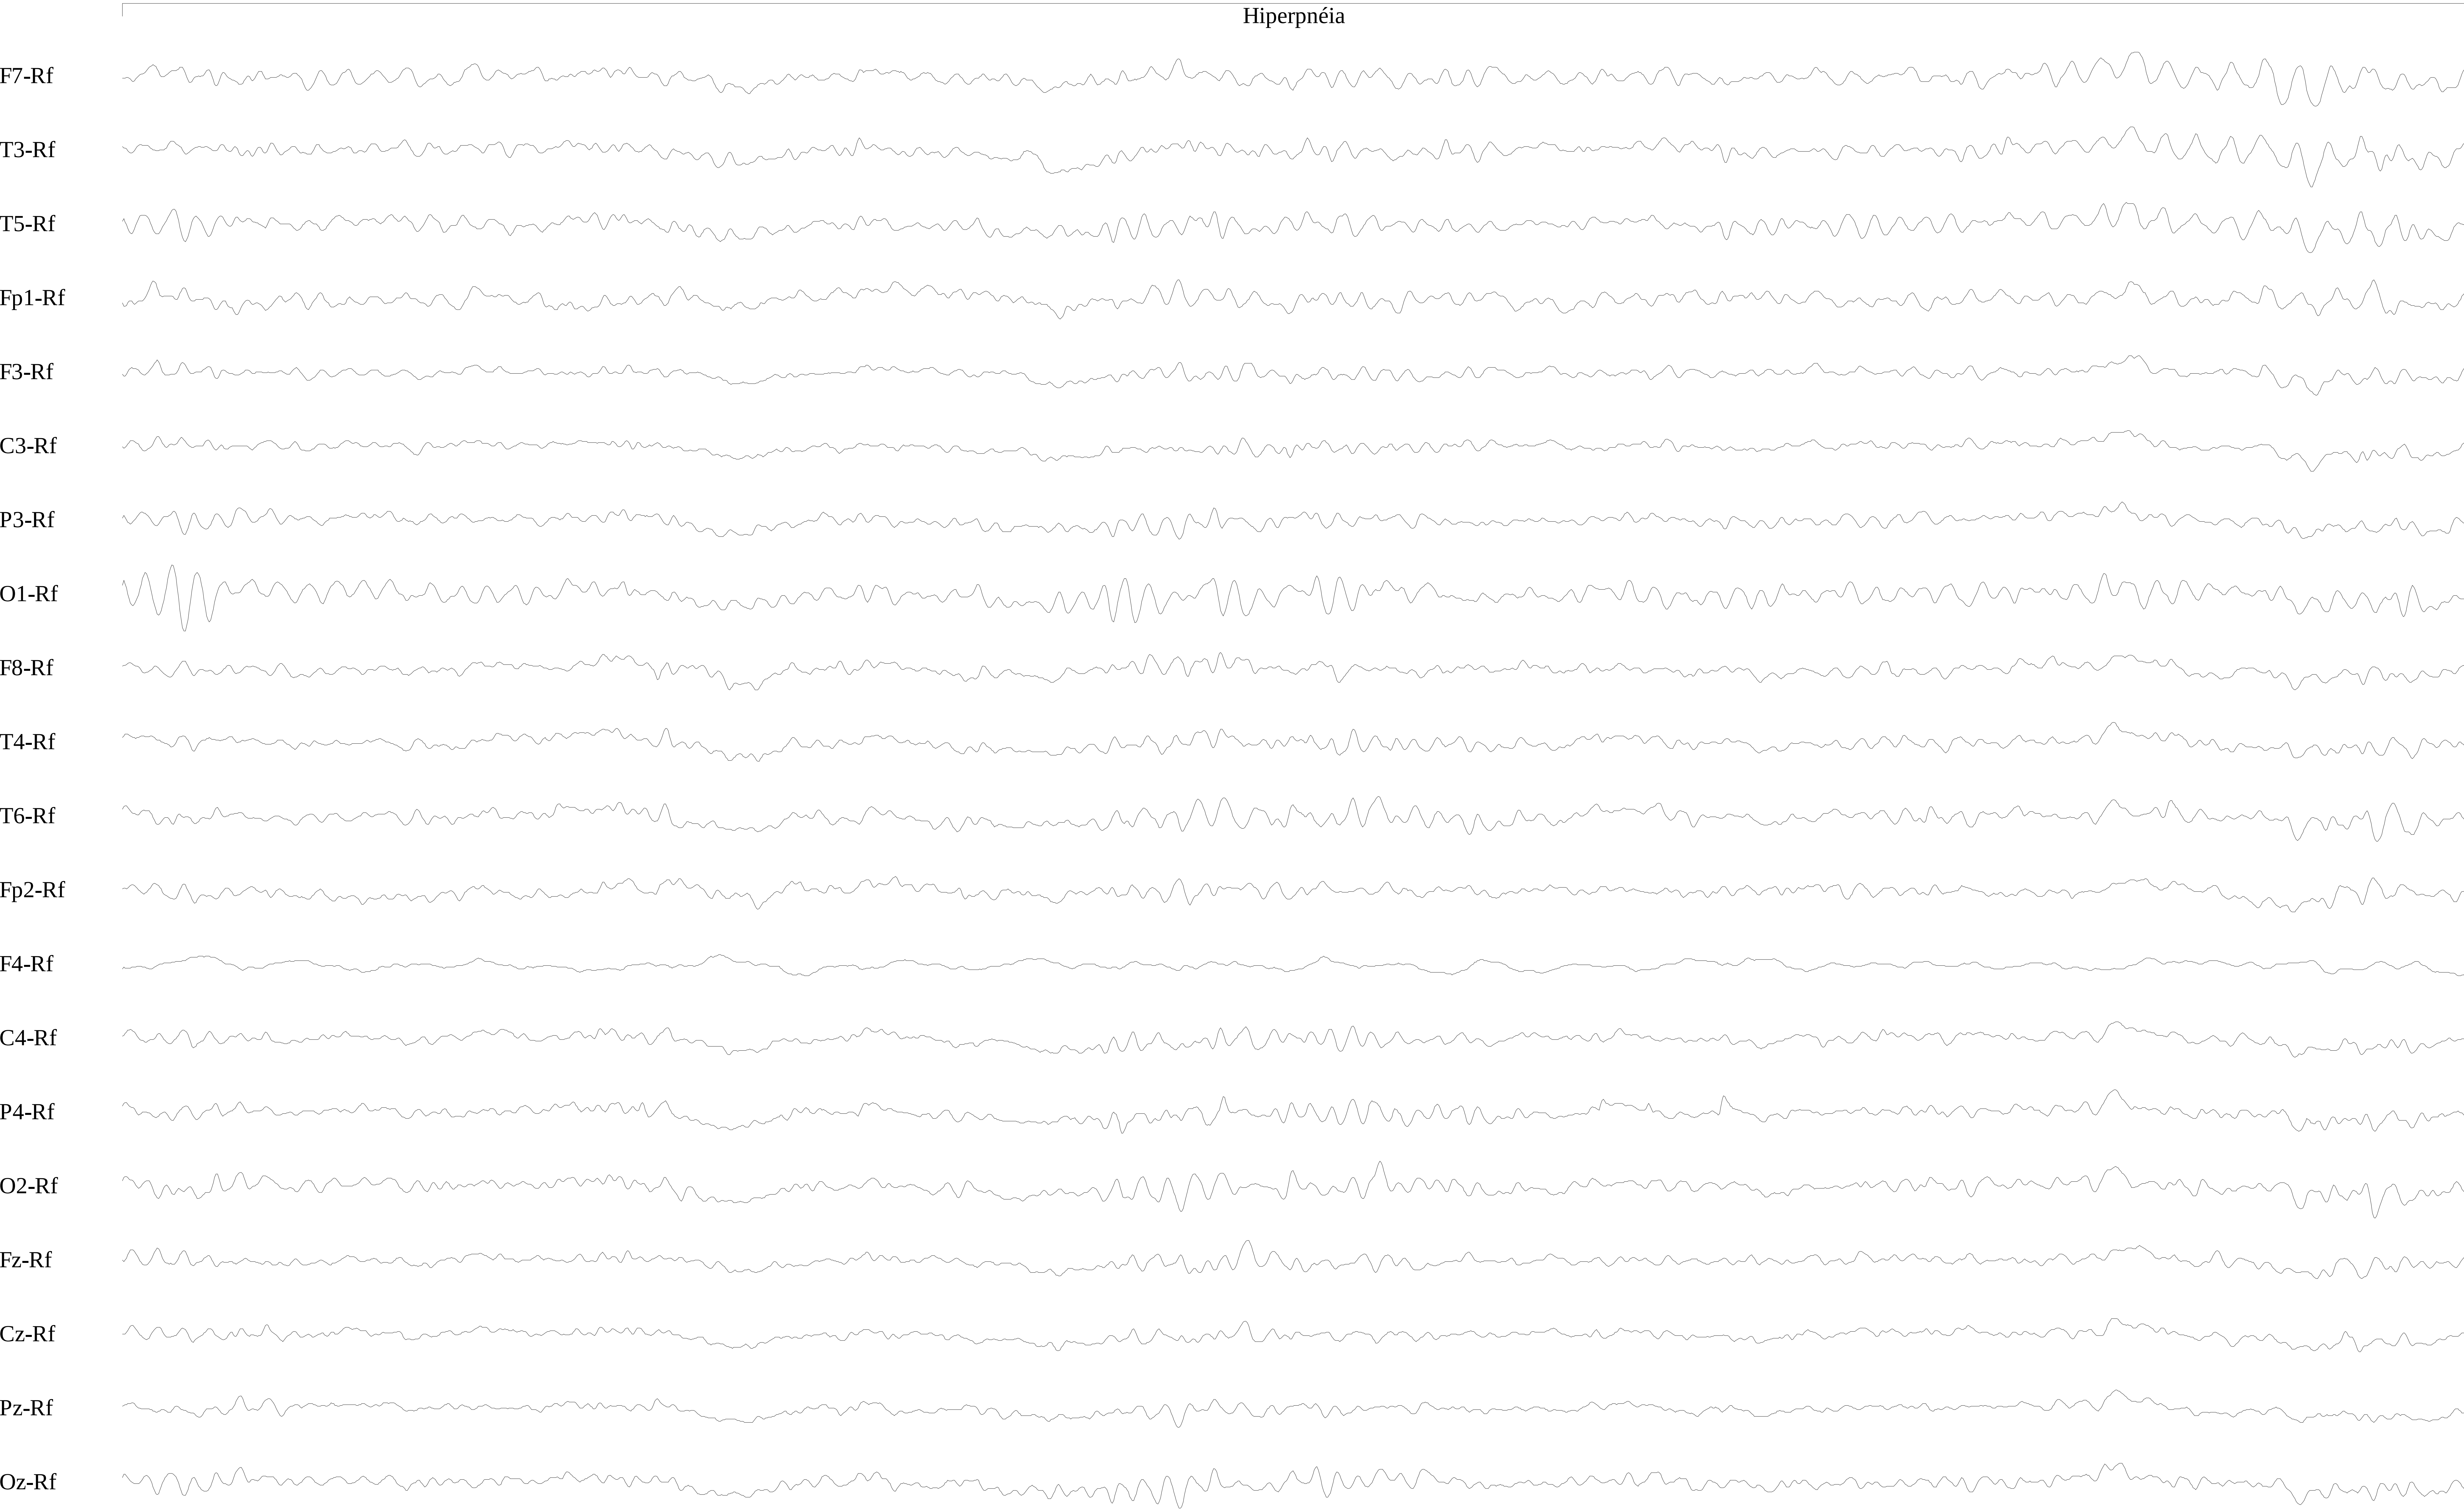


FOTO-Rf

